

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **10:30** horas del día **10** de **febrero** de **2020**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 numeral 1º, fracción I, artículo 28 numeral 4º, artículo 30 numeral 1, fracción I, artículo 32 numeral 1º y artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Segunda Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-001-2020**, relativa:

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

El acto fue presidido por la C.P. Rosalba Núñez Rosas, **Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales**, (de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima) quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.

2. - Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several initials at the bottom right.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**PREGUNTAS DEL LICITANTE:  
LABORATORIOS LICON SA**

**DE CARACTER TECNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.-Anexo Número 1 Técnico. Área de Coagulación. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique el tipo de pruebas y las cantidades a realizar en el área de coagulación para las unidades, Hospital Regional Universitario, Hospital Materno Infantil, Hospital General de Ixtlahuacán, Hospital General de Tecomán, Hospital General de Manzanillo e Instituto Estatal de Cancerología. Para considerarlo en la propuesta económica.</p>	<p>La cantidad y pruebas solicitadas se especifican en cada uno de las secciones por unidad en el apartado técnico de la licitación, por ejemplo, Hospital Regional Universitario viene en el inciso K</p>
<p>2.- Anexo numero 1 Técnico área de Inmunoematología. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique el tipo de prueba y la cantidad a realizar para considerarlo en la propuesta económica.</p>	<p>La cantidad y pruebas solicitadas se especifican en cada uno de las secciones por unidad en el apartado técnico de la licitación.</p>
<p>3.- Anexo numero 1 Técnico área de Inmunoematología. Es correcta nuestra apreciación de acuerdo a la pregunta anterior, si una de las pruebas a realizar es prueba cruzada, se deberá cotizar tarjeta Para Compatibilidad Sanguínea, tarjetas de gel anti IgG-C3d Coombs Poli específico y si se deberá considerar para realización de pruebas de compatibilidad en gel la utilización de 3 pozos por prueba (prueba mayor, prueba menor y autocontrol). Favor de aclarar.</p>	<p>Es correcta su apreciación se deberá de considerar tarjeta de gel anti IgG-C3d coombs poliespecífico y se deberá contemplar 3 pozos por prueba</p>

*Handwritten mark*

*Handwritten marks and signatures on the right margin*

*Handwritten marks and signatures at the bottom left*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p><b>4.- (L) PUNTOS DE PROPUESTA TÉCNICA. 13.- CONTROL DE CALIDAD EXTERNO</b></p> <p>El licitante adjudicado deberá inscribir en un lapso no mayor a 2 meses después de la instalación del equipo a los 10 laboratorios de la red estatal en un programa de control de calidad externo nacional, que permita el cumplimiento a la NOM-007-SSA3-2011“PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS” Y LA NOM-EC-15189:2015. LABORATORIOS CLÍNICOS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un programa de Evaluación Externa de la Calidad Internacional reconocido, con gran número de participantes en idioma Español. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Sí, se acepta</p>
---	----------------------

**PREGUNTAS DEL LICITANTE:  
 DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA GAP SA DE CV  
 DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><i>EL NUMERAL 1.10 IDIOMA, SOLICITA QUE EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ EN ESPAÑOL.</i></p> <p><i>ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE EXISTIR DOCUMENTACIÓN QUE POR SU ORIGEN Y NATURALEZA SE ENCUENTRE ESCRITA EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGEN ACOMPAÑADO DE COPIA SIMPLE DE SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</i></p>	<p>Es correcta, siempre y cuando NO se esté haciendo referencia a los registros sanitarios expedidos por COFEPRIS, ya sea de equipamiento o de insumos de los mismos, ya que estos documentos deberán estar en idioma ESPAÑOL.</p>
<p><i>EL NUMERAL 1.13 CONDICIONES DE PAGO ESTABLECE QUE EL PAGO NO EXCEDERÁ DE CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.</i></p> <p><i>A FIN DE PODER OTORGAR MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO A 20 DÍAS</i></p>	<p>Las condiciones de pago serán las establecidas en el numeral 1.13 de las bases de la convocatoria.</p>

A/1

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>NATURALES TRAS LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. FAVOR DE CONSIDERAR.</p>	
<p>EL NUMERAL 2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ESTABLECE QUE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁN ACABO 11 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO A QUE EXISTEN DOCUMENTOS QUE DEBEN SER EMITIDOS EN ORIGINAL POR PARTE DE LOS FABRICANTES Y/O IMPORTADORES PRIMARIOS SON EMITIDOS EN ORIGINAL Y PODRÍAN VENIR DEL EXTRANJERO PARA SER INTEGRADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA; SOLICITAMOS AMABLEMENTE EXTENDER EL PLAZO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS AL 13 DE FEBRERO 2020 DERIVADO QUE EXISTEN DOS DÍAS INHÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN.</p>	<p>La fecha de presentación y apertura de propuestas Técnica y económica será el día 17 de febrero del 2020 a las 10:00 a.m.</p>
<p>NUMERAL 3.9 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA PAGINA DE INTERNET CORRECTA PARA DESCARGAR VÍA WEB LA OPINIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL ESTADO DE COLIMA; YA QUE EL SITIO WEB PROPORCIONADO (HTTP://WWW.CONSTANCIA-NOADEUDOSFYA.COL.GOB.MX/) EN EL NUMERAL DE REFERENCIA NO ES POSIBLE SU EMISIÓN. FAVOR DE PROPORCIONAR.</p>	<p><b>LA PÁGINA CORRECTA ES :</b> <b><u><a href="http://www.dgicolima.col.gob.mx/web/ConstanciaDeOpinion/Constancia">http://www.dgicolima.col.gob.mx/web/ConstanciaDeOpinion/Constancia</a></u></b></p>
<p>NUMERAL 3.10 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. (OPCIONAL).</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE, DE NO ENCONTRARNOS EN ESTE SUPUESTO, SERÁ SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO 3.10 INTEGRAR EN LA PROPUESTA LA MANIFESTACIÓN DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN ESTE SUPUESTO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>NUMERAL 3.11 ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA SOLICITA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRÓXIMO ANTERIOR CON SUS ANEXOS Y ACUSE DE RECIBIDO.</p> <p>DERIVADO QUE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS SE REALIZAN VÍA ELECTRÓNICA, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ORIGINAL CORRESPONDE A LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DESDE LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>NUMERAL 3.11 ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA SOLICITA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

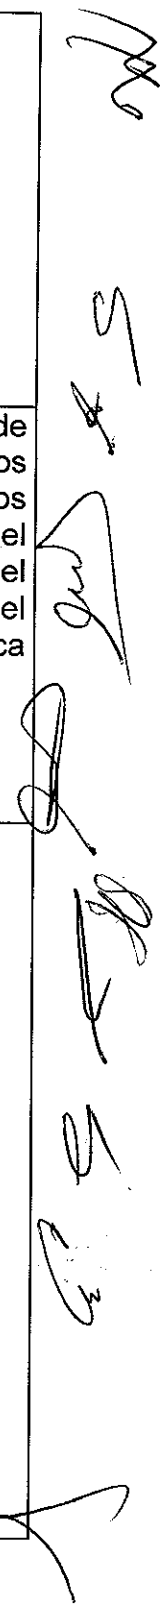
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRÓXIMO ANTERIOR CON SUS ANEXOS Y ACUSE DE RECIBIDO.</p> <p>DERIVADO QUE EL PERIODO LÍMITE DE LA OBLIGACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS ES EL 31 DE MARZO 2020 Y A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS NO ESTÁ VENCIDO; ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL 2018 Y LAS DECLARACIONES PARCIALES DEL 2019 HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>NUMERAL 3.12 LICENCIA DE GIRO EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SOLICITA COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA DE GIRO VIGENTE A 2020 A NOMBRE DEL LICITANTE, EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, LA CUAL DEBERÁ CORRESPONDER AL DOMICILIO DEL LOCAL EN EL CUAL FUNCIONA U OPERA LA EMPRESA.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SE DEBERÁ INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA MUNICIPAL CUYO GIRO SE ENCUENTRE RELACIONADO CON LOS BIENES A OFERTAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO SANITARIO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>La licencia de giro y/o aviso de funcionamiento se integra en los requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes. Y podrá presentarse junto con el resto de la documentación que integra el punto 3 de las bases, dentro o fuera del sobre que contenga la propuestas técnica y económica</p>
<p>NUMERAL 3.13 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA (ANEXO 8) SOLICITA ESCRITO ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.</p> <p>CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE; ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO IV ARTÍCULO 50 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA SE DEBERÁ INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA COPIA SIMPLE DE LOS TÍTULOS Y/O CEDULAS PROFESIONALES DEL PERSONAL ACTIVO DEL LICITANTE QUE CUENTE CON CARRERAS A NIVEL TÉCNICO Y LICENCIATURA DE CARRERAS AFINES A LAS ÁREAS MÉDICO-BIOLÓGICAS Y DE INGENIERÍAS; CON EL CUAL PRETENDA PRESTAR LOS SERVICIOS, HACIENDO ACOMPAÑAR ESTOS DOCUMENTOS DE SU RESPECTIVA COPIA SIMPLE DEL PAGO ANTE EL IMSS DEL ÚLTIMO BIMESTRE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo estipulado en el numeral 3.13 de las bases</p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>NUMERAL 3.13 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA (ANEXO 8) SOLICITA ESCRITO ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.</p> <p>CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA EVALUAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL LICITANTE; ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO IV ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA SE DEBERÁ INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN POSITIVA POR PARTE DEL INFONAVIT. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo estipulado en el numeral 3.13 de las bases</p>
<p>NUMERAL 3.13 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA (ANEXO 8) SOLICITA ESCRITO ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.</p> <p>CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA EVALUAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL LICITANTE; ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO IV ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA SE DEBERÁ INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN POSITIVA POR PARTE DEL IMSS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo estipulado en el numeral 3.13 de las bases</p>
<p>NUMERAL 3.20 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LO MENCIONADO EN ESTE NUMERAL ES DE CARÁCTER INFORMATIVO POR LO QUE NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN SU OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo estipulado en el numeral 3.20 de las bases</p>
<p>NUMERAL 3.21 MODELO DE CONTRATO</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LO MENCIONADO EN ESTE NUMERAL ES DE CARÁCTER INFORMATIVO POR LO QUE NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN SU OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo estipulado en el numeral 3.21 de las bases</p>
<p>NUMERAL 3.22 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ ES LO QUE SE DEBERÁ INTEGRAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Se deberá presentar el sobre que contenga la propuesta Técnica y Económica.</p>

AR

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>NUMERAL 3.22 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA IRÁN DENTRO DEL MISMO SOBRE CERRADO O SI SE ENTREGARAN EN DOS SOBRES INDIVIDUALES E INDEPENDIENTES, DEBIDAMENTE CERRADOS, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Se deberá presentar ambas propuestas en un mismo sobre</p>
<p>NUMERAL 3.22 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ ES LO QUE SE DEBERÁ INTEGRAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>El sobre que contenga la propuesta Técnica y Económica, conforme a lo establecido en el punto 4.1 de las bases.</p>
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES).</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA IRÁN DENTRO DEL MISMO SOBRE CERRADO O SI SE ENTREGARAN EN DOS SOBRES INDIVIDUALES E INDEPENDIENTES, DEBIDAMENTE CERRADOS, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Se deberá presentar ambas propuestas en un mismo sobre</p>
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO B) DEBERÁ SER CLARA Y PRECISA, DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, EN CONCORDANCIA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES, SEÑALANDO TANTO EL PRECIO UNITARIO COMO EL TOTAL, EN MONEDA NACIONAL, (PESOS MEXICANOS) ANTES DE IVA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE COLUMNA DEL ANEXO 2 SE DESCRIBIRÁ LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS Y NOS PROPORCIONE EL ANEXO 2 CON LOS TEXTOS EXACTOS QUE DEBERÁ CONTENER CADA BIEN OFERTADO A FIN DE EVITAR ERRORES DE INTERPRETACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Deberá apegarse al formato establecido en las bases</p>
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO B) DEBERÁ SER CLARA Y PRECISA, DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, EN CONCORDANCIA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES, SEÑALANDO TANTO EL PRECIO UNITARIO COMO EL TOTAL, EN</p>	<p>Deberá apegarse al formato establecido en las bases, correspondiente a los consumos totales del período contratado</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>MONEDA NACIONAL, (PESOS MEXICANOS) ANTES DE IVA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE DENTRO DEL ANEXO 2 TODOS LOS CONCEPTOS FACTURABLES (DESCRIPCIONES), ASÍ COMO LOS MÁXIMOS A LICITAR POR TODO EL PERIODO 2020-2021 LOS CUALES SERÁN EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN A FIN DE EVITAR ERRORES DE INTERPRETACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO D) DEBERÁ SER FIRMADA POR LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, ANEXANDO A SU FIRMA LA LEYENDA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD".</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EL REQUISITO DE LA LEYENDA "BAJO PROTESTA DECIR VERDAD" SOLO DEBERÁ SER CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS QUE SEAN REALIZADOS POR EL LICITANTE. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta su apreciación</p>
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO E) SE PRESENTARÁ EN IDIOMA ESPAÑOL.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE EXISTIR DOCUMENTACIÓN QUE POR SU ORIGEN Y NATURALEZA SE ENCUENTRE ESCRITA EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGEN ACOMPAÑADO DE COPIA SIMPLE DE SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta, siempre y cuando NO se esté haciendo referencia a los registros sanitarios expedidos por COFEPRIS, ya sea de equipamiento o de insumos de los mismos, ya que estos documentos deberán estar en idioma ESPAÑOL.</p>
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO H) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y VIGENTE DEL REGISTRO SANITARIO (ANVERSO Y REVERSO) EXPEDIDO POR LA COFEPRIS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEL EQUIPO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y PROPUESTA.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>




SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACLARAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO RESPECTO LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO SERÁ SUFICIENTE QUE SE ENCUENTRE VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS; Y EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE VENCIDO SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR COPIA SIMPLE DE SU SOLICITUD DE PRÓRROGA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO K) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE UN CONTRATO CELEBRADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS, CON ALGUNA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, U OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS CUYO OBJETO SEA EL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CONTRATO SOLICITADO EN ESTE INCISO NO DEBERÁ DE TENER MAYOR DE DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO K) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE UN CONTRATO CELEBRADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS, CON ALGUNA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, U OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS CUYO OBJETO SEA EL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CONTRATO SOLICITADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO DEBERÁ DE HABER SIDO SUSCRITO CON UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA COMO LA QUE CONVOCA Y QUE CUYO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SEA UN SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE CON CARACTERÍSTICAS</p>	<p>No es correcto. El objeto de la presente licitación no es la contratación de un servicio integral de banco de sangre</p>







  
  
  
  
  
  


A/1 

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>IGUALES O SUPERIORES EN MAGNITUD, COMPLEJIDAD QUE LA QUE SE PRETENDE CONTRATAR CON ESTA CONVOCATORIA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO K) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE UN CONTRATO CELEBRADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS, CON ALGUNA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, U OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS CUYO OBJETO SEA EL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CONTRATO SOLICITADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO SE PODRÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Se deberá presentar copia simple del contrato, con Original o Copia certificada para su cotejo.</p>
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO J) EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR CARTA DE APOYO DE LOS FABRICANTES O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SUBDISTRIBUIDOR, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE ESTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE, POR LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO 1.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER COMO SUBDISTRIBUIDOR SECUNDARIO A UN DISTRIBUIDOR MAYORISTA QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL FABRICANTES O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p>NUMERAL 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTABLECE QUE EN UN SOBRE CERRADO CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (SEGÚN SE</p>	<p><b>Se refiere a los insumos ofertados</b></p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>DESCRIBE EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO DE ESTAS BASES), INCISO J) EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR CARTA DE APOYO DE LOS FABRICANTES O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SUBDISTRIBUIDOR, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE ESTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE, POR LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO 1.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SE DEBERÁ ENTENDER POR "CLAVE DESCRITA" EN EL ANEXO 1. FAVOR DE ESPECIFICAR.</p>	
<p>NUMERAL 5. FIRMA DEL CONTRATO, QUINTO PÁRRAFO ESTABLECE QUE LA CONTRATACIÓN ABARCARÁ DOS EJERCICIOS FISCALES. (DEL 15 DE FEBRERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021); LO QUE REPRESENTA SOLO 14 HRS ENTRE LA EMISIÓN DEL FALLO Y EL INICIO DE LA OBLIGACIÓN JURÍDICA LO CUAL SOLO PODRÍA SER CUMPLIDA POR EL PROVEEDOR INSTALADO.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO AL CAPITULO IV, ART. 52, FRACCIÓN XII, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UN PERIODO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AL MENOS 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO. FAVOR DE CONSIDERAR.</p>	<p><b>La vigencia del contrato se precisa en el punto 7 del acta de la Junta de Aclaraciones</b></p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*








*Handwritten signature*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**GAP DE CARÁCTER TÉCNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. EQUIPO AUTOMATIZADO DE DETECCIÓN MICROBIANA. INSUMOS NECESARIOS</b>                      SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BOTELLAS DE HEMOCULTIVOS PARA ADULTOS AEROBIAS Y ANAEROBIAS, YA QUE EL UTILIZAR ESTAS DOS BOTELLAS EN UN MISMO PACIENTE INCREMENTA LA CANTIDAD DE PATÓGENOS RECUPERADOS POR EL VOLUMEN DE SANGRE UTILIZADO, SE ACEPTA?</p>	<p><b>Apegarse a lo señalado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. EQUIPO AUTOMATIZADO DE DETECCIÓN MICROBIANA.</b>                      SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL CONSUMO ANUAL DE BOTELLAS DE HEMOCULTIVO YA QUE SE MENCIONA UN TOTAL DE (3,600 SANGRE/FLUIDOS CORPORALES ANUALMENTE) CANTIDAD MAYOR AL TOTAL DE PRUEBAS ANUALES SOLICITADAS, EN BACTERIOLOGÍA (2,072 PRUEBAS) POR EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA</p>	<p><b>El número estimado para hemocultivos es de 2101.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA I.</b>                      SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LA ENTREGA DE LAS CEPAS ATCC SOLO SE REALICE COMO ÚNICA OCASIÓN AL INICIO DEL CONTRATO PARA VALIDACIÓN DEL EQUIPO.</p>	<p><b>Apegarse a lo señalado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA II.</b>                      SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LA ENTREGA DE LAS CEPAS ATCC SOLO SE REALICE COMO ÚNICA OCASIÓN AL INICIO DEL CONTRATO PARA VALIDACIÓN DEL EQUIPO.</p>	<p><b>Apegarse a lo señalado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO</b>                      SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO PARA INMUNOLOGÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PRINCIPIO DE MEDICIÓN DE ELFA</li> <li>· CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: REALIZAR 30 T</li> <li>· VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA 200 ML</li> <li>· MUESTRAS EN CARTUCHO</li> <li>· TODOS LOS REACTIVOS ESTÁN INCLUIDOS EN EL</li> <li>· TEMPERATURA CONTROLADA.</li> <li>· EQUIPO CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PA CODIFICADA DEL CARTUCHO</li> </ul>	<p><b>Apegarse a lo señalado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</b></p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALIBRACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA</li> <li>• CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO</li> <li>• PUERTO PARA CONEXIÓN INTERFACE</li> <li>• SOFTWARE EN ESPAÑOL</li> <li>• PANTALLA E IMPRESORA INTEGRADOS</li> <li>• CUENTE CON NO BREAK INTEGRADO O ADICIONAL CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 15 MIN. PARA RESPALDO</li> </ul>	
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA I. MEDIOS DE CULTIVO</b>                  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EN LUGAR DE AGAR SANGRE EL MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA +5% DE SANGRE DE CORDERO (COS)</p>	<p><b>Apegarse a lo señalado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA I. MEDIOS DE CULTIVO</b>                  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDIOS DE CULTIVO CON PRESENTACIÓN DE CAJA CON 20 PLACAS, LA CUAL CONTIENE 2 PAQUETES CON BOLSA DE 10 PLACAS SOFTWARE EN ESPAÑOL CON MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS, CON PANTALLA PLANA SENSIBLE AL TACTO CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO, CON INVENTARIO DE REACTIVOS AUTOMÁTICO POR PRUEBA Y ESTADO DE LOS REACTIVOS Y CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.                  CAPACIDAD: MUESTRAS 50                  TARJETAS ID: 170                  VIALES DE REACTIVOS: 34                  DILUYENTES: 4</p>	<p><b>No se entiende la pregunta ya que mezcla varios temas</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA II. MEDIOS DE CULTIVO</b>                  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EN LUGAR DE AGAR SANGRE EL MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA +5% DE SANGRE DE CORDERO (COS)</p>	<p><b>Apegarse a lo señalado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA II. MEDIOS DE CULTIVO</b>                  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDIOS DE CULTIVO CON PRESENTACIÓN DE CAJA CON 20 PLACAS, LA CUAL CONTIENE 2 PAQUETES CON BOLSA DE 10 PLACAS</p>	<p><b>Ajustar la presentación ofertada a la cantidad necesaria.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, AUTOANALIZADOR PARA QUÍMICA CLÍNICA "RANDOM ACCESS".</b>                  • SISTEMA ABIERTO, DISCRETO, MULTIPARAMÉTRICO, SELECTIVO, CARGA CONTINUA, "WALK AWAY".                  • DISPOSITIVO COMPACTO DE SOBRE MESA.                  • VELOCIDAD MÁXIMA: 534 TEST/HORA TOTALES</p>	<p><b>Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>(FOTOMÉTRICOS: 330 TEST/HORA + ISE: 204 TEST/HORA).        • CONSUMO TÍPICO DE REACTIVOS: 300 UL.        • MÓDULO ISE INCORPORADO PARA NA, K Y CL.        HASTA 80 PARÁMETROS PUEDEN SER DETERMINADOS SIMULTANEAMENTE.        • ROTOR CON 78 POSICIONES PROGRAMABLES TOTALES: 52 PACIENTES (RUTINA+ URGENCIAS) Y 26 CALIBRADORES Y/O CONTROLES.        • EN COPA DE MUESTRA Y/O TUBO PRIMARIO.        VOL. PROGRAMABLE DE MUESTRA 1 - 100 UL.        • VOL. PROGRAMABLE DE REACTIVO 5 - 500 UL.        • VOL. DE REACCIÓN: 280 UL - 700 UL</p>	
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. EQUIPO DE COAGULACIÓN I.</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, EQUIPO AUTOMATIZADO CON PRINCIPIO: FOTOÓPTICO, CONTINUO, SECUENCIAL        MÉTODOS/CANALES: COAGULACIÓN (10 CANALES INDEPENDIENTES), CROMOGENICO E INMUNOLÓGICO TUBO PRIMARIO Y CUBETA DE MUESTRA MUESTRA AUTOMATIZADA Y PREDILUCIÓN ESTANDAR IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE LA MUESTRA AUTOMÁTICA CARGA CONTINUA DE MUESTRAS EN GRADILLAS (CAPACIDAD 10 TUBOS)        CARGA MÁXIMA INICIAL: 5 GRADILLAS (50 MUESTRAS)        ALMACENAMIENTO: GRADILLAS: 5 GRADILLAS DE MUESTRAS, CARGA CONTINUA: DISPONIBILIDAD DE VARIOS ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA LOS TUBOS. POSIBILIDAD DE MEZCLAR TUBO PRIMARIO CON TAPÓN Y SIN TAPÓN Y CUBETAS DE MUESTRA IDENTIFICACIÓN DEL REACTIVO MEDIANTE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO        MECANISMO DE DISPENSACIÓN: 2 PIPETAS: 1 TERMOSTATIZADA PARA REACTIVOS Y 1 PARA MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES COLOCACIÓN MANUAL DE REACTIVOS, BANDEJAS DE REACTIVOS EXTRAIBLES        REACTIVOS A BORDO: 40 POSICIONES DE REACTIVOS/CONTROL        REFRIGERACIÓN REACTIVO: TEMPERATURA DE 40 POSICIONES REACTIVO REFRIGERADO A BORDO DE 8 - A 12OC        FLEXIBILIDAD PARA LA CARGA DE REACTIVOS DENTRO DEL CARRUSEL, DISPONIBILIDAD DE DIVERSOS ADAPTADORES        POSICIÓN DE MEZCLA: 5 POSICIONES        APROX. 180 PRUEBAS PT /HORA        APROX. 180 PRUEBAS APTT/HORA        APROX. 180 PRUEBAS PT/APTT/HORA SIMULTANEAS        APROX. 95 PRUEBAS PT/APTT/AT/DD SIMULTANEAS        MODO DE ACCESO: ACCESO ALEATORIO CONTINUO (MUESTRAS, CUBETAS DE REACCIÓN)        STAT: 5 POSICIONES PARA URGENCIAS        TIPO: CUBETAS DE REACCIÓN INDIVIDUALES        CARGA: 500 CUBETAS DE REACCIÓN A BORDO        LAVADO Y ENJUAGUE: SOLUCIONES DE LAVADO A BORDO</p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO URIANALISIS TIPO I,</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, SISTEMA AUTOMATIZADO DE UROANÁLISIS QUE COMBINA EL ANALIZADOR DE QUÍMICA URINARIA CON EL ANALIZADOR DE SEDIMENTO URINARIO</p>	<p><b>Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>CAPACIDAD 106-240 MUESTRAS/HR                  ALMACENAMIENTO 10,000 RESULTADOS DE PACIENTES INCLUYENDO IMÁGENES                  FUNCIÓN STAT SI                  UNIDADES DE SEDIMENTO CÉLULAS/ML, CÉLULAS/HPF, CÉLULAS/LPF                  UNIDADES DE RESULTADO QUÍMICOS CONVENCIONAL, CONVENCIONAL CON PLUS SYSTEM, SI, Y SI CON PLUS SYSTEM                  TIEMPO EN EL PRIMER RESULTADO &lt; 4 MINUTOS                  CAPACIDAD DE CARGA DE MUESTRAS 100 MUESTRAS                  MENU SEDIMENTO                  RBC (CELL RED BLOOD ), WBC (WHITE BLOOD CELL) WBCC (WHITE BLOOD CELL CLUMP), BAC (BACTERIA) BACR (ROD BACTERIA), BACC (COCCUS BACTERIA) EPI (CÉLULAS EPITELIALES ESCAMO), NEC (CEL EPITELIALES NO ESCAMOSAS), PAT (CILINDROS PATOLÓGICOS), HYA (CILINDROS HIALINOS), CRY (CRISTALES), YEA (LEVADURAS), MUC (MOCO) SPRM (ESPERMATOZOIDES)</p>	
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. ANALIZADOR DE GASES.</b>                  SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE PARA CUIDADOS CRÍTICOS                  QUE MIDE, PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CL-, CA++, LACTATO, GLUCOSA, COOXIMETRÍA, HCT Y PARÁMETROS CALCULADOS.                  TIPO DE MUESTRA, SANGRE TOTAL, JERINGA Y CAPILAR, LÍQUIDO PLEURAL, LÍQUIDO DE DIÁLISIS                  TAMAÑO DE LA MUESTRA JERINGA: 200 ML SANGRE TOTAL, MICROMUESTRA 95UL, CAPILAR: 100 ML SANGRE TOTAL                  TIEMPO DE RESPUESTA 60 SEGUNDOS - RESULTADOS: EN PANTALLA E IMPRESOS.                  CARTUCHO DE 250/400/750 PRUEBAS                  CALIBRACIÓN COMPLETA CADA 8 HORAS                  CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA PROGRAMADA Y/O CALIBRACIÓN MANUAL POR EL USUARIO                  CONTROL DE CALIDAD                  CARTUCHO DE CONTROL DE CALIDAD A AUTOMÁTICO (AQC) A 3 NIVELES                  ACEPTA CONTROLES DE TERCERA (AMPOLLETA)</p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice los parámetros solicitados y calculados. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. EQUIPO DE INMUNOLOGIA (SERVICIO A LA RED ESTATAL),</b>                  SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, INSTRUMENTO CON TECNOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA, 85 PRUEBAS POR HORA                  TIEMPO DE PRIMER RESULTADO 17 MINUTOS                  CAPACIDAD DE MUESTRA 48 MUESTRAS                  WALK AWAY APROXIMADAMENTE 2 HORAS.                  TIPO DE MUESTRA SUERO / PLASMA / ORINA / LCR                  SENSOR DE NIVEL NEUMÁTICO. DETECCIÓN DE COÁGULOS Y SEÑALIZACIÓN.                  REFRIGERACIÓN DE REACTIVOS 13 ° C ± 2 ° C                  IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (RFID)                  SEGUIMIENTO DE LA ESTABILIDAD A BORDO.                  CAPACIDAD DE REACTIVO ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE 10 POSICIONES PARA INTEGRALES DE REACTIVO + ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE 4 POSICIONES PARA REACTIVOS AUXILIARES                  CUBETAS CAPACIDAD A BORDO: HASTA 172</p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>PUNTAS DESECHABLES CAPACIDAD A BORDO: 192 CARGA / DESCARGA DE ARTÍCULOS DURANTE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.</p>	
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. ANALIZADOR DE HBA1C (SERVICIO A LA RED ESTATAL), SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE HBA1C</b>                  VELOCIDAD DE 20 PRUEBAS POR HORA                  CROMATOGRFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) POR INTERCAMBIO IÓNICO (ESTÁNDAR DE REFERENCIA)                  DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MUESTRAS, TUBO PRIMARIO, IMPRESORA INTEGRADA, PANTALLA TÁCTIL, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, NO REQUIERE MEZCLAR LA MUESTRA NI RETIRAR EL TAPÓN DEL TUBO, RESULTADOS CUANTITATIVOS SIMULTÁNEOS PARA HBA2, HBF, HBA1C                  DETECTA VARIANTES DE HEMOGLOBINA COMUNES.                  DETERMINACIÓN CONFIABLE DE A2 Y F AÚN EN PRESENCIA DE HBS                  PROPORCIONA RESULTADOS NUMÉRICOS Y CROMATOGRAMAS.                  TODOS LOS REACTIVOS INCLUIDOS, CALIBRADORES Y PRIMERS                  EQUIPO DE MESA                  KIT DE REACTIVOS PARA 400 PBAS.</p>	<p><b>Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA (SERVICIO A LA RED ESTATAL), SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL DE 6 COLUMNAS, UNA VEZ QUE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, NO RESTRINGE LA CANTIDAD DE COLUMNAS EN LAS TARJETAS, PARA PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO ABO DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD. EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, DE ACCESO CONTINUO, PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON TARJETAS DE COLUMNAS DE GEL O PARA LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO ABO Y RH, TANTO DIRECTO COMO INVERSO, FENOTIPOS DE RH, COOMBS DIRECTO CON IGG, IGM, IGA, RASTREO, IDENTIFICACIÓN Y TITULACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, FENOTIPOS FUERA DEL SISTEMA ABO Y PRUEBAS DE HEMOCOMPATIBILIDAD. PROCESO AUTOMATIZADO CONTINUO E INTEGRADO QUE PERMITE IDENTIFICACIÓN POR CÓDIGO DE BARRAS DE MUESTRAS Y REACTIVOS, INCLUIDA LA HOJA DE ANTÍGENOS DEL PANEL DE IDENTIFICACIÓN. RESUSPENSIÓN DE LOS ERITROCITOS DILUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS, INCUBACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, LECTURA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS Y COMBINACIÓN DE</b></p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**








<p>LAS MISMAS.                  PROCESAMIENTO DE PRUEBAS URGENTES.                  IDENTIFICACIÓN POSITIVAS DE LAS MUESTRAS.                  IDENTIFICACIÓN DE REACTIVOS CON CONTROL DE LOTES Y CADUCIDADES.                  MONITOREO Y ACCESO CONTINUO DE REACTIVOS Y DILUYENTES.                  DETECCIÓN DE COAGULOS Y UTILIZACIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO DE TUBO.                  SOFTWARE EN ESPAÑOL CON MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS, CON PANTALLA PLANA SENSIBLE AL TACTO CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO, CON INVENTARIO DE REACTIVOS AUTOMÁTICO POR PRUEBA Y ESTADO DE LOS REACTIVOS Y CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.                  CAPACIDAD: MUESTRAS 50                  TARJETAS ID: 170                  VIALES DE REACTIVOS: 34                  DILUYENTES: 4</p>	
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGIA</b>                  HOSPITAL GENERAL TECOMÁN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR, SISTEMA MANUAL PARA REALIZAR GRUPO DIRECTO E INVERSO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON TARJETAS DE GEL DE 6 COLUMNAS, UNA VEZ QUE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, NO RESTRINGE LA CANTIDAD DE COLUMNAS EN LAS TARJETAS                  CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE UTILIZAR LA TÉCNICA EN GEL Y LA TÉCNICA EN TUBO HACIENDO UN SIMPLE CAMBIO DE ROTORES.                  CUENTA CON UN ROTOR PARA 24 TARJETAS DE GEL ID, UN ROTOR PARA 2 RACKS DE 12 DE TARJETAS ID Y UN RACK PARA 28 TUBOS DE 10-12 X 75 MM.                  IDENTIFICA AUTOMÁTICAMENTE EL ROTOR QUE SE UTILIZA Y AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LOS PARÁMETROS DE CENTRIFUGACIÓN DEPENDIENDO DE LA TÉCNICA UTILIZADA                  VELOCIDAD MÁXIMA: 910-2,500 RPM                  TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN MÍNIMA: 1 S                  TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN MÁXIMA: 99:59 MIN</p> <p>INCUBADOR CON LA FLEXIBILIDAD DE HACER LA INCUBACIÓN A 37 GRADOS CELSIUS DE HASTA 36 TARJETAS DE GEL ID Y DE HASTA 24 TUBOS DE 10-12 X 75 MM PARA LA TÉCNICA CONVENCIONAL.                  VOLTAJE DE ENTRADA: 100 A 240 V C.A.                  FRECUENCIA ELÉCTRICA: 50-60 HZ                  TIEMPO DE INCUBACIÓN 00:01-99:59 MIN                  TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 A 7 MIN</p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. EQUIPO DE COAGULACIÓN TIPO II,</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR,                  EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS</p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>

A/1

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>PARA TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, TIEMPO DE TROMBINA, FIBRINÓGENO, FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES, CON MÉTODO DE DETECCIÓN: DETECCIÓN COAGULATIVA, CROMOGENICO E INMUNOLÓGICA MÉTODO/CANALES COAGULATIVO/4, CROMOGENICO* E INMUNOLÓGICO*</p> <p>LÁMPARA DE LECTURA COAGULATIVO - 4 LEDS CON UNA LONGITUD DE ONDA DE 660 NM; CROMOGENICO - 1 LED CON UNA LONGITUD DE ONDA* DE 405 NM; INMUNOLÓGICO - 1 LED CON UNA LONGITUD DE ONDA* DE 575 NM</p> <p>TUBOS DE MUESTRA TUBOS PRIMARIOS Y COPAS DE MUESTRAS</p> <p>IDENTIFICACIÓN POSITIVA AUTOMÁTICA DE LAS MUESTRAS</p> <p>CÓDIGOS DE BARRAS</p> <p>SISTEMA PORTADOR GRADILLAS DE MUESTRAS DE ACCESO CONTINUO</p> <p>CARGA MÁXIMA 10 TUBOS DE MUESTRA</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE DE ALMACENAJE</p> <p>1 GRADILLA DE MUESTRAS; DISPONIBILIDAD DE ADAPTADORES PARA DISTINTOS TUBOS DE MUESTRA</p> <p>MANEJO COMBINACIÓN FLEXIBLE DE COPAS Y VARIOS TIPOS TUBOS DE MUESTRA, EN LA MISMA GRADILLA</p> <p>RENDIMIENTO (APROX.), PT 60 ANÁLISIS/HORA</p> <p>DÍMERO-D 16 ANÁLISIS/HORA. PT, APTT, FIBRINÓGENO 48 ANÁLISIS SIMULTÁNEOS/HORA</p> <p>PT/APTT/FIBRINÓGENO/AT 40 ANÁLISIS SIMULTÁNEOS/HORA</p> <p>PT/APTT/FIB/DÍMERO-D 32 ANÁLISIS SIMULTÁNEOS/HORA</p> <p>MANEJO DE REACTIVOS</p> <p>MECANISMO 1 PIPETA TERMOSTATIZADA DE DISPENSACIÓN</p> <p>SISTEMA DE CARGA COLOCACIÓN MANUAL DE REACTIVOS, BANDEJA DE REACTIVOS EXTRAÍBLE</p> <p>REACTIVOS A BORDO 13 POSICIONES, 4 REFRIGERADOS, 3 PARA DILUYENTES, BUFFERS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA</p> <p>TIPO CUBETAS DE REACCIÓN INDIVIDUALES</p> <p>CARGA 60 CUBETAS DE REACCIÓN A BORDO; ACCESO CONTINUO AUTOMÁTICO</p>	
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA (PRUEBAS CRUZADAS), SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR,</b></p> <p>SISTEMA MANUAL PARA REALIZAR GRUPO DIRECTO E INVERSO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON TARJETAS DE GEL DE 6 COLUMNAS, UNA VEZ QUE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, NO RESTRINGE LA CANTIDAD DE COLUMNAS EN LAS TARJETAS.</p> <p>CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE UTILIZAR LA TÉCNICA EN GEL Y LA TÉCNICA EN TUBO HACIENDO UN SIMPLE CAMBIO DE ROTORES.</p> <p>CUENTA CON UN ROTOR PARA 24 TARJETAS DE GEL ID, UN ROTOR PARA 2 RACKS DE 12 DE TARJETAS ID Y UN</p>	<p><b>Apegarse a lo señalado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</b></p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>RACK PARA 28 TUBOS DE 10-12 X 75 MM.  IDENTIFICA AUTOMÁTICAMENTE EL ROTOR QUE SE UTILIZA Y AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LOS PARÁMETROS DE CENTRIFUGACIÓN DEPENDIENDO DE LA TÉCNICA UTILIZADA  VELOCIDAD MÁXIMA: 910-2,500 RPM  TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN MÍNIMA: 1 S  TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN MÁXIMA: 99:59 MIN</p> <p>INCUBADOR CON LA FLEXIBILIDAD DE HACER LA INCUBACIÓN A 37 GRADOS CELSIUS DE HASTA 36 TARJETAS DE GEL ID Y DE HASTA 24 TUBOS DE 10-12 X 75 MM PARA LA TÉCNICA CONVENCIONAL.  VOLTAJE DE ENTRADA:100 A 240 V C.A.  FRECUENCIA ELÉCTRICA: 50-60 HZ  TIEMPO DE INCUBACIÓN00:01-99:59 MIN  TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 A 7 MIN</p>	
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUÍMICA SECA, CAPACIDAD DE INCUBACIÓN COLORIMETRÍA 13, ELECTROLITOS 1</b>  RENDIMIENTO COLORIMETRÍA 190 PRUEBAS/HORA  NÚMERO DE MUESTRAS 5  PRUEBA DE MEDICIÓN COLORIMETRÍA 28 PRUEBAS  ELECTROLITOS 3 PRUEBAS  TIEMPO DE MEDICIÓN COLORIMETRÍA DE 2 A 6 MINUTOS / PRUEBA  ELECTROLITOS 1 MINUTO / 3 PRUEBAS (NA, K, CL)  TIPO DE MUESTRA PLASMA, SUERO, MUESTRA ENTERA  VOLUMEN DE MUESTRA COLORIMETRÍA 10M L/ PRUEBA</p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>
<p><b>ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO. ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA II. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, CONTADOR HEMATOLÓGICO CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES</b>  TECNOLOGÍA/PARÁMETROS MÉTODO DE IMPEDANCIA VOLUMÉTRICA/22 PARÁMETROS  60 PRUEBAS/HORA  VOLÚMENES DE MUESTRA TUBO CERRADO/100 ML  VOLÚMENES DE MUESTRA TUBO ABIERTO/100 ML  CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 10.000 PACIENTES  CONTROL DE CALIDAD 24 LOTES DE CONTROL DE CALIDAD, GRÁFICOS LEVY-JENNINGS, OPCIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS PARA CARGAR VALORES OBJETIVOS DE CONTROL DE CALIDAD, Y CÓDIGO QR DE LECTURA PARA LA ENTRADA DE DATOS DE REFERENCIA  REACTIVOS SIN CIANURO DILUYENTE, DISOLVENTE Y LIMPIADOR</p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. URINALISIS TIPO II, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, EQUIPO PARA LA DETERMINACIÓN BIOQUÍMICA DE ORINA, CON CONTROL AUTOMÁTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TIRAS REACTIVAS.</b>  TIRAS REACTIVAS DE 10 PARÁMETROS, CON CAPACIDAD DE ELIMINAR INTERFERENCIA DE ÁCIDO ASCÓRBICO, RENDIMIENTO DE 7 SEGUNDOS POR MUESTRA; HASTA 500</p>	<p><b>Se acepta, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas. Sin ser limitante para los demás participantes.</b></p>


A

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>PRUEBAS POR HORA.                  PANTALLA TÁCTIL A COLOR FÁCIL DE USAR.                  CAPACIDAD PARA CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DE MICROSCOPIA EN UNA SOLA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.                  UN TOTAL DE TRES FUNCIONES DE TAMIZ – CONFIRMATORIO Y MICROSCÓPICA, PARA MARCAR LOS RESULTADOS ANORMALES PARA UNA REVISIÓN RÁPIDA.                  CONVENIENTE RECUPERACIÓN DE DATOS DE HASTA 500 PACIENTES POR ID DEL PACIENTE, Y 200 LOS RESULTADOS DE CONTROL.</p>	
<p>“APARTADO K, PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD.                  ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SÍ PARA EL APARTADO DE ELECTROLITOS QUE MENCIONA 1 EQUIPO, SI ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DE QUE SE PROCESARÁ ELECTROLITOS SOLAMENTE EN 1 EQUIPO DE LOS 2 OFERTADOS DE QUÍMICA CLÍNICA.                  FAVOR DE ACLARAR SÍ LOS ELECTROLITOS SE REALIZARÁN EN LOS 2 EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA SOLICITADOS O SOLAMENTE EN 1.</p>	<p><b>Para el HRU Se solicitan 2 equipos de química clínica iguales</b></p>
<p>“APARTADO K, PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD.                  ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SÍ PARA LA PRUEBA DE LDL SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CÁLCULO O DIRECTAMENTE EN EL EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA.</p>	<p><b>Se requiere que lo realice el equipo sin cálculo.</b></p>
<p>APARTADO K, PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD.                  ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ROTOR DE MUESTRAS CON 78 POSICIONES PROGRAMABLES TOTALES: 52 POSICIONES DE PACIENTES Y 26 POSICIONES DE CALIBRADORES Y/O CONTROLES.</p>	<p><b>Apegarse a lo señalado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</b></p>
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD.                  ANALIZADOR DE HBA1C                  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SÍ PARA EL APARTADO HBA1C QUE MENCIONA QUE SE PUEDE PROCESAR EN EL EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA, SI ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DE QUE SE PROCESARÁ HBA1C SOLAMENTE EN 1 EQUIPO DE LOS 2 OFERTADOS DE QUÍMICA CLÍNICA.                  FAVOR DE ACLARAR SÍ LA HB1AC SE REALIZARÁ EN LOS 2 EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA SOLICITADOS O SOLAMENTE EN 1.</p>	<p><b>Para el HRU Se solicitan 2 equipos de química clínica iguales</b></p>
<p>“APARTADO K, PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD.                  ANALIZADOR DE HBA1C                   SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SÍ SE PROCESARAN LAS PRUEBAS DE HB1AC EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE LAS UNIDADES EN LAS QUE NO ESTÁ ASIGNADO EQUIPO PARA HB1AC COMO: HOSPITAL GENERAL TECOMÁN, HOSPITAL GENERAL MANZANILLO, HOSPITAL GENERAL IXTLAHUACÁN, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA ,</p>	<p><b>Todos los equipos de química clínica I para HRU, HGT, y HGM realizarán hemoglobina glicosilada.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CENTRO DE SALUD COLIMA Y CENTRO DE SALUD MANZANILLO. ANEXANDO ASÍ EL VOLUMEN DE PRUEBAS HB1AC DE CADA UNIDAD A LA PRODUCTIVIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO.	
---	--

*Ad*

**DE CARÁCTER LEGAL**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
EN EL ANÁLISIS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SALTA A LA VISTA QUE LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN QUE SE SOPORTA LEGALMENTE LA PRESENTE CONVOCATORIA INCLUYENDO LOS NUMERALES, ANEXOS DE MANIFESTACIÓN Y ESCRITOS BAJO PROTESTA NO CORRESPONDEN NI GUARDAN RELACIÓN ALGUNA CON LOS TÍTULOS, CAPÍTULOS, ARTÍCULOS, FRACCIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO.	La presente convocatoria se fundamenta jurídicamente en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y su Reglamento.
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFIQUE SI LA PRESENTE CONVOCATORIA TIENE SU FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO. FAVOR DE ACLARAR.	
NUMERAL 3.6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO 6).  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI EL ARTÍCULO DE REFERENCIA DE DICHO ANEXO ES CORRECTO, YA QUE SE OBSERVA QUE NO GUARDA CORRESPONDENCIA CON EL PRESENTE NUMERAL. FAVOR DE ACLARAR.	La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.
NUMERAL 3.14 SUBCONTRATACIONES. (ANEXO 9).  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS OTORQUE EL ARTÍCULO EN EL CUAL LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA O SU REGLAMENTO PERMITE LA FIGURA DE LA SUBCONTRATACIÓN. FAVOR DE PROPORCIONAR.	La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.

*S*

*jud*

*SP*

*PR*

*CA*

*S*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>NUMERAL 3.15 ESCRITO QUE FACULTE AL LICITANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. (ANEXO 10 ), SOLICITA UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR LA PERSONA QUE REPRESENTA.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER POR EL TÉRMINO "FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE"; QUE EL FIRMANTE CUENTE CON PODER PARA SUSCRIBIR PROPOSICIONES Y PRESENTAR LICITACIONES Y PARTICIPAR EN LICITACIONES GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER ESTATAL, SUSCRIBIR CONTRATOS Y PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE ACLARACIONES. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p><b>Es correcta su apreciación</b></p>
<p>NUMERAL 3.16 ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS. (ANEXO 11 ).</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS OTORGUE EL ARTÍCULO EN EL CUAL LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA O SU REGLAMENTO PERMITE LA FIGURA DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. FAVOR DE PROPORCIONAR.</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>
<p>NUMERAL 3.17 ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO 12)</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS OTORGUE EL ARTÍCULO EN EL CUAL LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA O SU REGLAMENTO PERMITE LA FIGURA DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. FAVOR DE PROPORCIONAR.</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>
<p>NUMERAL 3.16 ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS. (ANEXO 11 ). CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, EN LA QUE DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU PROPUESTA SERÁ O NO DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN CONSULTAR, COMUNICAR O ACORDAR CON NINGÚN OTRO PARTICIPANTE. ADEMÁS, DEBERÁN MANIFESTAR QUE CONOCEN LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PERSONAS MORALES O FÍSICAS Y/O ALGUNA DE SUS RAZONES SOCIALES FILIALES CON LAS QUE SE COMPARTAN ACCIONISTAS Y/O REPRESENTANTES LEGALES Y/O DIRECTIVOS ENCUENTREN ACTUALMENTE SIENDO INVESTIGADAS EN FORMA DE JUICIO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE) POR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS DEBERÁN DE ABSTENERSE DE SUSCRIBIR PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>NUMERAL 4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS OTORQUE EL ARTÍCULO EN EL CUAL LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA O SU REGRAMENTO PERMITE LA FIGURA DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. FAVOR DE PROPORCIONAR.</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>
<p>NUMERAL 4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO PROPORCIONES CONJUNTAS LOS LICITANTES QUE SE HAN UNIDO PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA COMÚN DEBERÁN DE INTEGRAR UN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN FORMATO LIBRE DONDE SE ESPECIFIQUEN LOS ROLES Y FUNCIONES DE CADA PARTE Y DEBERÁN AMBOS CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS SIGUIENTES NUMERALES: 3.2, 3.3, 3.3.1 O 3.3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17 Y 3.18, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Deberá apegarse a lo estipulado en el numeral 4.2 de las bases</p>
<p>NUMERAL 5. FIRMA DEL CONTRATO, SEGUNDO PÁRRAFO ESTABLECE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO SE PRESENTE A FIRMAR EL CONTRATO POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 98 NUMERAL 1, FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL ARTICULO</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>

*Handwritten notes and signatures on the right margin, including the letters 'S', 'F', and 'C'.*

*Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL      A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>98 DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>NUMERAL 5.1 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PUNTO 6, ESTABLECE LA CONDICIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA (PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN LOS CONTRATOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS).</p> <p>SE DEBERÁ ENTENDER QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA A RAZÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PRIMIGENIO Y/O A LA VIGENCIA DE LAS EXTENSIONES QUE DE EL EMANEN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcta su apreciación</p>
<p>5.2 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER CON EL TÉRMINO "<u>NO APLICA PARA ESTA LICITACIÓN</u>"; ES EXTENSIVO A TODOS LOS TEXTOS QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS DENTRO DEL NUMERAL 5.2, FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.</p>	<p>Es correcta su apreciación</p>
<p>NUMERAL 16 SANCIONES, SEGUNDO PÁRRAFO EL CUAL ESTABLECE QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, FRACCIÓN XIV Y 93, 98 Y 99 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, INHABILITARÁ TEMPORALMENTE EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR ESTA LEY</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN XIV, 93, 98 Y 99 DE REFERENCIA EN DICHO NUMERAL ES CORRECTO, YA QUE SE OBSERVA QUE NO GUARDA CORRESPONDENCIA CON LO DESCRITO CON EL PRESENTE NUMERAL. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>
<p>NUMERAL 16 SANCIONES, FRACCIÓN II LA CUAL ESTABLECE QUE EL PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 38, NUMERAL 1, FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI EL ARTÍCULO 38 NUMERAL 1 FRACCIÓN I DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA VIGENTE. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>NUMERAL 17 PENAS CONVENCIONALES, PRIMER PÁRRAFO, MENCIONA AL ART. 58 LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI EL ARTÍCULO 58 DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA VIGENTE. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>
<p>NUMERAL 18 PROHIBICION DE NEGOCIACION DE LAS BASES Y PROPUESTAS, ESTABLECE QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS PRESENTES BASES, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXXII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA VIGENTE.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXXII DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA VIGENTE. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>
<p>NUMERAL 19 CONTROVERSIAS, ESTABLECE QUE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN SE RESOLVERÁN CON APEGO A LO PREVISTO EN EL CAPITULO VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI EL CAPÍTULO VII DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA VIGENTE. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>

**PREGUNTAS DE HEMOSER SA DE CV**

**1.1.1.1.1 A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO**

PREGUNTA	RESPUESTA
<p><b>Numeral 3.7 Carta Garantía de los Servicios (Anexo 7)</b>                      "... que se compromete a garantizar los servicios, objeto de esta licitación, los cuales deberán ser nuevos y de marca registrada."</p>	<p>No se acepta</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Solicitamos a la convocante que para no encarecer los servicios, nos permita ofertar equipos analizadores de laboratorio clínico con 3 años de uso, en óptimas condiciones de funcionamiento, ser tecnología de vanguardia, sin que sean bienes correspondientes a saldos o remanentes, no ser discontinuados, que se permita su venta en el país de origen y que no hayan tenido alertas médicas por las autoridades sanitarias ¿Se acepta?</p>	<p style="text-align: right;">H</p>
<p><b>Numeral 3.10 Certificado de Empresa Colimense (Opcional)</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos aclare que, en caso de que mi representada no sea una empresa colimense, podamos integrar un documento en donde manifestemos que este numeral no aplica para nosotros ¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p style="text-align: right;">J</p>
<p><b>Numeral 3.12 Licencia de Giro Expedida por la Autoridad Competente</b></p> <p>“... o Aviso de Funcionamiento vigente a 2020 a nombre del licitante...”</p> <p>Debemos entender que al no tener una vigencia el Aviso de Funcionamiento emitido por la COFEPRIS, bastará con integrar dicho documento actualizado sin importar la fecha de trámite ¿Es correcto?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p> <p style="text-align: right;">K</p>
<p><b>Numeral 3.19 ISO 9001: 2015 del Licitante</b></p> <p>Debido a que solicita original para cotejo del Certificado ISO 9001: 2015 y a que no habría necesidad de presentar copia certificada del mismo, solicitamos a la convocante nos permita presentar copia simple del ISO 9001:2015 del licitante ¿Se acepta?</p>	<p>Deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo</p> <p style="text-align: right;">L</p>
<p><b>Numeral 3.19 ISO 9001: 2015 del Licitante</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita presentar un certificado ISO 9001: 2015 a nombre de mi representada con el siguiente alcance: “Servicios Integrales y No Integrales para Laboratorios y Bancos de Sangre, Abarcando: Abastecimiento de Reactivos, Consumibles y Analizadores; La Capacitación para su Operación, en casos necesarios, y el Mantenimiento para su Funcionamiento”, ya que es el mismo alcance solicitado en las bases pero con diferentes palabras y de no aceptarlo estaría limitando la libre participación de los</p>	<p>Se acepta, apegarse a lo solicitado en el numeral 3.19 de las bases</p> <p style="text-align: right;">M</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

*Handwritten mark*

<p>concurrentes ¿Se acepta?</p>	
<p><b>Numerales 3.20 Formato de Aclaración de Dudas y 3.21 Modelo de Contrato</b></p> <p>Debemos entender que para dar cumplimiento en los numerales mencionados, debemos presentar dichos formatos con leyenda de "Para Uso Informativo" y ser firmados por el Representante Legal del licitante ¿Es correcto?</p>	<p>Es correcta su apreciación, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten mark</i></p>
<p><b>Numeral 3.22 Propuesta Técnica y Económica</b></p> <p>Solicitamos a la convocante que separe en numerales distintos la Propuesta Técnica y Económica, ya que llevan folios independientes y forman parte de un mismo numeral. ¿Se acepta?</p>	<p>No se acepta</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten mark</i></p>
<p><b>Numeral 3.22 Propuesta Técnica y Económica, NOTA 2: Inciso d)</b>  "... Asimismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales."</p> <p>Debemos entender que los documentos originales que servirán para cotejo, sí podrán ser integrados en protectores de hojas ¿Es correcto?</p>	<p>Es correcta su apreciación</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten mark</i></p>
<p><b>Numeral 3.22 Propuesta Técnica y Económica "...BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD."</b></p> <p>Debemos entender que se deberá poner la leyenda de "Bajo Protesta de Decir Verdad" a cada una de las hojas membretadas del licitante que se presenten dentro de nuestra propuesta, sin incluir folletos, catálogos, manuales, registros sanitarios, certificados de calidad ISO 13485 o ISO 9001, Certificados de Libre Venta y todo aquel documento que no se pueda hacer modificación o editar por su propia naturaleza ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten mark</i></p>
<p><b>Numeral 3.22 Propuesta Técnica y Económica "...BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD."</b></p> <p>En caso de que la respuesta a nuestra pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante nos permita poner la leyenda de "Bajo Protesta de Decir Verdad" con un sello en cada una de las hojas que forman parte de nuestra propuesta, ya que hay documentos que no se pueden editar o al editarlos pierden su originalidad ¿Se</p>	<p>Se refiere a la respuesta anterior.</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten mark</i></p>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>acepta?</p> <p><b>Numeral 4.1 Propuesta Técnica y Económica</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita integrar nuestra propuesta técnica con el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anexo Número 1 Técnico</li> <li>2. Documentación Técnica y Regulatoria de los Equipos Analizadores de Laboratorio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fichas de especificaciones técnicas de los equipos analizadores de laboratorio</li> <li>• Catálogos, folletos y manuales referenciados</li> <li>• Registros Sanitarios de equipos, reactivos, controles y calibradores</li> <li>• Certificados de Calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 de los equipos analizadores de laboratorio</li> <li>• Certificados de Libre Venta del país de origen de los equipos analizadores de laboratorio (Acomodado por equipo solicitado)</li> </ul> </li> <li>3. Carta de Apoyo de los Fabricantes y/o Titular del Registro Sanitario y/o Distribuidores Primarios y/o Subdistribuidores de los equipos analizadores de laboratorio.</li> <li>4. Original para cotejo y copia simple del contrato celebrado durante los últimos 2 años con alguna dependencia o institución de gobierno.</li> <li>5. CD o USB con la propuesta Técnica y Económica de la información relativa al ANEXO Número 1 Técnico y Anexo Número 2 Económico, en formato Word y/o Excel.</li> </ol> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Las propuestas Técnica y Económica deberán presentarse dentro de un mismo sobre cerrado, pero integradas de manera individual conforme al criterio de cada licitante.</p> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;"> </div>
---	--

**B).- DE CARÁCTER TÉCNICO**

PREGUNTA	RESPUESTA
<p><b>Anexo Número 1 Técnico</b> <b>Inciso G - Equipos de Apoyo</b> <b>Inciso H - Equipos de Cómputo</b></p> <p>Debemos entender que debido a que no se encuentra en bases las especificaciones técnicas de los equipos mencionados en los incisos G y H del Anexo Número 1 Técnico, únicamente se mencionará en nuestra</p>	<p>Se debe entender en el inciso G de equipo de apoyo vienen algunas especificaciones que se deben cumplir y en el inciso H se debe cumplir la solicitud de PC todo en uno</p> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;"> </div>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>propuesta técnica la marca y modelo que proponemos ¿Es correcto?</p>	
<p><b>Anexo Número 1 Técnico Inciso B - Marco Analítico</b></p> <p>Solicitamos a la convocante el desglose del panel de pruebas con cantidades de los grupos solicitados en cada hospital, ya que sólo se desglosa el de Química Clínica.</p>	<p>Solo se cuenta con el de química clínica desglosado</p>
<p><b>Anexo Número 1 Técnico Inciso I - Insumos Necesarios para las Tres Fases - Fase Pre Analítica</b></p> <p>“(Presentar en la Propuesta Técnica: Fotografía y Descripción de Material)</p> <p>Debemos entender que para dar cumplimiento a este punto, debemos presentar folleto o catálogo de los insumos de la fase pre analítica en donde identifiquemos dicho insumo con una etiqueta, sin que sea necesario presentar ningún otro documento adicional ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Es correcto, siempre y cuando, el folleto o catálogo mencione las características del producto.</p>
<p><b>Anexo Número 1 Técnico Inciso J - Requerimientos Indispensables Adicionales</b></p> <p>“El licitante deberá realizar un convenio de servicio con laboratorio clínico privado en cada uno de los tres municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo, para la realización de exámenes en caso de descompostura o falla del equipo, pasando las 24 horas, en cualquiera de los diez laboratorios que forman la red estatal de los Servicios de Salud...”</p> <p>Debemos entender que este requisito se deberá cumplir una vez que el licitante resulte adjudicado ¿Es correcto?</p>	<p>Es correcto.</p>
<p><b>Anexo Número 1 Técnico Inciso K - Productividad, Equipos Requeridos y Especificaciones Técnicas por Unidad</b></p> <p><b>Equipo Analizador de Química Clínica I</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita procesar las pruebas de electrolitos en los equipos de Química Clínica en cada uno de los laboratorios de la red estatal. ¿Se acepta?</p>	<p>Se acepta siempre y cuando realice los 6 parámetros de electrolitos solicitados.</p>

✓

M

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p><b>Anexo Número 1 Técnico</b>  <b>Inciso L - Puntos de Propuesta Técnica</b>  <b>10. Programa de Laboratorio en Red (Plataforma de Operación de Laboratorios)</b></p> <p>“La plataforma de operación puede ser parecida o de similares características. El sistema debe estar desarrollado en idioma español, cuenta con ayuda en línea, es operable en internet (e intranet), su arquitectura debe ser cliente-servidor con x advantage, sql-server, mysql y otros permitiendo mantener un registro local de pacientes, con motores de base de datos en sistema operativo Windows 2008 server o mayor y Windows 8 o mayor en estaciones de trabajo...”</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un sistema web con tecnología MVC, cuyo motor de base de datos sea SQL server, mismos que se montarían en un servidor Windows 2008 server o superior ¿Se acepta?</p>	<p><b>Deberá Apegarse a lo estipulado en el anexo 1 Técnico, inciso L de las bases.</b></p>
<p><b>Anexo Número 1 Técnico</b>  <b>Inciso L - Puntos de Propuesta Técnica</b>  <b>10. Programa de Laboratorio en Red (Plataforma de Operación de Laboratorios)</b></p> <p>“Alimentación y consulta del expediente electrónico (ECE) vía HL7 (de acuerdo a la norma vigente) Validación de vigencia del afiliado...”</p> <p>¿Cuánto tiempo tenemos para conectarnos al ECE, a partir de que se nos entregue la documentación completa de (ECE) Endpoints, WSDL, Catálogos, etc.?</p>	<p><b>Una vez adjudicado se vería con el área de sistemas.</b></p>
<p><b>Anexo Número 1 Técnico</b>  <b>Inciso L - Puntos de Propuesta Técnica</b>  <b>10. Programa de Laboratorio en Red (Plataforma de Operación de Laboratorios)</b></p> <p>“El sistema debe de ser interoperable con cualquier sistema de información a través del estándar HL7 o ASTM, para dar aviso al momento en que el paciente acude al laboratorio, ordenados por fecha y hora de llegada...”</p> <p>¿El proveedor de dicho sistema de información nos proveerá la documentación Endpoint, WSDL, catálogos, etc.; para la implementación de la comunicación? y ¿En cuánto tiempo se deberá realizar dicha comunicación?</p>	<p><b>Deberá Apegarse a lo estipulado en el anexo 1 Técnico, inciso L de las bases.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

*Handwritten mark*

<p><b>Anexo Número 1 Técnico</b> <b>Inciso L - Puntos de Propuesta Técnica</b> <b>10. Programa de Laboratorio en Red (Plataforma de Operación de Laboratorios)</b></p> <p>“La solución de soporte del licitante deberá incluir ser un sistema tipo aplicación (APP) para solicitar servicios correctivos y capacitaciones a través de dispositivos móviles. Dicha solución de soporte deberá permitir a los usuarios:</p> <p>Por las características del Hospital Regional Universitario, en este laboratorio se requiere que el programa cuente con un llamador de personas en sala de espera o se le adecue un externo. el sistema de información y control estará sujeto a modificaciones y/o adecuaciones que el cliente considere necesarias sin costo alguno...”</p> <p>Se solicita a la convocante nos aclare si los dos párrafos tienen correlación y forman parte de la APP y esto es lo que debe realizar ó si son por separado y faltó información. Favor de aclarar.</p>	<p><b>Son temas diferentes. Y si faltó información la cual en su momento se solicitará al área de informática</b></p> <p><i>Handwritten signatures</i></p>
<p><b>Anexo Número 1 Técnico</b> <b>Inciso L - Puntos de Propuesta Técnica</b> <b>10. Programa de Laboratorio en Red (Plataforma de Operación de Laboratorios)</b></p> <p>“La solución de soporte del licitante deberá incluir ser un sistema tipo aplicación (APP) para solicitar servicios correctivos y capacitaciones a través de dispositivos móviles; dicha solución de soporte deberá permitir a los usuarios...”</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar como medio de soporte, un acceso a un sistema web para levantar sus tickets, ya que se podría utilizar de igual manera desde un smarthphone con conexión a internet y un navegador web ¿Se acepta?</p>	<p><b>Se acepta, sin que sea limitante para los demás participantes.</b></p> <p><i>Handwritten signature</i></p>
<p><b>Anexo Número 1 Técnico</b> <b>9. Equipamiento</b></p> <p>Solicitamos a la convocante que debido a que en las bases y el Anexo Número 1 Técnico no establece plazo para la instalación de los equipos de laboratorio y a que se establecen 30 días para instalar el sistema informático, se otorgue un plazo de 20 días naturales para la instalación de los equipos de laboratorio, equipos</p>	<p><b>Apegarse a la aclaración de la convocante.</b></p> <p><i>Handwritten signature</i></p>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

de apoyo y de cómputo ¿Se acepta?	
-----------------------------------	--

**C).- DE CARÁCTER LEGAL**

PREGUNTA	RESPUESTA
<p><b>Numeral 1.5 Seguros</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos aclare si el tipo de seguro a que se refiere este párrafo es de responsabilidad civil.</p>	<p>Es correcta su apreciación</p>
<p><b>Numeral 1.5 Seguros</b></p> <p>En caso de que su respuesta a mi pregunta anterior sea afirmativa y debido a la naturaleza del servicio contratado y a que se entregará una fianza para garantizar el cumplimiento de contrato, solicitamos a la convocante que elimine este requisito de las bases o el numeral quede sin efecto, ya que es innecesario entregar doble póliza de garantía, además de que encarecería los precios para los Servicios de Salud de Colima ¿Se acepta?</p>	<p>No se acepta su solicitud</p>
<p><b>1.13 Condiciones de Pago</b></p> <p>Debido a que se trata de una prestación de servicios y a que se cuenta con una serie de gastos operativos, pago a proveedores, impuestos e infraestructura, solicitamos a la convocante reducir el plazo máximo de pago y que cambie de 120 días naturales a máximo 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrega y validación de la factura correspondiente ¿Se acepta?</p>	<p>Las condiciones de pago serán las establecidas en el numeral 1.13 de las bases de la convocatoria.</p>
<p><b>1.13 Condiciones de Pago</b></p> <p>En caso de que la respuesta a mi pregunta anterior sea negativa, debemos entender que el pago de la factura correspondiente excede los 120 días naturales, los Servicios de Salud del Estado de Colima pagará al proveedor los gastos financieros conforme lo establece el Código Fiscal de Colima como si se tratase de una prórroga al Crédito Fiscal, tal y como lo menciona el artículo 56, numeral 2 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Las condiciones de pago serán las establecidas en el numeral 1.13 de las bases de la convocatoria.</p>

**PREGUNTAS DE DERIMEX SA DE CV**



**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>3. REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES</b></p> <p><b>3.1 DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPUESTAS Y</b></p> <p><b>3.10 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE</b>                      Solicitamos a la convocante nos confirme si al ser opcionales estos dos puntos (3.1 y 3.10), ¿se puede incluir una carta o escrito mencionando el motivo por lo que no se entregan, para no perder la secuencia de la numeración de la documentación?</p>	<p>Se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes presentarlo de esta manera.</p>
<p><b>3.22 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA</b>  <b>NOTA2, INCISO b)</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos indique cómo se deberán numerar todas y cada una de las hojas, de manera individual la propuesta técnica y económica, la pregunta es acerca de los demás documentos: ¿Cuál sería el orden lógico de la numeración de todos esos documentos: como los anexos, las actas constitutivas, la declaración anual, etc.?</p>	<p>Se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. Tal y como lo establece el numeral 3.22, nota 2, inciso b de las bases.</p>
<p><b>5. FIRMA DEL CONTRATO</b></p> <p>Se menciona acerca de que el contrato estará sujeto a disponibilidad presupuestaria de <b>CUOTA SOCIAL,</b></p>	<p>Se cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir la obligación que derive de la presente licitación.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p><b>FASSA, SEGURO MEDICO SIGLO XXI, FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATRATOFICOS</b>, Solicitamos a la convocante nos confirme: en el supuesto de no existir suficiencia presupuestaria, No estamos obligados a seguir surtiendo, ¿es correcta la apreciación?</p>	
<p><b>5.2 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS</b></p> <p>Solicitamos a la convocante que nos aclare el texto en las Bases donde se observa el siguiente enunciado:</p> <p><b><u>“NO APLICA PARA ESTA LICITACION”</u></b></p> <p>Favor de indicar si el texto que se tiene en este punto, es correcto, es decir que no aplica la Garantía de Vicios ocultos o hay que hacer caso omiso a este enunciado y considerar el punto 5.2.</p>	<p>Este requisito no aplica para el presente proceso de licitación.</p>
<p><b>22. RETIRO DE EQUIPOS</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos aclare, en este punto del retiro de los equipos instalados en un lapso máximo de 15 días ¿qué casos se refiere?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rescisión de contrato</li> <li>- Termino o finalización de la vigencia del contrato</li> </ul>	<p>La solicitud de aclaración no está debidamente dirigida a un punto específico de las bases. No tiene relación con el objeto de la licitación.</p>

**B).- DE CARACTER TECNICO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>PUNTO 1.3 RECOLECCION Y TRASLADO DE MUESTRAS</b></p> <p>Se menciona acerca del traslado de las</p>	<p>El programa deberá contemplar 2 a 3 veces por semana y será bajo acuerdo con los responsables de la Red Estatal de laboratorios (logística).</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>muestras serológicas de los laboratorios Generadores a los Concentradores ¿El programa de recolección que se menciona con que periodicidad es?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Diario</li> <li>-Cada determinados días (2 a 3 veces por semana)</li> <li>- Semanalmente</li> </ul> <p>Solicitamos a la convocante nos indique: ¿Qué unidades reciben en LESP y cuales el HRU? ¿o reciben las muestras de acuerdo a alguna planificación?</p>	
<p>Solicitamos a la convocante nos confirme si en el caso de NO entregarse bienes con temperatura de congelación ¿no será necesario entregar por parte del licitante congeladores o equipos de refrigeración con congelador?</p>	<p><b>Es correcto.</b></p>
<p><b>PROPUESTA TECNICA</b>  <b>Cuadro (I) INSUMOS NECESARIOS PARA LAS TRES FASES</b></p> <p>Referente a la fase pre analítica, ¿serían tan a amable la convocantes indicarnos el consumo de cada insumo de manera mensual?</p>	<p><b>El consumo será de acuerdo al número de pruebas mensuales más una cantidad adicional como reserva para en caso de algún incremento.</b></p>
<p>Se indica presentar en la propuesta técnica: Fotografía y descripción de material, solicitamos a la convocante nos confirme si ¿es posible entregar una carta o cartas por cada rubro <b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD</b> que se cumplen con las características de calidad necesarias para esta licitación?</p>	<p><b>Deberán agregar fotografía y características de los equipos a surtir en la presente licitación.</b></p>
<p><b>Anexo Número 1 técnico. Laboratorio Estatal. Equipo Automatizado de detección</b></p>	<p><b>Apegarse a lo estipulado en el Anexo número 1 Técnico de las bases</b></p>

nd  
 es  
 y  
 A  
 C  
 y

L

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

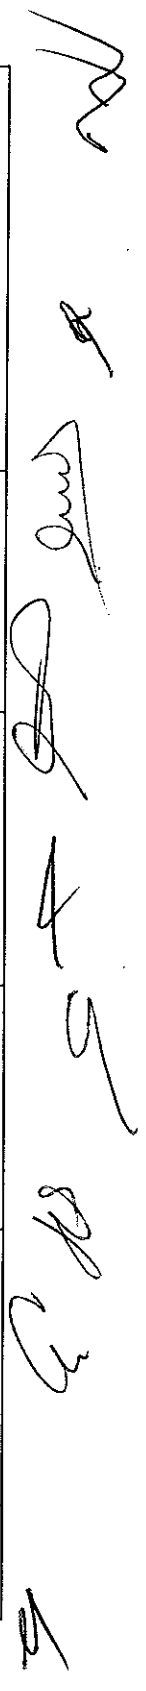
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p><b>microbiana. Insumos necesarios.</b></p> <p>Solicitamos a la convocante poder ofertar botellas de hemocultivos para adultos aerobias y anaerobias, ya que el utilizar estas dos botellas en un mismo paciente incrementa la cantidad de patógenos recuperados por el volumen de sangre utilizado, ¿se acepta?</p>	
<p>Se le solicita a la convocante nos indique el consumo anual de botellas de hemocultivo ya que se menciona un total de (3,600 sangre/fluidos corporales anualmente) cantidad mayor al total de pruebas anuales solicitadas, en Bacteriología (2,072 pruebas) por el Laboratorio Estatal de Salud Pública</p>	<p><b>El número estimado para hemocultivos es de 2101.</b></p>
<p><b>Equipo de Bacteriología I.</b></p> <p>Solicitamos a la convocante acepte que la entrega de las cepas ATCC solo se realice como única ocasión al inicio del contrato para validación del equipo.</p>	<p><b>Apegarse a lo estipulado en el Anexo número 1 Técnico de las bases</b></p>
<p><b>Anexo Número 1 técnico. Hospital Regional Universitario. Equipo de Bacteriología II.</b></p> <p>Solicitamos a la convocante acepte que la entrega de las cepas ATCC solo se realice como única ocasión al inicio del contrato para validación del equipo.</p>	<p><b>Apegarse a lo estipulado en el Anexo número 1 Técnico de las bases</b></p>
<p><b>Anexo Número 1 técnico. Hospital Regional Universitario</b></p> <p>Solicitamos a la convocante poder ofertar un equipo para inmunología con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Principio de medición de ELFA</li> <li>· Capacidad de procesamiento: Realizar 30 test</li> <li>· Volumen máximo de muestra 200 µl</li> <li>· Muestras en cartucho</li> </ul>	<p><b>Apegarse a lo estipulado en el Anexo número 1 Técnico de las bases</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>· Todos los reactivos están incluidos en el kit</li> <li>· Temperatura controlada.</li> <li>· Equipo con lector de código de barras para leer la información codificada del cartucho</li> <li>· Calibración manual y automática</li> <li>· Control de Calidad integrado</li> <li>· Puerto para conexión interface</li> <li>· Software en español</li> <li>· Pantalla e impresora integrados</li> <li>· Cuento con No break integrado o adicional con capacidad de carga para 15 min. para respaldo</li> </ul>	
<p><b>Anexo Número 1 técnico. Laboratorio Estatal de Salud Pública. Equipo de Bacteriología I. Medios de Cultivo</b></p> <p>Solicitamos a la convocante poder ofertar en lugar de Agar sangre el medio de cultivo Agar Columbia +5% de sangre de cordero (COS).</p>	<p><b>Apegarse a lo estipulado en el Anexo número 1 Técnico de las bases</b></p>
<p><b>Anexo Número 1 técnico. Laboratorio Estatal de Salud Pública. Equipo de Bacteriología I. Medios de Cultivo</b></p> <p>Solicitamos a la convocante poder ofertar medios de cultivo con presentación de caja con 20 placas, la cual contiene 2 paquetes con bolsa de 10 placas.</p>	<p><b>Ajustar la presentación ofertada a la cantidad necesaria.</b></p>
<p><b>Anexo Número 1 técnico. Hospital Regional Universitario. Equipo de Bacteriología II. Medios de Cultivo</b></p> <p>Solicitamos a la convocante poder ofertar en lugar de Agar sangre el medio de cultivo Agar Columbia +5% de sangre de cordero (COS).</p>	<p><b>Apegarse a lo estipulado en el Anexo número 1 Técnico de las bases</b></p>
<p><b>Anexo Número 1 técnico. Hospital Regional Universitario. Equipo de Bacteriología II. Medios de Cultivo</b></p> <p>Solicitamos a la convocante poder ofertar medios de cultivo con presentación de caja con 20 placas, la cual contiene 2 paquetes con bolsa de 10 placas.</p>	<p><b>Ajustar la presentación ofertada a la cantidad necesaria.</b></p>
<p><b>PUNTOS PROPUESTA TECNICA</b></p> <p><b>18. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y</b></p>	<p><b>Apegarse al punto "18.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y</b></p>





SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p><b>CORRECTIVO</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos especifique cuales son todos los elementos que conforman la red de comunicación motivo del alcance de esta licitación.</p>	<p><b>CORRECTIVO A EQUIPOS ANALITICOS DE APOYO Y DE CÓMPUTO” de las bases.</b></p>
<p><b>PUNTOS PROPUESTA TECNICA</b></p> <p><b>19.ASISTENCIA TECNICA</b></p> <p>Solicitamos a la convocante nos indique en la asistencia técnica, donde se menciona que se debe proporcionar las 24 horas los 365 días la asistencia de ingeniería técnica, esta asistencia ¿puede ser en horarios y/o sitios que se acuerden vía telefónica o es necesario presencia en sitio?</p>	<p><b>Es necesario la presencia en sitio</b></p>

**C).- DE CARACTER LEGAL**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>PUNTO 1.5 SEGUROS,</b></p> <p>Solicitamos a la convocante que nos indique si serían tan amables de especificar para este punto:</p> <p>Se menciona acerca de contar con una póliza que garantice la integridad de los servicios, también del patrimonio de LOS SERVICIOS DE SALUD DE COLIMA, podrían ejemplificar e indicar casos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿a qué se refiere con daños causados al patrimonio?</li> <li>- ¿a qué se refiere con los bienes que tenga en concesión?</li> <li>- ¿a qué se refiere con daños que se causen a terceros en bienes y personas?</li> </ul> <p>¿Se tiene algún tiempo límite, después de la firma del contrato para contar con esta póliza?</p>	<p>Cualquier daño que pudiera causar a los Servicios de Salud o a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación de los servicios materia del presente contrato. Deberá presentarlo a la firma del contrato.</p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LOS EQUIPOS ANALIZADORES OFERTADOS ¿ES CORRECTO?	
PREGUNTA 5. REFERENCIA: 4.1 INCISO J)  SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE QUE SE DIFIERA LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO CON FECHA ORIGINAL DE PRESENTACIÓN ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 4.1 inciso j) de las bases.
PREGUNTA 6. REFERENCIA: 4.1 INCISO K)  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO ADJUNTANDO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL CONTRATO PRESENTADO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL ¿SE ACEPTA?	No se acepta. Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 4.1 inciso k) de las bases.
PREGUNTA 7. REFERENCIA: ANEXO TECNICO 1, INCISO J) RECUADRO 7  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARTAS DE APOYO SOLICITADAS DE LOS EQUIPOS ANALITICOS DEBERAN PRESENTARSE POR PARTE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SUBDISTRIBUIDOR TAL COMO SE SOLICITA EN EL NUMERLA 4.1 INCISO J) DE LAS BASES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Las cartas que se presenten, deberán manifestar el respaldo al licitante que participe en esta licitación.
PREGUNTA 8. REFERENCIA: ANEXO NUMERO 2 ECONOMICO  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE	Se deberán incluir los montos máximos anuales de todas las unidades médicas

*Handwritten mark*

*Vertical handwritten marks and signatures on the right margin*

*Handwritten mark at the bottom right*



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

SI EN EL RECUADRO EN DONDE DICE CANTIDAD MAXIMA 100% SE DEBERAN INCLUIR LOS MONTOS MAXIMOS MENSUALES O ANUALES. FAVOR DE ACLARAR	
PREGUNTA 9. REFERENCIA: 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE PREGUNTA 10. PARA EL CASO DE AQUELLOS CATALOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES QUE VENGAN EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL SE NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL DE UNICAMENTE LO REFERENCIADO ¿SE ACEPTA?	La solicitud de aclaración número 9 no está debidamente planteada, por lo cual se desecha.  Pregunta 10.- Se acepta

**B). - DE CARACTER TECNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
PREGUNTA 11. REFERENCIA: ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO G): CONGELADOR (5 PIES CUBICOS)  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL RANGO DE TEMPERATURA	De 0°C a -20°C
PREGUNTA 12. REFERENCIA: ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO I): ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 76%  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AL 70%	Sí, se acepta alcohol etílico desnaturalizado del 70% al 76%
PREGUNTA 13. REFERENCIA: ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO L): PUNTO 5  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE	De 2 a 3 maletines para la recolección de muestras en los 9 laboratorios.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LA CANTIDAD A OFERTAR DE LOS MALETINES	
<p>PREGUNTA 14.                  ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (L) PUNTOS DE PROPUESTA TÉCNICA. 1.- PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. TODA PROPUESTA DE EQUIPO ANALITICO, DE APOYO E INFORMATICO DE ESTE ANEXO, DEBERA PRESENTARSE EN LA PROPUESTA TECNICA, CON FOLLETO U HOJA CON FOTOGRAFÍA, EN ESPAÑOL Y CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO.                  Debemos entender que, en la propuesta técnica, únicamente se presentara las portadas y las paginas referenciadas de los documentos, folletos, catálogos y manuales. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Es correcta siempre y cuando vengan las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos.</p>
<p>PREGUNTA 15.                  ANEXO No. 1 TÉCNICO. ANEXOS TÉCNICOS. Solicitamos a la amable convocante nos permita entregar manifiesto con la leyenda de: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", en aquellos casos en que no podamos señalar en la documentación técnica, algún punto de las especificaciones requeridas, pero, que el analizador o equipo sí cuente con ella y/o realice dicha función. ¿Se acepta?</p>	<p>No se acepta, las especificaciones del equipo deberán venir claramente identificadas.</p>
<p>PREGUNTA 16.                  ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (K) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD.                   Con motivo de elaboración de una adecuada propuesta económica, solicitamos a la convocante nos aclare de las 10 unidades (CSC, CST, CSM, HRU, HMI, IEC, HGI, HGT, HGM, LESP) la productividad mensual y anual según corresponda a las siguientes pruebas:</p>	<p>Se desconoce la cantidad.</p>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Hematología (en el caso que requieran).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Biometría hemática rutina.</li><li>• Reticulocitos (prueba no de incluida en BH rutina)</li><li>• Líquidos corporales diferencial (prueba no de incluida en BH rutina)</li><li>• Plaquetas fluorescentes (prueba no de incluida en BH rutina)</li></ul> <p>Coagulación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiempo de Trombina</li><li>• Tiempo de Protrombina</li><li>• Tiempo de Tromboplastina Parcial</li><li>• Fibrinógeno</li><li>• Dímero D</li><li>• Factores de coagulación (Definir Factor Especifico)</li><li>• Pruebas especiales (Definir tipo de prueba)</li></ul> <p>Electrolitos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sodio</li><li>• Potasio</li><li>• Cloro</li></ul> <p>Inmunología (Hormonas/Marcadores tumorales).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Triyodotironina (T3 Total).</li><li>• Tiroxina (T4 Total).</li><li>• Tiroxina Libre (T4 Libre).</li><li>• Hormona Estimulante del Tiroides (H.T.S.H.).</li><li>• Triyodotironina (T3 Libre).</li><li>• T3 Uptake</li><li>• Tiroglobulina</li><li>• Hormona Folículo Estimulante (F.S.H.).</li><li>• Hormona Luteinizante (L.H.)</li><li>• Progesterona</li><li>• Procalcitonina</li><li>• Estradiol</li><li>• Prolactina</li><li>• Hormona Gonadotropina Coriónica sub-unidad Beta. (H.C.G. <math>\beta</math>).</li><li>• Testosterona</li><li>• Antígeno Prostático</li><li>• Alfa-fetoproteína</li></ul>	<p><i>[Handwritten notes and signatures in the right column]</i></p>
--	--

*[Handwritten mark]*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antígeno Carcinoembrionario.</li> <li>• Ag. CA 125</li> <li>• Ag. CA 15-3</li> <li>• Ag. 19-9</li> <li>• Anticuerpos anti péptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP)</li> <li>• Péptido natriurético tipo B (BNP)</li> <li>• Troponina</li> <li>• Troponina T y I</li> </ul> <p>Inmunohemato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupos sanguíneos (AB0)</li> <li>• Pruebas cruzadas</li> <li>• Rastreo de anticuerpos (Definir tipo de prueba)</li> </ul>	
<p>PREGUNTA 17.                  ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (F) EQUIPOS ANALITICOS.                  EN LA TABLA QUE PRESENTA TAL INCISO, NOS MUESTRA 6 EQUIPOS DE ELECTROLITOS SOLICITADOS PARA LAS UNIDADES HRU, HMI, HGI, HGT, HGM E IEC; SIN EMBARGO, EN LOS REQUERIMIENTOS POR HOSPITAL NO VIENE DESCRIPCIÓN PARA DICHO EQUIPO.</p> <p>Con base en que los analizadores requeridos para las áreas de química clínica de las unidades HRU, HGT y HGM, cuentan con la tecnología de procesar Na, K, Cl, Ca, P y Mg, además de tener la capacidad de suficiente rendimiento para soportar la carga de productividad; solicitamos a la amable convocante nos aclare si se podrá procesar electrolitos séricos completos en las plataformas de química clínica I, omitiendo la instalación de equipo alterno.</p>	<p><b>Sí, se acepta para HRU, HGT y HGM. En caso de que los analizadores de química clínica II para HGI, HMI e IEC no cuenten con la realización de estas pruebas, se deberá poner un equipo adicional para electrolitos.</b></p>
<p>PREGUNTA 18.                  ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (F) EQUIPOS ANALITICOS.                  EN LA TABLA QUE PRESENTA TAL INCISO, NOS MUESTRA 6 EQUIPOS DE ELECTROLITOS SOLICITADOS PARA LAS UNIDADES HRU, HMI, HGI, HGT, HGM E IEC; SIN EMBARGO, EN LOS</p>	<p><b>Se acepta siempre y cuando realice las 6 determinaciones de electrolitos solicitados</b></p>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>REQUERIMIENTOS POR HOSPITAL NO VIENE DESCRIPCIÓN PARA DICHO EQUIPO.</p> <p>De acuerdo con la baja productividad de electrolitos séricos que presentan las unidades HGI, IEC, HMI; debemos entender que podremos ofertar un equipo de química clínica tipo 2 que sea capaz de procesar dichas pruebas y/o instalar equipo alterno con un rendimiento entre 40 y 60 pruebas por hora y de tecnología de vanguardia. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>PREGUNTA 19. ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (I) INSUMOS NECESARIOS PARA LAS TRES FASES. CEPAS CONTROL ATCC.</p> <p>Debemos entender que las cepas ATCC serán suministradas de acuerdo con la información y especificaciones del analizador ofertado en nuestra propuesta técnica. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>Sí es correcta, siempre y cuando se lleve a cabo de manera puntual.</b></p>
<p>PREGUNTA 20. ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (J) REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES ADICIONALES. EL LICITANTE DEBERÁ INSTALAR EQUIPOS DE A/A INVERTER (AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA), EN LAS ÁREAS DE LABORATORIOS QUE SE REQUIERA PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS EQUIPOS ANALÍTICOS. SE DEBERÁ PRESENTAR PROPUESTA CON FOTOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN.</p> <p>Debemos entender que al citar fotografía y descripción podremos presentar en la propuesta técnica folleto, catalogo y/o manual de dicho requerimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>Es correcto, siempre y cuando se especifique son A/A inverter.</b></p>
<p>PREGUNTA 21. ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (J) REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES</p>	<p><b>Es correcto, siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>ADICIONALES. EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL Y VEHÍCULO CON TERMOS ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS SANGUÍNEAS Y SUEROS DE HUMANOS, DE UNIDADES GENERADORAS A UNIDADES CONCENTRADORAS EN DÍAS Y HORARIOS QUE SE DETERMINEN. SE DEBERÁ PRESENTAR PROPUESTA DE TERMO CON FOTOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN.</p> <p>Debemos entender que al citar fotografía y descripción podremos presentar en la propuesta técnica folleto, catalogo y/o manual de dicho requerimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>PREGUNTA 22. ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (J) REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES ADICIONALES. EL LICITANTE DEBERÁ HACER LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE MÍNIMO 20 MB EN LAS 10 UNIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS Y LESP.</p> <p>De acuerdo con el uso que se le dará a este servicio que, únicamente será de soporte técnico y actualizaciones para el software de los analizadores, y no, para uso personal ni recreativo, tenemos como conclusión que la demanda no será continua ni saturada, por lo que, solicitamos a la amable convocante nos permita ofertar un servicio de entre 5MB y 10MB, capacidad suficiente para soportar el requerimiento. ¿Se acepta?</p>	<p>Apegarse a lo estipulado en el anexo número 1 Técnico de las bases.</p>
<p>PREGUNTA 23. ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (J) REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES ADICIONALES. EL LICITANTE DEBERÁ TENER PERSONAL DE INFORMÁTICA EN EL ESTADO PARA DAR RESPUESTA PERSONALIZADA E INMEDIATA EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, IXTLAHUACÁN,</p>	<p>Se acepta.</p>





SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>TECOMÁN Y MANZANILLO.</p> <p>Solicitamos a la convocante poder entregar para dicho requerimiento manifiesto con la leyenda de: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". ¿Se acepta?</p>	
<p>PREGUNTA 24.                  ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (J)                  REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES ADICIONALES.                  EL LICITANTE DEBERÁ INSTALAR UNA PC ALL IN ONE, ADICIONAL AL MENCIONADO EN EL APARTADO (H), EN CADA JEFATURA DE LABORATORIO.                  PRESENTAR PROPUESTA CON FOTOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN.</p> <p>Debemos entender que al citar fotografía y descripción podremos presentar en la propuesta técnica folleto, catalogo y/o manual de dicho requerimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>Es correcto siempre y cuando cumpla con especificaciones de PC todo en uno.</b></p>
<p>PREGUNTA 25.                  ANEXO No. 1 TÉCNICO. INCISO (K)                  PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD. (FICHAS)                  ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA I.                  ANALIZADOR PARA PRUEBAS HEMATOLÓGICAS CON DIFERENCIAL DE 6 PARTES QUE REALICE 31 PARÁMETROS (QUE INCLUYA RETICULOCITOS) HISTOGRAMAS Y DISPERSOGRAMA.</p> <p>Debido a que el parámetro de reticulocitos no está dentro de los procesos rutinarios de la citometría hemática, se requiere utilizar la flexibilidad y escalabilidad de los equipos, y, esto conlleva a la adquisición de licencias extras para que la plataforma pueda resolver el requerimiento de este punto. Con lo anterior aclarado solicitamos a la amable convocante nos indique cuál sería la productividad de reticulocitos en el Hospital Regional Universitario, Hospital General</p>	<p><b>Apegarse a lo estipulado en el anexo número 1 Técnico de las bases ya que se requiere la determinación de reticulocitos</b></p>

M  
 S  
 J  
 P  
 S  
 C  
 S

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>de Manzanillo y Hospital General de Tecomán para incluirla en la propuesta económica.</p>	
<p>PREGUNTA 26.                  ANEXO NO. 1 TÉCNICO. INCISO (K)                  PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD. (FICHAS)                  ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA I REALICE LECTURA DE LÍQUIDOS CORPORALES</p> <p>Debido a que los parámetros para líquidos corporales no están dentro de los procesos rutinarios de la citometría hemática, se requiere utilizar la flexibilidad y escalabilidad de los equipos, y, esto conlleva a la adquisición de licencias extras para que la plataforma pueda resolver el requerimiento de este punto. Con lo anterior aclarado solicitamos a la amable convocante nos indique cuál sería la productividad de líquidos corporales en el Hospital Regional Universitario, Hospital General de Manzanillo y Hospital General de Tecomán para incluirla en la propuesta económica.</p>	<p>Apegarse a lo estipulado en el anexo número 1 Técnico de las bases ya que se requiere se procesen este tipo de muestras.</p>
<p>PREGUNTA 27.                  ANEXO NO. 1 TÉCNICO. INCISO (K)                  PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD. (FICHAS)                  ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA I Con sistema que permita elegir los parámetros a analizar.</p> <p>Debemos entender que el punto hace referencia a todos aquellos parámetros que están clínicamente considerados dentro de un procesamiento de citometría hemática de rutina, dejando fuera a los que para su obtención se requiera en la plataforma una adecuación extra. En el caso de sean solicitados parámetros ajenos a los de rutina, entendemos que para el Hospital Regional</p>	<p>Apegarse a lo estipulado en el anexo número 1 Técnico de las bases</p>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>su área de trabajo, por lo que, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo de mesa, con el rendimiento y parámetros solicitados. ¿Se acepta?</p>	
<p>PREGUNTA 30.                  ANEXO NO. 1 TÉCNICO. INCISO (K)                  PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD. (FICHAS)                  ANALIZADOR DE GASES.                  REQUIERE DE UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS.</p> <p>Debemos entender que un solo cartucho refiere a un paquete único de reactivos para la calibración de metabolitos y solución de lavado. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta.</p>
<p>PREGUNTA 31                  ANEXO NO. 1 TÉCNICO. INCISO (K)                  PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD. (FICHAS)                  ANALIZADOR DE GASES.                  EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINACIONES DE GASES.</p> <p>Debemos entender que la metodología para garantizar el procesamiento de las muestras y obtención de los parámetros que se incluyen en una determinación de gases podrá ser con sensores electrodos libres de mantenimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Apegarse a lo estipulado en el anexo número 1 Técnico de las bases</p>
<p>PREGUNTA 32.                  ANEXO NO. 1 TÉCNICO. INCISO (K)                  PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD.                  LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA                  NÚMERO DE PRUEBAS POR ÁREA Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL LESP.</p>	<p>No se cuenta con la productividad del laboratorio estatal durante los 2 últimos años ya que la prueba bacteriológica de urocultivo se encuentra suspendida hasta el momento por falta de insumos.</p>

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and marks on the right margin*

*Handwritten mark*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Solicitamos a la convocante nos aclare cuál es la productividad de uroanálisis, ya que se esta solicitando equipo de URIANALISIS TIPO II y no se especifica que cantidad de estudios mensuales tiene dicha unidad.</p>	
<p>PREGUNTA 33.  ANEXO NO. 1 TÉCNICO. URIANALISIS TIPO II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUIPO PARA DETERMINACIÓN BIOQUÍMICA DE ORINA</li> <li>• TIRA REACTIVA DE 10 A 11 PARÁMETROS COMO MÍNIMO.</li> <li>• QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ELIMINAR LA INTERFERENCIA DEL ÁCIDO ASCÓRBICO.</li> <li>• CAPACIDAD DE 400-500 TIRAS POR HORA.</li> <li>• CHAROLA PARA DESECHO DE TIRAS</li> <li>• EQUIPO CON UNIDAD DE CAPTURA DE SEDIMENTO URINARIO.</li> <li>• CUENTE CON INTERFACE PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO.</li> <li>• MONITOR E IMPRESORA INTEGRADO O ADICIONAL.</li> <li>• CUENTE CON REGULADOR.</li> <li>• CON INTERFACE PARA SISTEMA INFORMÁTICO.</li> <li>• QUE LAS TIRAS REACTIVAS SEAN DE LA MISMA MARCA QUE LOS EQUIPOS.</li> </ul> <p>Debido a que la información proporcionada en dicho anexo la productividad reflejada por día (mensual/30) de las unidades es baja: HGI (4 diarias), IEC (1 diaria), HMI (6 diarias), CSC (15 diarias), CST (11 diarias), CSM (11 diaras) y LESP (0 diaras). Solicitamos a la amable convocante nos permita ofertar un equipo con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que procese los siguientes analitos. Cetonas, Leucocitos, Proteínas, Glucosa, Nitritos, pH, Bilirrubina, eritrocitos, Urobilinógeno, gravedad específica, con capacidad de eliminar la interferencia del ácido ascórbico.</li> </ul>	<p><b>No se acepta, ya que esta productividad no es real debido a la falta constate de reactivos durante todo 2019</b></p>

*Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.*

A/1

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<ul style="list-style-type: none"><li>• Longitud de onda de 565nm, 610 nm</li><li>• Realice 50 a 100 pruebas por hora</li><li>• fotómetro de reflectancia</li><li>• Capacidad de 100 resultados en memoria</li><li>• Pantalla táctil integrada</li><li>• Lector de código de barras</li><li>• Opciones de unidades de reporte</li><li>• Impresora térmica incluida</li><li>• Incluye interfaz para transferencia de datos</li><li>• Cuento con tira de calibración</li><li>• Ciclo de medición: 70 seg / examen con incubación</li><li>• Cuento con modo normal y modo rapido</li><li>• Capacidad de autocontrol</li><li>• Idioma software español</li><li>• Cuento con control de calidad</li></ul>	<p>¿Se acepta?</p>
--	--------------------

3.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desechada.

4.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

5.- La convocante hace la aclaración que con respecto en el punto G) Equipo de apoyo se anexa al final de la presente acta las especificaciones Técnicas.

6.- La convocante informa que al final de la presente acta se anexa una tabla en la que se indica algunas aclaraciones a las bases, realizadas por el área técnica.

7. – La convocante informa que la vigencia del contrato objeto de la presente licitación será del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre del 2021.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1





PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

8.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrarán el día **17 de febrero** del presente año, a las **10:00 horas**; en tanto que el fallo se celebrará el **20 de febrero** a las **10:00 horas**.


9.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **12:46 (doce cuarenta y seis )** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

**FUNCIONARIOS**

Nombre	Firma
C.P. Rosalba Núñez Rosas Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales	
C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez Jefe del departamento de Adquisiciones	
Lic. Edgar Adrián Alonso Heredia Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos	
Q.F.B. Ramón Rodríguez Alcaraz Representante del Laboratorio Estatal de Salud Pública	


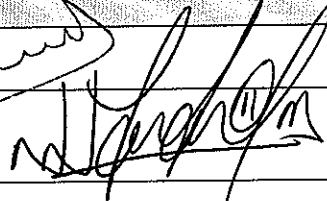



**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL/ CONTRALORÍA DEL ESTADO**

Nombre	Firma
Lic. German Avalos Magaña Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado	

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**LICITANTES**

Nombre	Firma
Laboratorios LICON S.A. Representado por: Diana Berenice García Badillo	
HEMOSER S.A. DE C.V. Representado por: Ricardo Levith Nuñez Nepomuceno	
DISTRIBUIDORA LHAG S.A. DE C.V. Representado por: Pedro Martínez Acosta	
DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V. Representado por: Alfredo Alejandro Ruiz García	
DISEQUI S.A. DE C.V. Representado por: María de los Ángeles Zamora Aguirre	

*Handwritten mark*

*Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including 'T. el' and 'G. H. F.'*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS  
LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<b>(G) EQUIPO DE APOYO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
AGITADOR HORIZONTAL DE PLACAS	<p>Capacidad de carga: Hasta 3 Kg.</p> <p>Superficie de trabajo: 230 x 230 mm con plancha de caucho antideslizante.</p> <p>Velocidad de agitación: 50 a 240 r.p.m. Digital</p> <p>Control de velocidad: Electrónico con microprocesador.</p> <p>Ajuste y lectura de r.p.m.: Digital con dígitos de 13 mm de altura para fácil lectura.</p> <p>Timer electrónico digital de 0 a 99 minutos.</p> <p>Interruptor principal con piloto incluido.</p> <p>Excentricidad: 20 mm.</p> <p>Alarma: Terminación de ciclo, audible.</p>
CENTRÍFUGA 24 PLAZAS 3500 rpm	<p>Rotor fijo de 24 lugares para tubos de 10 a 15 ml</p> <p>Rango de tiempo: 0-99 min.</p> <p>Máx RCF: 2,220 xg</p> <p>Ruido: menor a 50 Db</p> <p>Peso: 10 Kg</p> <p>Dimensiones: 330 x 420 x 275 mm</p> <p>Alimentación: 120V, 5ª</p> <p>Frecuencia: 50 Hz</p>
REFRIGERADOR VERTICAL DE VITRINA	<p>Temperatura 2-10°C (configurable), con graficador y termómetro digital de 14 a 19 pies cúbicos</p>
PLACA AGITADOR DE TUBOS	<p>Digital, velocidad de 0-20 rpm., tiempo 0-120 minutos</p>
PIANO CUENTA CÉLULAS	<p>Contador mecánico (manual) de células sanguíneas;</p> <p>Cuerpo (estructura externa) moldeado en plástico resistente;</p> <p>Base y mecanismo interno de metal;</p> <p>Registros de cuenta con 8 teclas (3 dígitos para cada tecla); • Basófilos / Eosinófilos / Linfocitos / Mielocitos / Monocitos / Neutrófilos / Plaquetas y Segmentados.</p> <p>Registros individuales que indican porcentajes; Totalizador de recuento con alcance hasta 999; Indicador sonoro cuando la cuenta alcanza el valor 100; Botones giratorios en los laterales para poner a cero la cuenta.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-001-2020  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

CONGELADOR (5 PIES CUBICOS),	Temperatura 0°c a -20°c (configurable), Puerta y gabinete con aislamiento Canasta de metal
CENTRÍFUGA 3600 RPM SEROFUGE DE CABEZAL FIJO	El rotor se bloquea de forma autónoma y su asiento es seguro y estable sin necesidad de tornillos ni apriete. Para 6 tubos de 12 x 75 mm Velocidad máxima 6000 rpm

CONCEPTO	DICE	DEBE DECIR
Analizador de Gases	parámetros calculados en sangre.	HCO3, HCO3std, TCO2, BEecf, BE(B), SO2cTHbc, A-aDO2, pAO2, paO2/pAO2, RI
Hospital General de Manzanillo	<b>EQUIPO DE COAGULACIÓN TIPO II</b>	<b>EQUIPO DE COAGULACIÓN TIPO I</b>
ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I	Electrolitos	FÓSFORO, MAGNESIO, CALCIO, CLORO, SODIO Y POTASIO, EN SUERO Y ORINA.
(L) PUNTOS DE PROPUESTA TÉCNICA	TODA PROPUESTA DE EQUIPO ANALÍTICO, DE APOYO E INFORMATICO DE ESTE ANEXO, DEBERA PRESENTARSE EN LA <b>PROPUESTA TÉCNICA</b> , CON FOLLETO U HOJA CON FOTOGRAFÍA, EN ESPAÑOL Y CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO. EN CASO CONTRARIO LA PROPUESTA DE EQUIPO PODRA SER DESECHADA, POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA SU VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN.	TODA PROPUESTA DE EQUIPO ANALITICO, DE APOYO E INFORMATICO DE ESTE ANEXO, DEBERA PRESENTARSE EN LA <b>PROPUESTA TÉCNICA</b> , CON FOLLETO U HOJA CON FOTOGRAFÍA, EN ESPAÑOL Y CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO. DE IGUAL MANERA DEBERA SEÑALAR CON MARCA TEXTO EN LOS FOLLETOS U ANEXOS. *PARA LOS EQUIPOS ANALITICOS; LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Y LAS PRUEBAS QUE REALIZA. *PARA LOS EQUIPOS DE APOYO; LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS *PARA LOS EQUIPOS DE INFORMATICA; PC TODO EN UNO EN CASO CONTRARIO LA PROPUESTA DE EQUIPO PODRA SER DESECHADA, POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA SU VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN.
7.- FALLA O DESCOMPOSTURA DE EQUIPO O CARENCIA DE INSUMOS.	Falla, descompostura o falta de cualquier insumo necesario para el proceso de alguna prueba, por más de 24 horas, serán causas suficientes para su inmediata Subrogación de	Falla, descompostura o falta de cualquier insumo necesario para el proceso de alguna prueba, por más de 12 horas, serán causas suficientes para su inmediata Subrogación de la (s) muestra a un laboratorio privado de reconocido prestigio.





