




**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:42** horas del día **31** de **marzo** de **2022**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 numeral 1º, fracción I, artículo 28 numeral 4º, artículo 30 numeral 1, fracción I, artículo 32 numeral 1º y artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número **36066001-007-2022**, relativa: para **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**



El acto fue presidido por el **C.P. Ramiro Estrada Olivera, Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales**, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

- 1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes y servicios conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.

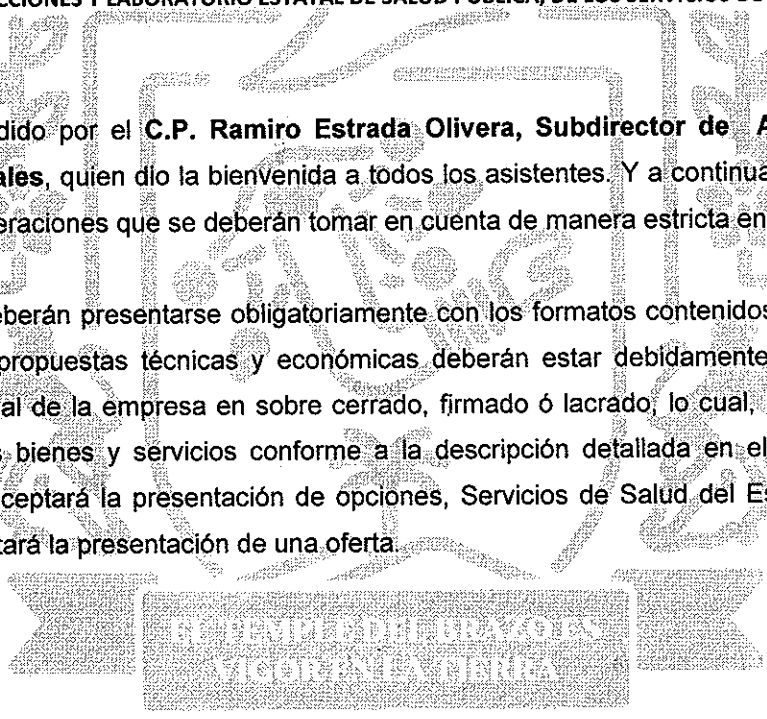


*[Handwritten signatures and initials]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

2. En referencia a la convocatoria para la licitación pública nacional con carácter presencial. No. 36066001-007-22 para la contratación del servicio integral para el suministro de insumos y comodato de equipos para los laboratorios de hospitales, jurisdicciones y laboratorio estatal de salud pública, de los Servicios de Salud del Estado de Colima, atentamente solicito las siguientes precisiones en mi carácter de área requirente a la Convocatoria del procedimiento señalado, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, y artículo 30 de su Reglamento, conforme a lo siguiente:



DICE	DEBE DECIR
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDA ÚNICA</b> MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD <b>HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO</b></p> <p>ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo automatizado para la realización de las pruebas de Química y Electrolitos</li> <li>• Capacidad mínima de 30 reactivos a bordo para las pruebas demandadas de rutina o de urgencias.</li> <li>• Que los reactivos estén al 100% listo para usarse</li> <li>• Capacidad de medición de electrolitos.</li> <li>• Capacidad de ensaye de mínimo de 270 pruebas por hora.</li> <li>• Tipo de muestra: suero, plasma, orina y LCR, hemolizado y sangre completa (HbA1c)</li> <li>• Capacidad de muestras: 30 muestras de paciente.</li> <li>• Acepte tubo primario, copa y/o copilla pediátrica.</li> <li>• Sistema que acepte muestras de urgencias (Stat).</li> <li>• Software en español</li> <li>• Cubetas permanentes o desechables o semidesechables</li> <li>• Auto diluciones de forma automática</li> </ul>	<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDA ÚNICA</b> MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD <b>HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO</b></p> <p>ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Equipo automatizado para la realización de las pruebas de Química y Electrolitos</li> <li>•Capacidad mínima de 32 reactivos a bordo para las pruebas demandadas de rutina o de urgencias.</li> <li>•Que los reactivos estén al 100% listo para usarse</li> <li>•Capacidad de medición de electrolitos.</li> <li>•Capacidad de ensaye de mínimo de 600 pruebas por hora</li> <li>•Tipo de muestra: suero, plasma, orina y LCR, hemolizado y/o sangre completa (HbA1c)</li> <li>•Capacidad de muestras: 30 muestras de paciente.</li> <li>•Acepte tubo primario, copa y/o copilla pediátrica.</li> <li>•Sistema que acepte muestras de urgencias (Stat).</li> <li>•Software en español</li> </ul>

2/10/22



JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de calidad interno.</li> <li>• Sistema de refrigeración o enfriamiento para los reactivos.</li> <li>• Manual del Operador en español.</li> <li>• Monitor e impressora integrada o adicional.</li> <li>• Cuento con No break integrado o adicional con capacidad de carga para 15 min, de respaldo</li> <li>• Con Interface para Sistema informático.</li> <li>• Que los reactivos sean de la misma marca que el instrumento o afines.</li> </ul> <p>Necesidad: 2 Equipos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubetas permanentes o desechables o semidesechables</li> <li>• Auto diluciones de forma automática</li> <li>• Volumen de muestra de 25 <math>\mu</math>L</li> <li>• Cuento con sistema de incubación o temperatura de reacción 37<math>^{\circ}</math>C</li> <li>• Control de calidad interno.</li> <li>• Sistema de refrigeración o enfriamiento para los reactivos.</li> <li>• Manual del Operador en español.</li> <li>• Monitor e impressora integrada o adicional.</li> <li>• Cuento con No break integrado o adicional con capacidad de carga para 15 min, de respaldo</li> <li>• Con Interface para Sistema informático.</li> <li>• Que los reactivos sean de la misma marca que el instrumento o afines.</li> </ul> <p>Necesidad: 1</p> <p>Y</p> <p><b>ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo automatizado para la realización de las pruebas de Química y Electrolitos</li> <li>• Capacidad mínima de 32 reactivos a bordo para las pruebas demandadas de rutina o de urgencias.</li> <li>• Que los reactivos estén al 100% listo para usarse</li> <li>• Capacidad de medición de electrolitos.</li> <li>• Capacidad de ensaye de mínimo de 400 pruebas por hora.</li> <li>• Tipo de muestra: suero, plasma, orina y LCR, hemolizado y/o sangre completa (HbA1c)</li> <li>• Capacidad de muestras: 30 muestras de paciente.</li> <li>• Acepte tubo primario, copa y/o copilla pediátrica.</li> <li>• Sistema que acepte muestras de urgencias (Stat).</li> <li>• Software en español</li> </ul>
---	---



*[Handwritten signatures and initials]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cubetas permanentes o desechables o semidesechables</li> <li>•Auto diluciones de forma automática</li> <li>•Volumen de muestra de 25 <math>\square</math>L</li> <li>•Cuenta con sistema de incubación o temperatura de reacción 37<math>\square</math>C</li> <li>•Control de calidad interno.</li> <li>•Sistema de refrigeración o enfriamiento para los reactivos.</li> <li>•Manual del Operador en español.</li> <li>• Monitor e impresora integrada o adicional.</li> <li>• Cuenta con No break integrado o adicional con capacidad de carga para 15 min, de respaldo</li> <li>• Con Interface para Sistema informático.</li> <li>• Que los reactivos sean de la misma marca que el instrumento o afines.</li> </ul> <p>Necesidad: 1</p>
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDA ÚNICA</b> MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD</p> <p><b>ANALIZADOR DE HbA1C (SERVICIO A LA RED ESTATAL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta prueba podrá ser procesada en el equipo de Química Clínica asignado al Hospital Regional Universitario cumpliendo con los más altos estándares de calidad.</li> </ul> <p>PARAMETROS: 1. HbA1C.</p> <p>Necesidad: 1</p>	<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDA ÚNICA</b> MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD</p> <p><b>ANALIZADOR DE HbA1C (SERVICIO A LA RED ESTATAL)</b></p> <p>Se requiere la instalación de un ANALIZADOR DE HbA1C con las siguientes características (SERVICIO A LA RED ESTATAL)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principio de funcionamiento: HPLC</li> <li>2. Determinación de HbA1c (HbA1c estable) y HbF (HbS y HbC puede ser detectada)</li> <li>3. Velocidad de procesamiento: 160 segundos por muestra</li> <li>4. Tipo de muestra: sangre total y muestra hemolisada</li> </ol>



*[Handwritten signatures and initials]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

	<p>5. Volumen de muestra: Máximo 4 µl 6. Que acepte tubo primario 7. Con sistema de perforación de tubo primario. 8. Carga máxima de 10 muestras. 9. Pantalla e impresora integrados 10. Puerto de comunicación para interfases 11. Corriente eléctrica de 240V ±10% 50/60Hz</p> <p>PARAMETROS: 1.HbA1C.</p> <p>Necesidad: 1</p>
--	--



3. - La Convocante hace mención que se presentaron por escrito preguntas por parte de los licitantes, siendo a saber las siguientes:

**PREGUNTAS DE LICON SA**

**B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR NUMERAL 1.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, FECHA DE ENTREGA: EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, DEL 21 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO DE LAS PRESENTES BASES.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PERIODO DEL CUAL COMPRENDE LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO, ES EL DESCrito EN EL PUNTO 1.9 LA VIGENCIA DE LA</p>	<p>Es correcta su apreciación</p>

*Handwritten signatures and initials:*  
Jard  
X  
AGG  
[Signature]



**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>OFERTA, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE EL 14 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. <b>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</b></p>	
<p>2.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PUNTO 13 EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, FIRMADA POR EL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL, <b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD</b>, DONDE SEÑALE QUE SE COMPROMETE A CONTAR CON <b>CALL CENTER CON UNA LADA 800 SIN CARGO</b> PARA RECEPCIÓN DE LLAMADAS Y GARANTIZAR QUE CUENTA CON SOPORTE EN LÍNEA, O TELEFÓNICO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y REPORTE DE FALLA, QUE FUNCIONARÁ LAS 24 (VEINTICUATRO) HRS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, DONDE SE REPORTAN A NIVEL NACIONAL Y/O LOCAL, INCLUYENDO LOS DATOS DEL SOPORTE EN LÍNEA (TELÉFONO, PÁGINA WEB, ETC. ASÍ MISMO DEBERÁ CONTAR CON UNA APP PARA SOLICITAR SERVICIOS CORRECTIVOS A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES (SMARTPHONE O TABLETAS ELECTRÓNICAS) PARA LO CUAL DEBERÁ DE PRESENTAR FOLLETO EN DONDE APAREZCA LOS DATOS ANTERIORES.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 31 INCISO XII REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS PUBLICADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE COLIMA Y TENER UN MAYOR NÚMERO DE OFERENTES, SE SOLICITA QUE SEA OPCIONAL LA APP SOLICITADA Y NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN, FÁCIL, RÁPIDO Y DE ATENCIÓN PERSONALIZADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES, DONDE PUEDE PREGUNTAR, REPORTAR, DAR SEGUIMIENTO E INCLUSO SOLICITAR INFORMACIÓN DE OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS EVITANDO QUE SE CANALICE LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN A PERSONAS QUE NO CORRESPONDEN Y SEA TARDADO Y MOLESTO EL SERVICIO CON UNA MAQUINA, GARANTIZANDO EL SERVICIO POR EXPERIENCIA. <b>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</b></p>	<p>Podrá ofertar un sistema de atención clientes personalizada, así como una APP para solicitar servicios correctivos a través de dispositivos móviles (smartphone o tabletas electrónicas) ó una solución alternativa a la APP que funcione en smartphone o tabletas electrónicas, para lo cual deberá de presentar folleto en donde aparezca los datos anteriores</p>
<p>3.-ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO E) NÚMERO DE PRUEBAS POR ÁREA Y PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ESTATAL</p>	<p>Deberá remitirse al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO E) NÚMERO DE PRUEBAS POR ÁREA Y PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ESTATAL y el desglose de las pruebas se le proporcionara al licitante</p>



*Handwritten signatures and initials:*  
G...  
K...  
F...  
K...



**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>SE SOLICITA SEAN DESGLOSADAS LAS PRUEBAS A REALIZARSE POR HOSPITAL PARA LAS ÁREAS DE COAGULACIÓN E INMUNOHEMATOLOGÍA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADECUADAMENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA. <b>FAVOR DE ACLARAR</b></p>	<p>adjudicado</p>
<p>4.-ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD, EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGIA.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 31 NUMERAL XII REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS PUBLICADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE COLIMA ; NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL PARA LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO ABO/RH COMPLETO (HEMÁTICO Y SÉRICO), FENOTIPO RH+KELL, ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS, IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS, PRUEBAS ENZIMÁTICAS, PRUEBA DE COOMBS DIRECTO, DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS ESPECIALES, PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTÍGENO D DÉBIL, CONFIRMACIÓN DE ABO/RH (D) Y PRUEBA CRUZADA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UTILIZACIÓN DE CUALQUIER TAMAÑO DE TUBO PRIMARIO DE PLÁSTICO O VIDRIO YA QUE MANEJA DIMENSIONES: <math>9 \leq \phi \leq 16</math> MM Y LONGITUD <math>\leq 100</math> MM.</li> <li>2. IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE MUESTRAS, REACTIVOS, DILUYENTES Y TARJETAS DE GEL.</li> <li>3. DILUCIÓN, DISPENSACIÓN, INCUBACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, LECTURA Y SEMICUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE REACCIÓN DE LOS MICROTUBOS DE LAS TARJETAS DE GEL.</li> <li>4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, CON DIGITALIZACIÓN Y PROCESADO DE IMÁGENES PARA OBTENER EL NIVEL DE REACCIÓN.</li> <li>5. VELOCIDAD: 50 TARJETAS/HORA (400 RESULTADOS/HORA)</li> </ol>	<p>Se acepta siempre y cuando cumpla con las pruebas.</p>








**JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>6. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE GRUPO ABO/RH COMPLETO: 35 MUESTRAS/HORA.</p> <p>7. CAPACIDAD DE 72 MUESTRAS, 43 REACTIVOS Y 200 TARJETAS DE GEL.</p> <p>8. CARGA CONTINUA DE MUESTRAS.</p> <p>9. ANÁLISIS URGENTE- STAT.</p> <p>10. DETECCIÓN DE NIVEL</p> <p>11. CONTROL DE CALIDAD</p> <p>12. INTERFASE BIDIRECCIONAL</p> <p>13. ALIMENTACIÓN: 100-200 V;50-60 HZ</p> <p>14. LA TARJETA DE GRUPO SANGUÍNEO DEBERÁ DETERMINAR ANTI A, ANTI B, D, DVI++Y, GRUPO INVERSO A1,B.</p> <p><b>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</b></p>	
<p>5.-ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD; <b>EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGIA EQUIPO</b> AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS, ANTICUERPOS ANTI ERITROCITOS, ANTI GLOBULINA HUMANA DIRECTA POR IGG, IGM E IGA, BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ANTICUERPOS IRREGULARES, TITULACIÓN DE ANTICUERPOS IGG IGM, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD Y FENOTIPO RH Y FENOTIPO EXTENDIDO EN TÉCNICA DE AGLUTINACIÓN, UTILIZANDO COMO SOPORTE O FASE SÓLIDA, TARJETAS DE GEL.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 31 NUMERAL XII REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS PUBLICADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE COLIMA, NOS PERMITA OFERTAR UNA TARJETA DE COLUMNA DE GEL QUE INCLUYA ANTI-GLOBULINA HUMANA, ANTI- IGG (MONOESPECÍFICA) PARA LA DETECCIÓN DE IGG Y ANTI-C3B, - C3D (MONOESPECÍFICA) PARA LA DETECCIÓN DE C3 (COMO C3B O C3D), LAS CUALES SON IMPORTANTES PARA LA</p>	<p>Se acepta sin ser obligatorio para los demás oferentes</p>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**



<p>DETECCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS Y/O COMPLEMENTO UNIDO A LOS GLÓBULOS ROJOS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA DETECCIÓN PARA LOS ANTICUERPOS DE LOS ISOTIPOS IGA E IGM NO SON MUY SOLICITADOS, POR SU BAJA FRECUENCIA, O PORQUE PARA REVELAR LA PRESENCIA DE ESTAS INMUNOGLOBULINAS EN LOS HEMATÍES SE REQUIERE EL EMPLEO DE MÉTODOS MÁS SENSIBLES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
<p>6.-EN CASO DE OBTENER UNA NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 31 NUMERAL XII REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS PUBLICADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE COLIMA; DE FORMA OPCIONAL NOS PERMITA OFERTAR UNA TARJETA DE COLUMNA DE GEL QUE INCLUYA ANTIGLOBULINA HUMANA POLIVALENTE, MEZCLA DE ANTICUERPOS ANTI - IGG POLICLONAL Y ANTI - C3D MONOCLONAL, ANTICUERPOS IGM DE ORIGEN MURINO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS CRUZADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>Su pregunta fue contestada aceptada, sin ser obligatorio para los demás</p>
<p>7.-ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD, EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGIA EQUIPO MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS, ANTICUERPOS ANTI ERITROCITOS, ANTI GLOBULINA HUMANA DIRECTA, BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ANTICUERPOS IRREGULARES, TITULACIÓN DE ANTICUERPOS Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TÉCNICA DE AGLUTINACIÓN, UTILIZANDO COMO SOPORTE O FASE SÓLIDA, TARJETAS DE GEL DE 6 COLUMNAS.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 31 NUMERAL XII REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS PUBLICADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE COLIMA Y TENER</p>	<p>Se acepta sin ser obligatorio para los demás oferentes</p>



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES, CONSIDERE LA REALIZACIÓN DE ESTAS PRUEBAS EN TARJETAS DE GEL DE 6 U 8 COLUMNAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
<p>8.-ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD, EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGIA EQUIPO MANUAL</p> <p>CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 31 NUMERAL XII REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS PUBLICADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE COLIMA Y TENER UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>EQUIPO MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS, ANTICUERPOS ANTI ERITROCITOS, ANTI GLOBULINA HUMANA DIRECTA Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TÉCNICA DE AGLUTINACIÓN, UTILIZANDO COMO SOPORTE O FASE SÓLIDA, TARJETAS DE GEL.</p> <p>CENTRIFUGA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CENTRIFUGACIÓN AUTOMÁTICA SIMULTÁNEA DE 24 TARJETAS DE GEL.</li> <li>2. VELOCIDAD DE CENTRIFUGACIÓN: 990 RPM+/- 10RMP</li> <li>3. TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN 9 MINUTOS</li> <li>4. ALARMA ACÚSTICA PROGRAMABLE QUE INDICA TERMINO DE CENTRIFUGACIÓN</li> <li>5. CONTROL DE EQUILIBRIO</li> <li>6. DETECCIÓN DE APERTURA DE PUERTA</li> <li>7. CIERRE DE SEGURIDAD</li> <li>8. CORRIENTE ELÉCTRICA: 100-240V/50-60 HZ</li> </ol> <p>INCUBADOR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CAPACIDAD DE CARGA DE 24 TARJETAS DG GEL Y 24 TUBOS DE MUESTRA.</li> <li>2. CUENTA CON DOS ZONAS DE INCUBACIÓN INDEPENDIENTES.</li> <li>3. DISPLAY DIGITAL CON DOS TEMPORIZADORES</li> </ol>	<p>Se acepta sin ser obligatorio para los demás oferentes</p>



*Handwritten signatures and initials*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>INDEPENDIENTES.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. TIEMPO DE INCUBACIÓN: 15 MINUTOS</li> <li>5. SENSORES INDEPENDIENTES DE MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURA</li> <li>6. ALARMA AUDIBLE CUANDO TERMINA LA INCUBACIÓN</li> <li>7. CORRIENTE ELÉCTRICA: 100-240V/50-60.HZ</li> </ol> <p><b>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</b></p>	
<p>9.-ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD. PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN SOLICITAN EQUIPO DE COAGULACIÓN TIPO I Y PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MÁNIZANILLO EQUIPO DE COAGULACIÓN TIPO II, CONSIDERANDO QUE SU PRODUCTIVIDAD ES SIMILAR Y EN LA ACTUALIDAD LOS HOSPITALES TRABAJAN CON EQUIPO TIPO II. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL SERVICIO NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN TIPO II PARA AMBOS HOSPITALES. <b>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</b></p>	<p>Se acepta sin ser limitativo a los demás participantes.</p>
<p>10.-ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD, EQUIPO DE COAGULACIÓN TIPO II. PARA EL HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACÁN E INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA SOLICITAN EQUIPO DE COAGULACIÓN TIPO II, CON EL OBJETIVO DE NO ENCARECER EL SERVICIO, CONSIDERANDO QUE EN LA ACTUALIDAD LOS HOSPITALES TRABAJAN CON EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO YA QUE SU PRODUCTIVIDAD ES BAJA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 31 NUMERAL XII REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS PUBLICADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE COLIMA Y TENER UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES</p>	<p>No se acepta su propuesta, las especificaciones señaladas en las presentes bases son las mínimas requeridas, para no afectar el proceso de las muestras.</p>





**JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

**CARACTERÍSTICAS:**

EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, TIEMPO DE TROMBINA, FIBRINÓGENO, FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES

1. PRUEBAS POR HORA: TP: 120
2. MÉTODO DE DETECCIÓN DE COAGULO: SISTEMA DE DETECCIÓN BASADO EN LA VISCOSIDAD (MECÁNICO).
3. UN SISTEMA DE DETECCIÓN ÚNICO BASADO EN SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS PERMITE UNA DETECCIÓN DE LOS COÁGULOS INCLUSO SI ÉSTOS SON DÉBILES.
4. 4 CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES.
5. SISTEMA DE INCUBACIÓN PARA MUESTRAS Y REACTIVOS CON TERMOSTATO A 37 °C.
6. PIPETA ELECTRÓNICA EXTERNA PARA REACTIVOS QUE PERMITE LA ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MEDICIONES.
7. VOLUMEN DE MUESTRA: 50 ML
8. VOLUMEN DE REACTIVOS: 50 A 100 ML
9. MEDIANTE UNA MEMORIA USB PERMITE GUARDAR LAS CALIBRACIONES, CONTROLES DE CALIDAD Y LOS ARCHIVOS DE PACIENTES (RESULTADOS, IDENTIDADES, ETC.)
10. REPORTE DE RESULTADOS EN: SEGUNDOS, %, INR, RATIO, GRAMOS Y MG/DL.
11. PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7".
12. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL.
13. IMPRESORA EXTERNA.
14. GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS
15. AMPLIO MENÚ DE CALIBRACIÓN CON ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN.
16. TENSIÓN: ENTRE 100 Y 240 V.
17. FRECUENCIA: 50/60 HZ.

**¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**



*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

PREGUNTAS DE DICIPA SA DE CV

**A) PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>1.12 IDIOMA</b> Solicitamos a la convocante nos permita presentar traducción simple al español de los documentos que se encuentren en idioma diferente al español. ¿se acepta?</p>	<p>Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes</p>
<p><b>1.15 CONDICIONES DE PAGO</b> Solicitamos a la convocante considere la fecha de pago al licitante adjudicado sea máximo a 90 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva. ¿se acepta?</p>	<p>No se acepta, Apegarse a bases.</p>
<p><b>3.21 ISO 9001:2015 Y 13485:2016 DEL LICITANTE Y ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA NUMERAL 2.</b> Solicitamos a la convocante nos permita presentar dentro de nuestra propuesta original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 a nombre del licitante, vigentes, cuyo alcance sea "Prestación de Servicios Médicos Integrales para Laboratorio Clínico; incluyendo: distribución y entrega de reactivos, consumibles e insumos para la salud; distribución e instalación de equipos para la salud (entre otros)" vigente y expedido por un organismo certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., ¿se acepta?</p>	<p>Se acepta</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p><b>4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA</b> <b>Inciso d)</b> Solicitamos a la convocante nos indique si es correcto entender que la propuesta técnica y económica podrá ser rubricada en todas y cada una de sus hojas y firma autógrafa en el lugar donde se indique el nombre del representante legal con la leyenda "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". ¿es correcto?</p>	<p>Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes</p>
<p><b>4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA</b> <b>Inciso k) Y ANEXO TÉCNICO 1 TÉCNICO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA NUMERAL 6.</b> Solicitamos a la convocante nos indique si es correcto entender que para cumplir con el punto de referencia se podrán presentar ISO 9001 y/o ISO 13485 y cualquiera de los siguientes certificados: FDA, CE, CLV, TUV o de acuerdo al país de origen de los equipos ofertados. (Aplica únicamente para ( F ) EQUIPOS ANALITICOS). ¿es correcto?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
<p><b>4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS</b> Solicitamos a la convocante nos permita presentar proposiciones conjuntas en la presente Licitación Pública Nacional. ¿se acepta?</p>	<p>No se acepta, Apegarse a bases.</p>
<p><b>( L ) PUNTOS DE PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 3.- SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO.</b> Solicitamos a la convocante nos permita presentar únicamente copia simple de documento oficial que demuestre la propiedad a nombre del licitante de las unidades de transporte. ¿se acepta?</p>	<p>Se acepta</p>
<p><b>4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA</b> <b>Inciso l) Y ANEXO TÉCNICO 1 TÉCNICO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA NUMERAL 7.</b></p>	<p>Se Acepta</p>

← 14

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

15

<p>Debido a que dentro del ANEXO Número 1 Técnico no se hace alusión a ninguna clave para los Equipos Analíticos y Sistema Informático. Solicitamos a la convocante no sea causa de desechamiento el no indicar dentro de la carta de apoyo dicha Clave. ¿se acepta?</p>	
<p><b>3.19 TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES (ANEXO 15).</b> Solicitamos a la convocante nos confirme que figura funge como sujeto obligado. Favor de confirmar.</p>	<p>Deberá remitirse al apartado numero 5 firma del contrato de las presentes bases</p>
<p><b>3.7 (ANEXO 7), 3.12 (ANEXO 8), 3.15 (ANEXO 11), 3.18 (ANEXO 14).</b> Solicitamos a la convocante nos permita adecuar los anexos conforme a lo solicitado en los numerales de las bases. ¿se acepta?</p>	<p>Se acepta</p>
<p><b>( L ) PUNTOS DE PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 3.- SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO.</b> Para dar cumplimiento al punto de referencia solicitamos a la convocante nos permita presentar original o copia certificada para cotejo de facturas de las unidades y copia simple de la tarjeta de circulación de las unidades de transporte con sistema de refrigeración a temperatura controlada a nombre del licitante, así mismo fotografías en donde se visualice la placa y el sistema de refrigeración. ¿se acepta?</p>	<p>Se acepta</p>

**B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Inciso I)</b> Debido a la situación de contingencia que se vive a nivel mundial con respecto a la pandemia COVID 19, que ha obligado a las empresas a tener una operación atípica y que</p>	<p>Se acepta, sin ser limitativa para los demás participantes.</p>





JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>no todos los fabricantes o filiales en México o titulares del registro sanitario, están en posibilidad de entregar documentos o escritos originales; solicitamos a la Convocante se permita entregar las cartas de apoyo impresas a color del formato electrónico. ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	
<p><b>Anexo número 1 Técnico Equipo de Inmunología: punto 4 dice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuento con capacidad de reactivos a bordo mínimo: 16</li> </ul> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, que, para dar cumplimiento con este punto, se nos permita ofertar una tecnología Con capacidad para hasta 24 paquetes de reactivos. Favor de pronunciarse.</p>	<p>Se acepta su propuesta, sin ser limitativa para los demás participantes.</p>
<p><b>Anexo número 1 Técnico Equipo de Inmunología: punto 2 dice:</b> Capacidad de procesar 80 pruebas por hora mínimo.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, que, se nos permita ofertar una tecnología la cual procese 60 pruebas por hora. Favor de pronunciarse.</p>	<p>No se acepta, favor de apegarse a bases.</p>
<p><b>Anexo número 1 Técnico Equipo de Inmunología: Parámetros puto 11 Procalcitonina.</b></p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, que, con la finalidad de eficientizar el servicio, se nos permita procesar esta prueba en el equipo de Química Clínica,</p>	<p>Se acepta su propuesta, sin ser limitativa para los demás participantes.</p>
<p><b>Anexo número 1 Técnico Equipo de Inmunología: punto 3 dice:</b> Sistema automatizado, con 20 parámetros como mínimo.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante,</p>	<p>No se acepta su propuesta, favor de apegarse a los requerimientos de la convocante.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

que, se nos permita ofertar un equipo semiautomatizado. Favor de pronunciarse.	
<b>Anexo número I Técnico Equipo de Inmunología: Parámetros punto 11 Procalcitonina.</b>  Solicitamos amablemente a la convocante, que, para procesar procalcitonina, se nos permita ofertar la prueba manual, garantizando la entrega rápida y oportuna de la prueba. Favor de pronunciarse.	Se acepta su propuesta, sin ser limitativo, para los demás participantes.
<b>Anexo número I Técnico Equipo de Inmunología: Parámetros</b>  Solicitamos amablemente a la convocante, que se comparta el desglose mensual y anual por prueba, par Inmunología. Favor de aclarar.	Deberá remitirse al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, POR PARTIDA ÚNICA MODELO DE PROPUESTA TÉCNICO, ANEXOS TÉCNICOS INCISO E) NÚMERO DE PRUEBAS POR ÁREA Y PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ESTATAL y el desglose de las pruebas se le proporcionara al licitante adjudicado
<b>Anexo número I Técnico Equipo de Inmunología: punto 10 dice: Calibración automática y o manual.</b>  Solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento a este punto se nos permita ofertar una tecnología basada en calibración mediante un cartucho. Favor de pronunciarse.	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a bases.
<b>ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I</b> USTEDES SOLICITAN VOLUMEN DE MUESTRA DE 25 ml. PEDIMOS SE AMPLÍE EL RANGO DE 1 A 30 ml ¿SE ACEPTA?	No se acepta, el volumen solicitado de 25 µl es el mínimo necesario para garantizar el cuidado de los pacientes pediátricos y neonatos, cumpliendo con el manejo racional de la sangre.
<b>ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I</b> SOLICITAMOS SE INCLUYA DENTRO DEL PANEL DE ELECTROLITOS LA PRUEBA DE LITIO	No se acepta, dicha prueba no es solicitada por el área medica
<b>ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I</b> SOLICITAMOS ACEPTEN QUE EL ANALIZADOR ACEPTE UN VOLUMEN DE AGUA MAXIMO DE	No se acepta, dicha especificación no es solicitada en las bases





JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>20 LITROS POR HORA</p> <p><b>Urianálisis Tipo I y Tipo II.</b> De acuerdo con lo descrito en las fichas técnicas para Urianálisis Tipo I y Urianálisis Tipo II, en cada uno de los hospitales. Entendemos que dichas fichas se encuentran invertidas, entendiendo que la necesidad real es que para el Tipo I se requiera un equipo automatizado y para el tipo II un equipo semi automatizado, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Es correcta su apreciación, se deberá referenciar la ficha del Tipo II como Tipo I y la ficha del Tipo I como Tipo II.</p>
<p><b>Bacteriología Tipo I y Tipo II.</b> Solicitamos respetuosamente a la convocante que la susceptibilidad de levaduras sea opcional.</p>	<p>Se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes.</p>
<p><b>Bacteriología Tipo I.</b> Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar incubación y adición de reactivos automatizado.</p>	<p>Se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes.</p>
<p><b>Bacteriología Tipo II.</b> Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar incubación y adición de reactivos manual.</p>	<p>Se acepta, sin ser limitativo para los demás participantes.</p>
<p><b>(L) Puntos de Propuesta Técnica</b> <b>1.- PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.</b></p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante permita hacer referencia de las características técnicas de los analizadores solo en las hojas de los manuales toda vez que son copia fiel y parte integral del manual y en caso de resultar adjudicados proporcionaremos los manuales completos.</p>	<p>Se acepta</p>

← 18

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA



PREGUNTAS DE DERIMEX SA DE CV

A) PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.


PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>3. REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES</b> Punto 3.21. ISO 9001:2015 y 13485 del Licitante de CUMPLIR y <b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDA ÚNICA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Punto 2</b></p> <p>Se solicita a la convocante que nos permita presentar copia simple del certificado y original para cotejo ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta presentar copia simple y original o copia certificada para cotejo</p>
<p><b>3. REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES</b> Punto 3.21. ISO 9001:2015 y 13485 del Licitante de CUMPLIR y <b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDA ÚNICA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Punto 2</b></p> <p>Se indica que los licitantes deberán presentar certificado del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 del licitante vigentes, cuyo alcance sea "venta, distribución, instalación de equipos de equipo médico, ofreciendo servicios integrales de laboratorio.", vigente y expedido por un organismo certificado por la</p>	<p>El alcance debe ser en servicios Integrales para Laboratorio Clínico.</p>



JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
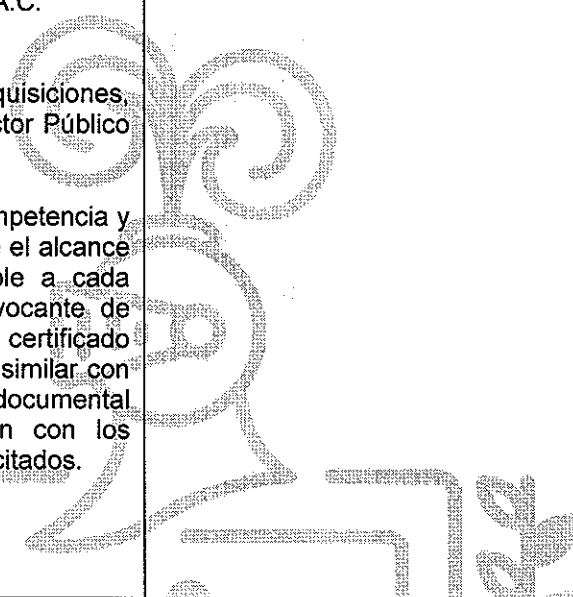
<p>Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.</p> <p>De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima:</p> <p>"...Para no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia...", debido a que el alcance del certificado es el texto aplicable a cada empresa, es tan amable la convocante de confirmar que se puede entregar un certificado con un alcance que tenga un texto similar con la consideración de que a nivel documental detallado y operativo se cumplan con los procesos/funciones/actividades solicitados.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
--	---



B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>3. REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES</b> Punto 3.21. <b>ISO 9001:2015 y 13485 del Licitante de CUMPLIR</b> y <b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDA ÚNICA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Punto 2</b></p> <p>Se indica que los licitantes deberán presentar certificado del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 del licitante vigentes, cuyo alcance sea <b>"venta, distribución, instalación de equipos de equipo médico, ofreciendo servicios integrales de laboratorio."</b>, vigente y expedido por un organismo certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.</p>	<p>Se deberá presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple del sistema de gestión de la calidad establecido (ISO- 9001:2015) y 13485: 2016, vigentes, a nombre del licitante con un alcance de servicios integrales para laboratorio clínico.</p> <p>o, podrá presentar sistema de gestión de calidad 13485:2016 vigente a nombre licitante con un alcance de servicios integrales para laboratorio clínico.</p>

*[Handwritten signatures and initials]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

La Ley Federal de Metrología, por su carácter voluntario, declaro la familia ISO como NMX o Norma Mexicana, a diferencia de las NOM que si son obligatorias:

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-CC-13485-IMNC-2017 en el DOF: 11/12/2017, es idéntica con la norma internacional ISO 13485:2016.

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 en el DOF 03/05/2016, coincide totalmente con la Norma Internacional ISO 9001:2015.

por lo que se solicita a la convocante permita presentar indistintamente solo uno de los dos certificados ya sea ISO 9001 o el certificado ISO 13485, sin que la falta de alguno de los certificados sea motivo de desechamiento de la propuesta.

¿Se acepta nuestra propuesta?

**ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO  
POR PARTIDA ÚNICA DOCUMENTACION  
COMPLEMENTARIA**

La convocante solicita que el licitante:

Punto 13.- "... Así mismo debe contar con una APP para solicitar servicios correctivos a través de dispositivos móviles (smartphone o tabletas electrónicas)".

no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, ¿nos permite la convocante ofrecer una solución alternativa a la APP y totalmente por web a este punto pudiendo usar PC, Laptop, dispositivos moviles?

lo cual ofrece varias ventajas, siendo las primordiales:


Se acepta, sin ser limitativo para los demás licitantes.





JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se tiene que instalar sw en el dispositivo móvil donde se quiera generar la solicitud o incidente</li> <li>- No genera problemas de rendimiento o espacio en los dispositivos</li> <li>- No compromete la integridad de la información personal de los usuarios</li> <li>- No encarece el costo del servicio</li> <li>- No se requiere actualización con los cambios de versión</li> </ul> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>Solicitamos a la convocante que para aquellas características que no se puedan referenciar en manuales, folletos, catálogos y fichas técnicas (por ejemplo: no break con capacidad mínima de 15 minutos de carga para respaldo., etc.), nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad donde se señala que los equipos cuentan con las características solicitadas en esta convocatoria.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitativo para los demás licitantes.</p>
<p><b>HEMATOLOGÍA I</b></p> <p>analizador para pruebas hematológicas con diferencial de 5 partes que realice mínimo 29 parámetros (que incluya reticulócitos) Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con la capacidad de contar con diferencial de 6 partes que realice lectura de líquidos o fluidos corporales</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta, siempre y cuando cumpla lo mínimo solicitado en las presentes bases, sin ser limitativo a los demás participantes.</p>
<p><b>HEMATOLOGÍA II</b></p> <p>Volumen de muestra: Aprox. 60 µl para el modo de sangre total, Aprox. 20 µl para el modo de dilución previa</p>	<p>Se acepta, siempre y cuando cumpla lo mínimo solicitado en las presentes bases, sin ser limitativo a los demás participantes.</p>



*[Handwritten signatures and marks]*





**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**



<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con la capacidad de un rango de volúmen de muestra de aprox. 50 µl para el modo de sangre total, aprox. 20 µl para el modo de dilución previa</p>	
<p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p> <p><b>ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO (K) PRODUCTIVIDAD EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD</b></p> <p><b>Hospital Regional Universitario, Hospital General Tecomán, H Manzanillo, H. Materno Infantil</b> Analizador de Gases. Solicitan acepte muestras de sangre total venosa, arterial, capilar y otras. Pregunta: Es correcto entender a equipo de gases automático portátil que acepte muestras de sangre total venosa, arteria y capilar principales líquidos de referencia en el diagnóstico del desequilibrio acido – base siendo opcional otros ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se acepta si el equipo utiliza como muestra: Sangre total, venosa ,arterial y capilar (otros)</p>
<p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p> <p><b>ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO (K) PRODUCTIVIDAD EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD</b></p> <p><b>HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, NÚMERO DE PRUEBAS POR ÁREA Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL HRU</b></p> <p>Área Bacteriología se solicita a la convocante nos especifique si el total indicado en productividad anual de 1,290, corresponde a 1,290 Identificaciones y 1,290 Sensibilidades.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>la cantidad de pruebas máximas para hospital regional universitario, número de pruebas por área y pacientes atendidos en el HRU son 1,920 para bacteriología, Se aclara que son 1,920 identificaciones con sensibilidad.</p>
<p><b>En ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES</b></p>	<p>Se aclara que son 2052 identificaciones con sensibilidad</p>

*Handwritten signatures and initials: "JWS" and "P26"*



**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p><b>TÉCNICAS POR UNIDAD, LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, NÚMERO DE PRUEBAS POR ÁREA Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL LESP</b> Área Bacteriología Se solicita a la convocante nos especifique si el total indicado en productividad anual de 2,052, corresponde a 2,052 Identificaciones y 2,052 Sensibilidades. Favor de aclarar En ( K ) PRODUCTIVIDAD, EQUIPOS REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR UNIDAD, LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, NÚMERO DE PRUEBAS POR ÁREA Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL LESP, EQUIPO AUTOMATIZADO DE DETECCIÓN MICROBIANA, pág. 98, INSUMOS NECESARIOS, nos especifique la cantidad de pruebas requeridas para este equipo.</p>	
<p><b>URIANÁLISIS TIPO I</b> Metodología: Fotometría de Reflexión dual con cuatro longitudes de onda como mínimo  Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la participación, nos permita ofertar un equipo con la tecnología de fotómetro de reflectancia y tres longitud de onda: 470 nm, 555 nm, 620 nm, esto sin comprometer la calidad de los resultados.  ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>No se acepta, favor de apegarse a las bases, ya que esto es lo mínimo requerido por el área usuaria.</p>
<p><b>URIANÁLISIS TIPO I</b> Capacidad de 400-500 tiras por hora.  Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar un equipo con rendimiento de aprox. 600 tiras por hora.  ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.</p>
<p><b>URIANÁLISIS TIPO I</b></p>	<p>Se acepta sin ser limitativo para los demás</p>



*[Handwritten signatures and initials]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

← 25

<p>Capacidad de 400-500 tiras por hora.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar un equipo con Puertos de succión para absorción de exceso de orina en tira reactiva.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>participantes.</p>
<p><b>URIANÁLISIS TIPO I</b></p> <p>Capacidad de 400-500 tiras por hora.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar un equipo con función de corrección de temperatura y detección de coloración anormal de muestra debido a medicamentos.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.</p>
<p><b>URIANÁLISIS TIPO II</b></p> <p>En la metodología se menciona: Fotometría de Reflexión dual con tres longitudes de onda como mínimo. Se solicita la modificación a fotometría de reflectancia.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta siempre y cuando cumpla con las tres longitudes de onda como mínimo que se solicitan, sin ser limitativo para los demás participantes.</p>
<p><b>URIANÁLISIS TIPO II</b></p> <p>En la capacidad se menciona: Capacidad de 60-300 pruebas por hora, se solicita la modificación a rendimiento de 50-100 pruebas por hora</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>No se acepta, favor de apegarse a las bases ya que esto es lo mínimo requerido por el área usuaria.</p>
<p><b>PROPUESTA TÉCNICA DEL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO 3. SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO</b></p>	<p>No es correcta su apreciación, lo solicitado en bases es lo mínimo requerido para garantizar la calidad de prestación del servicio objeto de la</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>Basados en la experiencia y en el mercado actual, se solicita a la convocante nos permita integrar como parte de la propuesta copia simple del (los) contrato(s) celebrados con empresas de arrendamiento dedicadas a este tipo de transporte.</p> <p>¿ Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>presente licitación.</p>
---	-----------------------------



**C) PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDA ÚNICA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA</b></p> <p>Punto 1- Se solicita que el licitante deberá presentar Copia simple y original o copia certificada para por Notario Público para cotejo, del oficio de alta de unidad y/o responsable de tecnovigilancia emitido por la COFEPRIS</p> <p>Debido al regreso paulatino a la normalidad, por la Pandemia, los trámites para actualización, alta o baja en la COFEPRIS y su afluencia son limitada, se propone a la convocante entregar una carta baja protesta de decir verdad que se encuentra en trámite este documento, con la consideración de que se cuenta con el programa de Control del producto ó servicio no conforme y el responsable de la Unidad de Tecnovigilancia en cumplimiento de la NOM-240- SSA1-2012.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Deberá presentar copia simple y original o copia certificada por notario público para cotejo, del oficio de alta de unidad y/o responsable de tecnovigilancia emitido por la COFEPRIS, conforme a bases.</p> <p>o copia simple y original o copia certificada para cotejo del oficio del trámite de alta de su unidad y responsable de tecnovigilancia debidamente sellado por la COFEPRIS</p>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA



4.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

5.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día 07 de abril del presente año, a las 12:00 horas; en tanto que el fallo se celebrará el 13 de abril a las 12:00 horas.

6.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las 13:53 (trece cincuenta y tres) horas del día de su inicio y esta acta es firmada para los efectos legales y de conformidad, por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

**FUNCIONARIOS**

Nombre	Firma
C.P. Ramiro Estrada Olivera Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales	
Licda. Esmeralda Rodríguez Valdez Jefa del Departamento de Adquisiciones	
Dra. Vianey Aguilar Zepeda Subdirección de Atención Médica Representante de los Servicios de Salud	



**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-007-2022**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**


**ÁSESORES TÉCNICOS**

Nombre	Firma
Q.F.B. Patricia Vizcaino Gonzalez Jefa de Laboratorio del Hospital General de Manzanillo	
QFB José Luis Estrada Ayala Jefe de Laboratorio del Hospital Regional Universitario	



**PARTICIPANTES**

Nombre	Firma
Irvin Eduardo Gutiérrez Villalvazo Dicipa S.A de C.V.	
Diana Berenice García Badillo Laboratorio Licon, S.A	

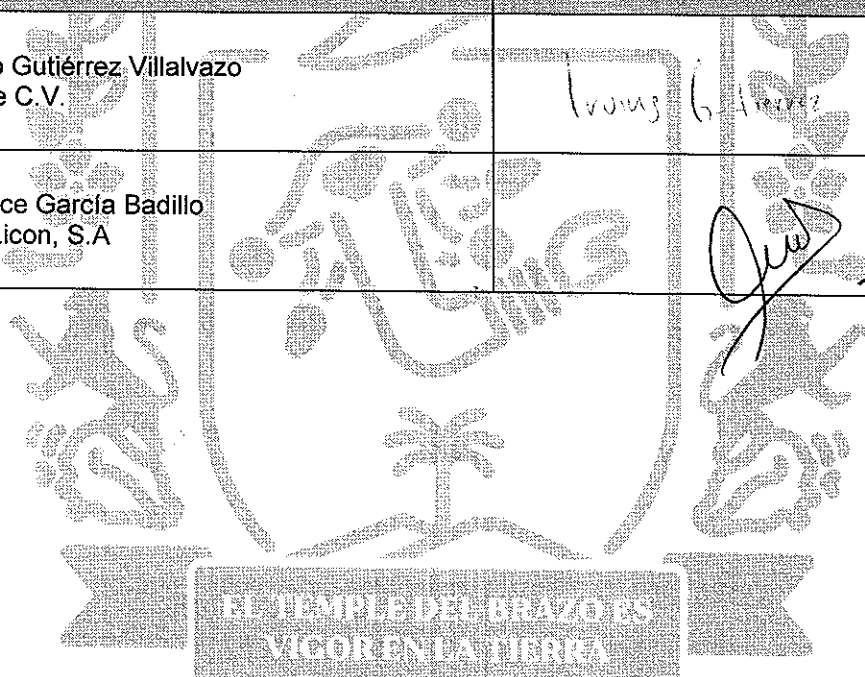

EL TEMPLE DEL BLAZO ES  
VIGOR EN LA TIERRA



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Colima se transforma  
**CONTIGO**


36066001-007-2022

12:00 horas

JUNTA DE ACLARACION DE BASES

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

ÁREA O CARGO QUE REPRESENTA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PA Dra Vianey Argueta Zapata	
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES		
JEFATURA DE ADQUISICIONES	Esmeralda Rodríguez Valdez	
COESPRIS		
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS		



Dirección Administrativa  
Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales  
Departamento de Adquisiciones

Carlos Salazar Preciado 249, Col. Burocratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Colima, México.  
Tels. 312 161 28 99 www.saludcolima.gob.mx





SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS		REGISTRO DE ASISTENCIA	
<p>PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA</p>			
ÁREA O CARGO QUE REPRESENTA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA:	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<i>Dr. Pablo Briceño</i>		
CANACO			
CANACINTRA			
COPARMEX			
ASESORES TÉCNICOS	<i>Q.F.S. Fabra Vizcaino C</i>	<i>Fabra</i>	
ASESORES TÉCNICOS	<i>Q.TB. Joe Luis Brada Apola</i>	<i>Brada</i>	
ASESORES TÉCNICOS			
ASESORES TÉCNICOS			



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Colima se transforma  
**CONTIGO**

36066001-007-2022

12:00 horas

JUNTA DE ACLARACION DE BASES

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

1	NOMBRE DE LA EMPRESA, DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL: Dicipa Sa de Ci DCP 79 05 11 0 36	NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL: Iruing Eduardo Cuernavilla E-MAIL: iruing.galvarez@dicipa.com.mx	FIRMA: Iruing Galvarez
2	NOMBRE DE LA EMPRESA, DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL: Laboratorios Licon, S.A	NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL: Diana Berenice Garcia E-MAIL: diana.garcia@licon.com.mx	FIRMA: Diana Garcia
3	NOMBRE DE LA EMPRESA, DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL: QFD. Pakua Directivo	NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL: HGM, E-MAIL: qfb_vicinas@hgm.com	FIRMA: Vicinas
4	NOMBRE DE LA EMPRESA, DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL: Gto Jbe Luis Ghade Ayala	NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL: HGM, E-MAIL: qfb_jose_ghade@hgm.com	FIRMA: Jose Ghade
5	NOMBRE DE LA EMPRESA, DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL:	NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL:	FIRMA:



Dirección Administrativa  
Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales  
Departamento de Adquisiciones

Calle Salazar, Preclado 219, Col. Burocratas Municipales,  
C.P. 28040, Colima, Colima, México.  
Tels. 312 161 28 99 www.saludcolima.gob.mx

