

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:30 (doce treinta)** horas del día **18 (dieciocho)** de **Abril de 2016 (dos mil dieciséis)**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los licitantes participantes, para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases de la Licitación Pública Nacional **36066001-009-16**, relativa al:

"Servicio Integral para el Suministro de Insumos y Comodato de Equipos para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de los Servicios de Salud del Estado"

La **C.P. Rosalba Nuñez Rosas**, Subdirectora de Recursos Materiales de los Servicios de Salud del Estado de Colima, dio la bienvenida a todos los asistentes.

A continuación expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobres separados y firmados o lacrados, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta por licitante.





2.- Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, en formato anexo, el cual forma parte integral de esta acta.

3.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos.

4.- De acuerdo al artículo 31, fracción VIII, la indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
JUNTA DE ACLARACIONES
Participantes

Nombre	Firma
Impromed S.A. de C.V. Enrique Smith Corvera	
Distribuidora Química y Hospitalaria GAP S.A. de C.V. René Alejandro Ontiveros Márquez	
Laboratorios Licon S.A. Diana Berenice García Badillo	
DICIPA, S.A de C.V. Lorena Cruz Saldaña	






COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
 "SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
 TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO # 1
PREGUNTAS DE CÁRACTER ADMINISTRATIVO
DE IMPROMED S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>1. EN LA PAGINA 6 DE LAS PRESENTES BASES MENCIONAN EL ANEXO 1 EL CUAL CONSIDERAMOS VIENE INCOMPLETO, YA QUE NO DETALLAN LAS CANTIDADES A ADQUIRIR; PARTIDAS, DESCRIPCION, PRESENTACIÓN, CANTIDADES, ETC.; DATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.</p>	<p>Deberá apegarse a lo establecido en el anexo 1.</p>
<p>2. 3.4.1 DOCUMENTO 10 SOLICITAN LA ACREDITACIÓN DE HABER CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO. ENTENDEMOS QUE LO QUE DEBEMOS PRESENTAR ES LA CONSTANCIA DEL PAGO DE LA AFILIACION DE LA CAMARA A LA CUAL PERTENECEMOS, JUNTO CON EL PAGO DEL SIEM Y EL ENGOMADO 2016. SOLICITAMOS CONFIRMAR.</p>	<p>Es correcto, deberán presentar la constancia del pago de afiliación de la cámara a la que pertenezcan.</p>
<p>3. PAGINA 14 TERCER PARRAFO. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGARÁ FOLIADA, ENGARGOLADO O EN FÓLDER CON LA LEYENDA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, DEBERÁ VERIFICARSE QUE SE INCLUYA TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL AL ENTREGAR PARA SU COTEJO. EN ESTE APARTADO SOLO HACEN MENCION DE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA FOLIADA, ENTENDEMOS QUE LA PROPUESTAS TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA TAMBIEN SE FOLIARAN Y SERA FOLIO INDEPENDIENTE. ¿FAVOR DE CONFIRMAR?</p>	<p>Es correcto, ambas propuestas deberán estar foliadas, en forma independiente.</p>
<p>4. ANEXO 11 MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA ENTENDEMOS QUE ESTE ANEXO SE PRESENTARA POR PARTIDA Y NO A RENGLON SEGUIDO COMO LO INDICAN EN LA PAGINA 15 PRIMER PARRAFO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>Es correcta su apreciación</p>
<p>5. ANEXO 11 MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE DONDE TOMAREMOS LA INFORMACION RESPECTO A PARTIDA, DESCRIPCION Y CANTIDAD OFERTADA QUE SOLICITAN EN EL FORMATO. FAVOR DE</p>	<p>Se deberá tomar del anexo 1</p>

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>ACLARAR.</p>	
<p>6. PAGINA 14 TERCER PARRAFO. LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGARÁ FOLIADA, ENGARGOLADO O EN FÓLDER CON LA LEYENDA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, DEBERÁ VERIFICARSE QUE SE INCLUYA TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL AL ENTREGAR PARA SU COTEJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE SE PRESENTE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA, TECNICA Y ECONOMICA EN CARPETA DE TRES ARGOLLAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> 
<p>7. ANEXO 1, NORMATIVIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL CONJUNTO DE NORMAS MENCIONADAS EN DICHO ANEXO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CETS Y SUS PUESTOS DE SANGRADO, YA QUE LA FUNCIÓN DEL PROVEEDOR ES PROPORCIONAR LOS EQUIPOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA QUE EL PERSONAL DE DICHA INSTITUCIÓN CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.</p>	<p>En efecto, el proveedor deberá proporcionar equipos, insumos y reactivos, que cumplan con la normatividad vigente aplicable al CETS y sus puestos de sangrado.</p>
<p>8. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE CON CUANTOS DIAS SE TENDRA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO, HARDWARE Y SISTEMA INFORMATICO DESPUES DEL DIA DEL FALLO, YA QUE EN LAS PRESENTES BASES NO SE ENCUENTRA ESTA INFORMACION.</p>	<p>Se deberán considerar 45 días naturales después del fallo económico.</p>
<p>9. PUNTO 4. ASPECTOS ECONOMICOS, MENCIONAN QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADA CON UN CONTRATO O PEDIDO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL SUBCONTRATANTE, QUE SE OBTIENE DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTES ACLARE ESTE PUNTO, YA QUE CONSIDERAMOS NO ES APLICABLE A ESTE PROCESO LICITATORIO, Y NO CLARO LA PETICION DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES FISCALES DEL SUBCONTRATANTE O A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO.</p>	<p>Aplicará en caso de que el proveedor que resulte adjudicado, subcontrate el servicio.</p>

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
 "SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
 TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES
PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO
 DE IMPROMED S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>1. EN EL ANEXO 1, APARTADO F "EQUIPO NECESARIO PARA LA PREDONACIÓN COMO EL ÁREA DE SANGRADO DEL BANCO DE SANGRE COMO EN SUS 2 PUESTOS DE SANGRADO", SOLICITAN 5 REFRIGERADORES PARA REACTIVOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 26 PIES, 3 PARA EL CETS, 1 PARA TECOMAN Y 1 PARA MANZANILLO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PROPONER REFRIGERADORES ACORDE A LOS VOLÚMENES DE CARGA DE CADA UNA DE LAS UNIDADES, YA QUE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTE TIPO DE REFRIGERADOR SOLICITADO ES EXCESIVAMENTE GRANDE PARA LO QUE ES REQUERIDO.</p>	<p>Se acepta, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera; siempre y cuando cumplan con lo establecido.</p>
<p>2. PUNTO 2 REQUISITO PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, INCISO J). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS REGISTROS SANITARIOS SON SOLO PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE CUENTAN CON CEDULA TÉCNICA, SUS REACTIVOS Y LA BOLSA PARA DONACIÓN DE SANGRE.</p>	<p>El registro sanitario vigente aplica para todos los equipos, reactivos e insumos suministrados a banco de sangre y los puestos de sangrado.</p>
<p>3. ANEXO 1, APARTADO E, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACIÓN DE AFÉRESIS, REQUIEREN PIPETAS DE 100 A 1000 MICROLITROS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE POR QUÉ TOMA COMO CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO LAS PIPETAS DE 100 A 1000 MICROLITROS.</p>	<p>No es una característica; se solicita como material adicional, de acuerdo a la NOM-253 vigente, las micropipetas son necesarias para la realización del control de calidad, una vez realizada la aféresis, se lleva a cabo una dilución para obtener el rendimiento del producto.</p>
<p>4. ANEXO 1, APARTADO D, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACIÓN DE LAS BIOMETRÍAS HEMÁTICAS. REQUIEREN COMO EQUIPAMIENTO ADICIONAL PIPETAS AUTOMATIZADAS, DOSIFICADOR, BAÑO MARÍA Y 3 CENTRIFUGAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS MENCIONE LA FUNCIÓN DE ESTE EQUIPAMIENTO YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO ES COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO.</p>	<p>El equipo solicitado corresponde al área donde se realizan grupos sanguíneos en tubo, biometrías hemáticas y la determinación del RH. Por ello se solicita el equipo y material adicional.</p>
<p>5. ANEXO 1, APARTADO F EQUIPO NECESARIO PARA LA PREDONACION COMO EL ÁREA DE SANGRADO DEL BANCO DE SANGRE COMO EN SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO. SELLADOR DIELECTRICO PARA EL SALLADO DE LA BOLSA DE SANGRE. EN LA CANTIDAD DE EQUIPOS POR ÁREA SOLICITAN 4 PARA EL CETS, 1 PARA TECOMAN Y 1 PARA MANZANILLO, PERO EN LA CANTIDAD REQUERIDA TOTAL MENCIONAN</p>	<p>Se aclara, son seis selladores dieléctricos, cuatro para el CETS, y dos para cada uno de los puestos de sangrados. (HGM y HGT).</p>




[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
JUNTA DE ACLARACIONES

<p>SOLO 5, FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>6. APARTADO G, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA. MENCIONAN COMO CARACTERÍSTICA QUE SOLO UTILICE REACTIVO DE CARGA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A QUE SOLO ÚTILICE REACTIVO DE LA MARCA.</p>	<p style="text-align: center;">Es correcto, de la misma marca.</p>
<p>7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES A LICITAR, YA QUE ESA INFORMACIÓN ES BÁSICA PARA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA.</p>	<p>Productividad aproximadamente por año:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unidades procesadas en el CETS y puesto de sangrado: 9,000 2. Los procedimientos por aféresis: 40 3. Biometría del donador rechazado: 2,000
<p>8. ANEXO 1 INCISO 19, MENCIONA CONTAR CON UN PROGRAMA DE CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁ TENER EL PROGRAMA.</p>	<p style="text-align: center;">No aplica para esta licitación.</p>
<p>9. ANEXO 1, INCISO 16. SOLICITAN ESTABLECER, DOCUMENTAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAR CONTINUAMENTE SU EFICACIA Y EFICIENCIA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ESTAS BASES, PARA QUE CON ELLO SE CERTIFIQUE ESTE ESTABLECIMIENTO (CETS). ENTENDEMOS QUE ESTE TIPO DE PROCESOS Y DE CERTIFICACIÓN DEL CETS CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN, NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO PROVEEDOR DEL SERVICIO ES PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS PARA QUE ESTE TIPO DE PROCESOS SE LOGRE. PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARARNOS ESTE PUNTO.</p>	<p style="text-align: center;">No es correcta su apreciación. El proveedor debe de cubrir la inscripción al programa de certificación, asimismo dar el soporte técnico necesario.</p> <p style="text-align: center;">Esto incluye que sus equipos cuenten con los certificados de calibración y mantenimientos requeridos en la certificación.</p>
<p>10. PUNTO 1.6 GARANTIA DE LOS BIENES, SOLICITAN UN PERIODO MINIMO DE CADUCIDAD DE 12 MESES EN LOS BIENES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, PERO EN EL ANEXO 1 APARATDO F INCISO 3, INDICAN QUE VIGENCIA DE LOS REACTIVOS, CALIBRADORES Y CONTROLES NO DEBERA SER MENOR A SEIS MESES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ENTREGAR CADUCIDADES INFERIORES A LOS SOLCITADO EN AMBOS DE LAS BASES, ESTA PETICION SE HACE REALIZA CONSIDERANDO QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE ALGUNOS DE LOS REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES ES INFERIOR A LO SOLICITADO Y ADEMAS QUE EL RE-SURTIMIENTO DE ESTOS SE REALIZARA</p>	<p>No se acepta, se aclara que la caducidad de los insumos y reactivos de hematología e inmunohematología deben ser de un mínimo de tres meses, para el área de serología debe ser de seis meses y para todos los demás materiales como lo son las bolsas de recolección de sangre entre otros, debe ser como mínimo de un año.</p>



Handwritten signature

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>MENSUALMENTE LO CUAL NO AFECTA EN SUS INVENTARIOS, YA QUE LA FORMA DE COBRO NO ES EL REACTIVO, SINO QUE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS.</p>	
<p>11. 1.1 DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES Y SU VIGENCIA, SOLICITAN QUE TODOS LOS BIENES COTIZADOS SENA NUEVOS SIN USO, PERO EN EL ANEXO 1 INCISO 2, PIDEN QUE LOS EQUIPOS DEBERAN ESTAN EN OPTIMA CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SER DE TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO.</p>	<p>Se aclara por la convocante que todos los bienes cotizados sean nuevos.</p>
<p>12. 1.6 GARANTÍA DE LOS BIENES, EL PERIODO MÍNIMO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES QUE SE REQUIERE ES DE DIECIOCHO MESES (18 MESES), A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, LA CUAL SE DEBERÁ AMPARAR POR ESCRITO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE SEIS MESES Y TRES MESES PARA HEMATOLOGÍA YA QUE POR SU NATURALEZA CUENTA CON UNA CADUCIDAD DE TRES MESES, PRESENTANDO CARTA AMPARANDO LA CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta, se aclara que la caducidad de los insumos y reactivos de hematología e inmunohematología deben ser de un mínimo de tres meses, para el área de serología debe ser de seis meses y para todos los demás materiales como lo son las bolsas de recolección de sangre entre otros, debe ser como mínimo de un año.</p>
<p>13. 2 REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN PUNTO D. SOLICITAN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES A SUMINISTRARSE CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO VIGENTES EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, SON MARCAS REGISTRADAS Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS ADITIVOS, FÁRMACOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN CONFORME AL REGLAMENTOS DE INSUMOS PARA SALUD Y SERÁN LOS INDICADOS EN LA NUEVA EDICIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA AVALUACIÓN O ENTREGA DE LOS BIENES, DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR AUTORIZADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SALUD Y PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO EN ESTA NO APAREZCA, LA INFORMACIÓN PODRÁ RECURRIRSE A LA FARMACOPEAS DE OTROS PAÍSES. PODRÍA LA CONVOCANTE CORROBORARNOS SI DEBEMOS ENTENDER QUE PRESENTAREMOS ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES SUMINISTRADOS CUENTA CON REGISTRO SANITARIO VIGENTES Y/O PRESENTAR COPIA DEL OFICIO DE REGISTRO SANITARIO, QUE FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO</p>	<p>El registro sanitario deberá estar vigente, en caso de no estarlo deberá presentar la prorroga vigente emitida por la COFEPRIS y mantenerlo vigente a la fecha del término del contrato.</p>

"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO DE EQUIPOS Y REACTIVOS Y NO MENCIONAR EL RESTO DEL TEXTO YA QUE SE REFIERE A FÁRMACOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	
<p>14. 2 REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN PUNTO G. COPIA DEL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES (ADVERSO Y REVERSO) EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS) DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA, 3.4.2 PROPUESTA TÉCNICA PUNTO DOCUMENTO 13 COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE ANVERSO Y REVERSO) DE LOS EQUIPO Y REACTIVOS, CONFORME EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS). IDENTIFICADO POR NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO O PRORROGA DEL REGISTRO VIGENTE O SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN EN CASO DE EXISTIR, Y EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 (CINCO) AÑOS, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y/O PODREMOS PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA O COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS A MÁS TARDAR EL 24 DE FEBRERO DE 2010 E IDENTIFICARLO CON EL NUMERO DE LICITACIÓN CADA REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO PROPUESTO Y BOLSA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p style="text-align: center;">No se acepta. El registro sanitario deberá estar vigente, en caso de no estarlo deberá presentar la prorroga vigente emitida por la COFEPRIS y mantenerlo vigente a la fecha del término del contrato.</p>
<p>15. 2 REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN PUNTO. H EN CASO DE DISTRIBUIDORES DEBERÁ ENTREGAR EL 100% DE CARTAS DE LOS FABRICANTES O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN EL QUE ESTE MANIFIESTE, POR LA TOTALIDAD DE LAS CLAVES DESCRITAS EN EL ANEXO 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS PRESENTAR CARTA POR FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO RESPALDANDO "SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE LOS SERVICIO DE SALUD" ¿SE ACEPTA?</p>	<p style="text-align: center;">Si se acepta.</p>

Jed

g *Ⓢ* *P* *7* *Ⓢ* *e*

Ⓢ

△

△

K *H*

Ⓢ *Ⓢ* *Ⓢ* *Ⓢ* *Ⓢ* *Ⓢ*





“SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”

JUNTA DE ACLARACIONES


<p>16. 3.4.2 PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTO 14. CARTA DE RESPALDO, DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE, POR LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO, DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA DE ACUERDO AL ANEXO 1, YA QUE NO EXISTE CLAVE EN EL ANEXO 1. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Si se acepta.</p>									
<p>17. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE REQUERIMIENTO DE PRUEBAS O PROCEDIMIENTOS PARA BANCO DE SANGRE.</p>	<p>De manera anual: CETS=16,000 predonantes y 8,000 donadores. HGM= 2.000 predonantes y 1,000 donadores HGT: a reserva de lo que se recolecte una vez abierto este puesto de sangrado.</p>									
<p>18. 3.4.2 PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTO 15 PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE REQUISITADO DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO 2 DE LAS BASES PUDIENDO OFERTAR DOS O MÁS PARTIDAS POR HOJA (RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2-A) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AL NO EXISTIR PARTIDA PODREMOS REALIZAR EL LLENADO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p style="text-align: center;">ANEXO 2 MODELO DE LA PROPUESTA TÉCNICA</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>PARTIDA: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</p> <p>Deberá proporcionar un equipo automatizado completo moderno de tecnología de vanguardia inmunoenzimática</p> <p style="text-align: right;">Cantidad a ofertar: Ejemplo Total MENSUAL POR PROCEDIMIENTO</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Fabricante: xxxxx Marca: xxxx Modelo: xxxxx</p> <p style="text-align: right;">CIACIÓN?</p> </div> <p>RESUMEN DE PROPUESTA TÉCNICA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Partida</th> <th style="width: 20%;">Cantidad Cotizada</th> <th style="width: 50%;">Descripción de los bienes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sistema automatizado para de pruebas de tamizaje BS</td> <td style="text-align: center;">xxxxx</td> <td>Sistema automatizado para pruebas de tamizaje BS</td> </tr> <tr> <td>Hematología</td> <td style="text-align: center;">xxxxx</td> <td>Hematología</td> </tr> </tbody> </table>	Partida	Cantidad Cotizada	Descripción de los bienes	Sistema automatizado para de pruebas de tamizaje BS	xxxxx	Sistema automatizado para pruebas de tamizaje BS	Hematología	xxxxx	Hematología	<p>No se acepta por ser un servicio integral, el cual excluye partidas.</p>
Partida	Cantidad Cotizada	Descripción de los bienes								
Sistema automatizado para de pruebas de tamizaje BS	xxxxx	Sistema automatizado para pruebas de tamizaje BS								
Hematología	xxxxx	Hematología								

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”

JUNTA DE ACLARACIONES

	Cotizada	los bienes	
Sistema automatizado para pruebas de tamizaje bs	Xxxxx	HIV	
	xxx	HCV	
	xxxx	AgshB	
2 Hematología	xxxxx	Hematología	
...¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?			
19. APARTADO A, B, C Y D. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CORROBORAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PODAMOS PRESENTAR CATALOGO, HOJAS DE MANUAL O INSTRUCTIVOS DE USOS. ¿SE ACEPTA?			Si, se acepta siendo obligatorio para todos los licitantes hacerlo de esta manera. 
20. APARTADO A. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS. SOLICITAN PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 10 A 100µL Y DE 100 A 1,000 µL, CENTRIFUGAS CLÍNICA CON ROTOR DE 14 TUBOS Y CENTRIFUGA PARA MICROTUBOS CON ROTOR DE 24. BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ENTREGAREMOS LAS PIPETAS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?			Si se acepta siendo obligatorio para todos los licitantes hacerlo de esta manera.
21. APARTADO C. CARACTERÍSTICAS DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS SEROLÓGICA A PROPORCIONAR LAS CUALES DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LO DESCRITO. SOLICITAN EQUIPO PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS. INCLUYEN PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 5 A 50µL Y DE 10 A 100 µ, LÁMPARA DE LUZ BLANCA Y ROTOR DE PLACAS (AGITADOR PARA MUESTRA EN PLACA). BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ENTREGAREMOS LAS PIPETAS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?			Si se acepta siendo obligatorio para todos los licitantes hacerlo de esta manera. 
22. APARTADO D. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZAR BIOMETRÍA HEMÁTICA. SOLICITAN INCLUIR AGITADOR DE TUBOS, BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ENTREGAREMOS LAS PIPETAS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?			Si se acepta siendo obligatorio para todos los licitantes hacerlo de esta manera. 
23. APARTADO D. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZAR BIOMETRÍA HEMÁTICA. SOLICITAN PIPETA S AUTOMÁTICAS 10 A 100µL Y DE 100 A 1,000 µL, DOSIFICADOR DE 1 A 10 ML, BAÑO MARÍA DE ACERO INOXIDABLE Y TRES CENTRIFUGAS CON 12 TUBOS... PODRÍA LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE EQUIPAMIENTO ADICIONAL YA QUE LE EQUIPO NO REQUIERE DE NINGÚN EQUIPO ADICIONAL PARA SU FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO A PROPONER REALIZARA SU FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO.			No es correcta, el equipo adicional corresponde al área de hematología donde se hace uso del material solicitado, para la determinación de grupo directo en tubo y rh. 



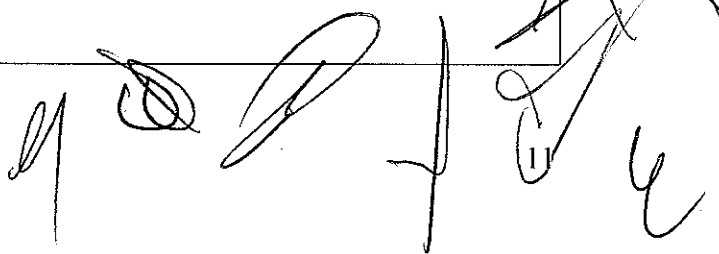

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p>24. APARTADO D. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZAR BIOMETRÍA HEMÁTICA. SOLICITAN CONSUMIBLES, SOPORTE CON SU AGUJA PARA LA EXTRACCIÓN DE SANGRE, TUBO EDTA, CON GEL SEPARADOR Y CON ACD, ENTRE OTROS. PODRÍA LA CONVOCANTE CORROBORAR SI DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTE APARTADO SOLO SE OFERTARA SOPORTE CON SU AGUJA Y TUBO LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA, Y ELIMINARA CON GEL SEPARADOR Y CON ACD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>La apreciación es incorrecta. No se van a eliminar. Los tubos descritos son necesarios ya que no corresponden al área de hematología, pero son utilizados en el área de sangrado, por ello se solicitan.</p>

PREGUNTAS DE CÁRACTER LEGAL

DE IMPROMED S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>1. PUNTO 1.8 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES (OPCIONAL), MENCIONAN QUE LA CONVOCANTE PODRA EFECTUAR VISITAS A SUS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, AEFECTO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA O MANUFACTURA DE LOS BIENES, ASI COMO LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NÓS ACLARE COMO SERA ESTE PROCESO DE VISITAS, YA QUE LA MAYORIA DE LOS BIENES A LICITAR SON IMPORTADOS Y NO SON MANUFACTURADOS EN EL PAIS Y SI ES PUNTO ES APLICABLE A ESTE PROCESO.</p>	<p>La convocante tendrá la facultad de visitar las instalaciones de los licitantes con el fin de verificar su capacidad técnica.</p>
<p>2. PUNTO 2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION INCISO D, SOLICITAN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES A SUMINISTRARSE CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, SON MARCAS REGISTRADAS Y LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS ADITIVOS, FÁRMACOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, CONFORME AL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD Y SERÁN LOS INDICADOS EN LA EDICIÓN VIGENTE, AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN O ENTREGA DE LOS BIENES, DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR AUTORIZADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SALUD Y PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO EN ESTA NO APAREZCA, LA INFORMACIÓN PODRÁ RECURRIRSE A LAS FARMACOPEAS DE OTROS PAÍSES., PEDIMOS A LA CONVOCANTE</p>	<p>Se aclara que los reactivos, equipos e insumos utilizados en banco de sangre deben contar con registro sanitario vigente, expedido por la COFEPRIS. Se acepta eliminar el párrafo que hace mención a medicamentos.</p>

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16

"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"

JUNTA DE ACLARACIONES


MODIFIQUE ESTE INCISO O LO ELIMINE, YA QUE LOS BIENES A LICITAR NO SON FARMACOS.	
--	--


"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>3. PUNTO 2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION INCISO G, SOLICITAN COPIA DEL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES (ANVERSO Y REVERSO), EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE A QUE PARTIDAS SE REFIERE Y CUALES SON LAS CLAVES DE LOS BIENES Y QUE SE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE LA PRORROGA EN AQUELLOS REGISTROS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE ANTE LA AUTORIDAD.</p>	<p>El registro sanitario deberá estar vigente, en caso de no estarlo deberá presentar la prórroga vigente emitida por la COFEPRIS y mantenerlo vigente a la fecha del término del contrato. Esto aplica para todos los equipos y reactivos propuestos en las bases de la licitación.</p>
<p>4. PUNTO 5.1 EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS, SOLICITAN QUE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA TODOS LOS RENGLONES DEBE DESCRIBIR EL SERVICIO O BIEN CORRESPONDIENTE CON APEGO EXACTO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES Y DEBERA QUEDAR CLARAMENTE INDICADA O PUNTUALIZADA LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO, A LA CUAL SE DEBERA ADJUNTAR IMAGEN, ILUSTRACIÓN O CATALOGO QUE COINCIDA CON LA DESCRIPCIÓN PROPUESTA A FIN DE OBSERVAR LA CORRESPONDENCIA Y FISONOMIA DEL BIEN DESCRITO; LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS MOTIVARÁ LA DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE A LOS EQUIPOS CADA UNA DE LAS CEDULAS TECNICAS.</p>	<p>Es correcto, se refiere a las cédulas técnicas de cada uno de los equipos.</p>
<p>5. PUNTO 3.4.2. PROPUESTA TECNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUYA SU LA PROPUESTA ECONOMICA COPIA DE CONTRATO (S), CON LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO INTEGRAL QUE SE ESTA LICITANDO, ESTO LES PERMITIRA CONSTATAR QUE LA EMPRESA CUENTA CON LA EXPERIENCIA SUFICIENTE Y CAPACIDAD PARA OFERTAR EL SERVICIO INTEGRAL PARA BANCO DE SANGRE.</p>	<p>No aplica. Apegarse a lo establecido en las bases.</p>
<p>6. PUNTO 8.1. DESCALIFICAR AL LICITANTE. INCISO 8.1.2.3 POR NO PRESENTAR MUESTRAS CUANDO SE REQUIERAN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE INCISO, YA QUE CONSIDERAMOS QUE SE REFIERE A MEDICAMENTOS.</p>	<p>Es correcto. No aplica para esta licitación.</p>
<p>7. PUNTO 3.4.2. PRUESTA TECNICA. DOCUMENTO 15, SOLICITAN QUE LA PROPUESTA TECNICA DEBE SER PRESENTADA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REQUISITADO DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO 2 DE LAS BASES PUDIENDO PRESENTAR DOS O MAS PARTIDAS,</p>	<p>Es correcto, se solicita un servicio integral.</p>

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
 "SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
 TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES

<p>PERO EN EL ANEXO 1 INCISO 3, DICE QUE SE DEBERA PROPORCIONAR EL SERVICIO INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE BANCO DE SANGRE, EN EL CUAL INCLUYA TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESO.</p> <p>SOLICITAMOS LA CONVOCANTE QUE ACLARE EL PORQUE INDICAN PARTIDAS EN ALGUNOS PUNTOS DE LAS BASES, SI EL OBJETIVO DE ESTA LICITACION ES SERVICIO INTEGRAL, EN DONDE ENTENDEMOS QUE ESTA INTEGRADO POR PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS QUE ESTARIAN CONTENIDOS EN UN PAQUETE, Y NO UNA SERIE DE PARTIDAS, QUE NO QUEDA CLARO A QUE MARCO ANALITICO CORRESPONDE.</p>	
<p>8. ANEXO 1, INCISO 17, MENCIONAN PRESENTAR UN PLAN DE CALIDAD PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE HAGA DE NUESTRO CONOCIMIENTO A QUE SE RREFIERE Y NOS ENLISTE LAS NECESIDADES DEL USUARIO.</p>	<p>Se elimina el inciso 17 del anexo 1 de las bases de la licitación, dada que no aporta un beneficio, siendo obligatorio para todos los licitantes hacerlo de esta manera</p>
<p>9. ANEXO 1, INCISO 18, MENCIONAN QUE SE DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y HACER DEL CONOCIMIENTO DEL CETS DE LOS RESULTADOS ASI COMO DE SUS AVANCES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE A QUE SE REFIERE EN ESTE PUNTO, YA QUE ENTENDEMOS QUE COMO PRESTADORES DEL SERVICIO NOS CORRESPONDE PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE CADA UNA DE LAS AREAS, Y CORRESPONDE AL PERSONAL DE LA SS MOSTRAR UN PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA QUE INCLUYA LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.</p>	<p>Se elimina el inciso 18 del anexo 1 de las bases de la licitación, dada que no aporta un beneficio, siendo obligatorio para todos los licitantes hacerlo de esta manera</p>

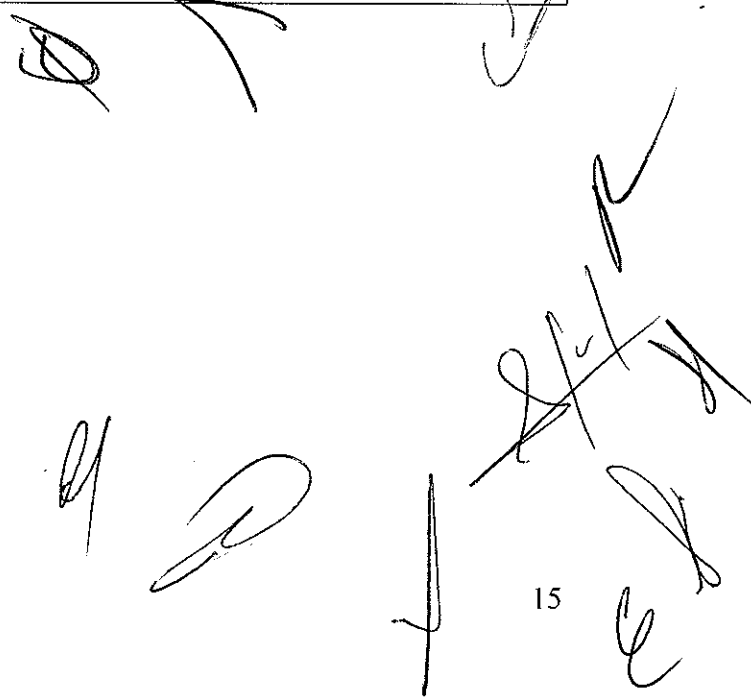“SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”

JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTAS DE CÁRACTER ADMINISTRATIVO

DE QUIMILAB S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>“SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”</p> <p>a) Pregunta: por Servicio Integral ¿debemos entender que esta licitación está dirigida para un solo proveedor que pueda ofertar todo lo que solicitan en el Anexo 1 de las presentes bases, es decir que un sólo proveedor abastezca a cada uno de los Hospitales señalados en la convocatoria con todos los requerimientos del anexo 1?</p> <p>b) Pregunta: ¿Un solo proveedor puede ofertar por partida de acuerdo al anexo 1 de estas bases? es decir si solo cumplimos con lo señalado en el rubro de Química Clínica, ¿solo podemos ofertar esa partida sin tener que ofertar las demás?</p> <p>2. Página 7 Plazo de entrega: LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA REQUIERE QUE LOS BIENES CONTRATADOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SE EFECTÚEN EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL FALLO ECONÓMICO Y/O FIRMA DEL CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS OBLIGACIONES QUE, EN FORMA PREVIA, DEBA CUMPLIR EL LICITANTE Y QUE SE MENCIONAN EN LAS PRESENTES BASES.</p> <p>a) Pregunta: ¿Están solicitando equipos nuevos y de reciente fabricación?</p> <p>b) Pregunta: En caso de resultar ganadores solicitamos amablemente a la convocante amplíe el tiempo de entrega de los equipos automatizados ya que tenemos entendido que requerirán que entreguemos equipos nuevos y de reciente fabricación y no podemos solicitar a las casas fabricantes equipos sin tener la seguridad de que seremos adjudicados por la convocante</p> <p>3. Página 8 1.6.- GARANTIA DE LOS BIENES.</p> <p>EL PERÍODO MÍNIMO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES QUE SE REQUIERE ES DE SEIS MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, LA CUAL SE DEBERÁ AMPARAR POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A LA FIRMA DEL MISMO.</p> <p>Pregunta: por tratarse de productos biológicos la caducidad de los bienes que ofertaremos en esta licitación cuentan con caducidad de 6 a 8 meses como máximo ¿Solicitamos a la convocante nos permita ofertar las caducidades antes mencionadas, entregando carta bajo protesta de decir verdad que en caso de no consumirse el reactivo lo canjearemos por otro de caducidad más amplia sin costo alguno para la convocante?</p>	<p>Esta pregunta no aplica para esta licitación.</p> <p>Esta pregunta no aplica para esta licitación.</p> <p>a) En efecto, se solicitan equipos nuevos y de reciente fabricación.</p> <p>b) No habrá prorroga. Se deberán considerar 45 días naturales después del fallo económico.</p> <p>No se acepta, se aclara que la caducidad de los insumos y reactivos de hematología e inmunohematología deben ser de un mínimo de tres meses, para el área de serología debe ser de seis meses y para todos los demás materiales como lo son las bolsas de recolección de sangre entre otros, debe ser como mínimo de un año.</p>

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
 "SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
 TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES





**PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO
 DE QUIMILAB S.A. DE C.V.**

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>Banco de Sangre:</p> <p>Características del equipo: a) Solicitan que tenga un procesamiento de 200 pruebas por hora</p> <p>Pregunta: ¿Nos aceptarían licitar un equipo que procese 180 pruebas por hora?</p> <p>Solicitan que los reactivos su presentación sea de 100 pruebas.</p> <p>Pregunta: La presentación de nuestros reactivos son de 200 pruebas, ¿nos aceptarían esta presentación?</p> <p>Cabe aclarar que tanto el equipo como los reactivos que vamos a ofertar son de la más alta calidad reconocidos a nivel mundial que cumplen con los estándares establecidos en bases de licitación.</p> <p>Favor de considerar que se pueda ofertar otras tecnologías equivalentes en todos los puntos que solicitan para que haya mayor cantidad de oferentes, insistimos para que haya mayor cantidad de oferentes, además esta característica no se establece como limitante en el cuadro básico del sector salud.</p>	<p>Se acepta, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>Se acepta, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p> <p>No se acepta. Apegarse a lo que ya está establecido en el anexo 1, apartado A</p>



**PREGUNTAS DE CÁRACTER ADMINISTRATIVO
 DE DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V.**

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>EN EL NUMERAL: 1.1 DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES Y SU VIGENCIA, SE ESPECIFICA QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO CON LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE RESULTE ADJUDICADA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI ES CORRECTA LA VIGENCIA DE LA CONTRATACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcto, la vigencia será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017</p>
<p>EN EL NUMERAL: 1.1 DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES Y SU VIGENCIA, SE ESPECIFICA QUE LA PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ GARANTIZAR QUE TODOS LOS BIENES COTIZADOS SEAN NUEVOS, SIN USO.</p>	

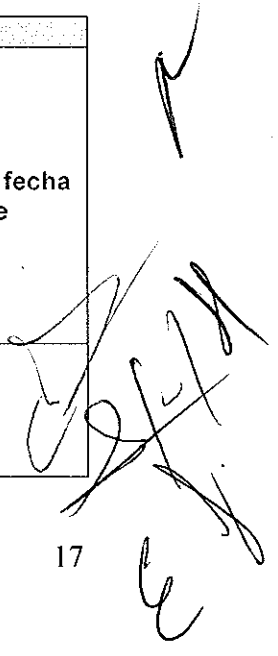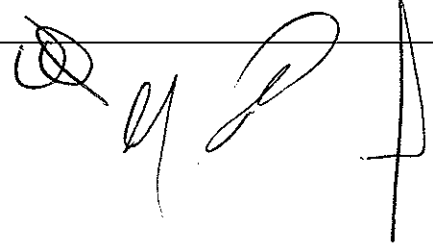




JUNTA DE ACLARACIONES

<p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DEFINIR SI LOS BIENES SON NUEVOS Y SIN USO, YA QUE EN EL ANEXO 1 PUNTO 2 SE ESTABLECE QUE LOS EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DEBERA ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. FAVOR DE ESPECIFICAR.</p>	<p>Se aclara por la convocante que todos los bienes cotizados sean nuevos.</p>
<p>EN EL NUMERAL: 1.1 DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES Y SU VIGENCIA, SE ESPECIFICA QUENO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS CONJUNTAS. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR PROPUESTAS DE PARTICIPACION CONJUNTAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aceptan propuestas en forma conjunta. Siempre y cuando ésta sea firmada por el representante común designado por el grupo de personas</p>
<p>INCISO 1.2 PLAZO DE ENTREGA SE MENCIONA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA REQUIERE QUE LOS BIENES CONTRATADOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SE EFECTÚEN EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL FALLO ECONÓMICO Y/O FIRMA DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LAS OBLIGACIONES QUE, EN FORMA PREVIA, DEBA CUMPLIR EL LICITANTE Y QUE SE MENCIONAN EN LAS PRESENTES BASES. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE DETERMINAR EL TIEMPO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EN DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL FALLO. FAVOR DE ESPECIFICAR.</p>	<p>Se deberán considerar 45 días naturales después del fallo económico.</p>
<p>INCISO 1.4 TRANSPORTE, INCISO A, SE ESTABLECE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO IDENTIFICARÁ LOS BIENES CON SU NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, LOTE, CANTIDAD Y EN SU CASO DE APLICAR CADUCIDAD Y CLAVE DE CUADRO BÁSICO. NO SE RECIBIRÁN BIENES QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO PREGUNTA: DERIVADO A QUE LA CONTRATACION QUE EMANE DE LA PRESENTE LICITACION ES POR UN "SERVICIO INTEGRAL" Y NO POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL INCISO "A". FAVOR DE CONSIDERAR.</p>	<p>Se acepta eliminar el inciso A del numeral 1.4.</p>
<p>EN EL NUMERAL 1.5 DEVOLUCIONES SE ESPECIFICA QUE LA CONVOCANTE PODRÁ HACER DEVOLUCIONES DE BIENES CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EN ESTOS CASOS EL PROVEEDOR SE OBLIGA A REPONER A LA CONVOCANTE Y SIN CONDICIÓN DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS HABILIS CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, EL 100% DEL VOLUMEN DE LOS BIENES DEVUELTOS POR EL ALMACÉN, MISMO QUE NO LE EXIME DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 10.4 DE ESTAS BASES. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE CONSIDERAR LA ELIMINACION DEL NUMERAL 1.5 DEVOLUCIONES YA QUE EL OBJETO DE LA</p>	<p>Se acepta eliminar el numeral 1.5.</p>

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>PRESENTE LICITACION ES POR LA CONTRATACION DE UN "SERVICIO INTEGRAL" Y NO POR LA DOTACION DE "BIENES". FAVOR DE CONSIDERAR.</p>	
<p>EN EL NUMERAL 1.6.- GARANTIA DE LOS BIENES SE ESTABLECE QUE EL PERIODO MÍNIMO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES QUE SE REQUIERE ES DE DOCE MESES (12 MESES), A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, LA CUAL SE DEBERÁ AMPARAR POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, INDEPENDIEMENTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE CONSIDERAR LA ELIMINACION DEL NUMERAL 1.6. GARANTIA DE LOS BIENES YA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION ES POR LA CONTRATACION DE UN "SERVICIO INTEGRAL CON PAGO POR SERVICIO REALIZADO" Y NO POR LA DOTACION DE "BIENES", MOTIVO POR EL CUAL LA CADUCIDAD NO REPRESENTA UN IMPACTO ECONOMICO A LA CONVOCANTE. FAVOR DE CONSIDERAR. O DEL CONTRATO, A LA FIRMA DEL MISMO.</p>	<p>No se acepta eliminar este numeral, se aclara que la caducidad de los insumos y reactivos de hematología e inmunohematología deben ser de un mínimo de tres meses, para el área de serología debe ser de seis meses y para todos los demás materiales como lo son las bolsas de recolección de sangre entre otros, debe ser como mínimo de un año.</p>
<p>EN EL NUMERAL 3.2.2.- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: ESTABLEQUE QUE RESPECTO DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO, LA CONVOCANTE DARÁ A LA AFIANZADORA SU AUTORIZACIÓN POR ESCRITO PARA CANCELAR LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES EN EL MOMENTO EN QUE EL PROVEEDOR DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN ESTA LICITACIÓN Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE. UNA VEZ FINIQUITADAS EN SU TOTALIDAD LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS PEDIDOS QUE FINCA LA CONVOCANTE, ES OBLIGACIÓN DE ESTA LIBERAR LAS FIANZAS QUE LOS GARANTIZAN PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES:</p> <p>1.- PEDIDO ADJUDICADO, (COPIA).</p> <p>2.- REMISIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS, DONDE CONSTE LA RECEPCION DE LOS BIENES Y, EN SU CASO, LA PRORROGA Y/O MODIFICACION AL PEDIDO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN PUNTO 1 Y 2 A FIN DE OBTENER LA CARTA DE LIBERACION DE GARANTIAS Y PRESETAR EN CAMBIO SOLO UN DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCION DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA, DONDE SE ESPECIFIQUE DICHO CUMPLIMIENTO. FAVOR DE CONSIDERAR.</p>	<p>Se acepta</p>
<p>EN EL NUMERAL 3.3.- PODERES QUE DEBERAN ACREDITAR INCLUIDOS EN LA DOCUMENTACION</p>	<p>En este caso se refiere a la elaboración del contrato con el licitante adjudicado</p>

JUNTA DE ACLARACIONES
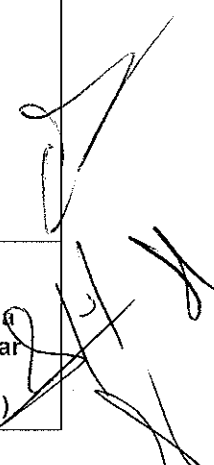
<p>COMPLEMENTARIA INDICADA EN EL PUNTO 3.4.1.</p> <p>EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO ORIGINAL Y COPIA, DONDE CONSTE LOS ALCANCES CON LOS QUE COMPARECE A ESTE EVENTO POR SI O POR INTERPOSITA PERSONA Y DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO 9 O BIEN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONTENIENDO LOS MISMOS DATOS QUE SE MENCIONAN EN DICHO ANEXO 7, ASIMISMO COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE VIGENTE O CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA), DOCUMENTO 2 DEL PUNTO 3.4.1.</p> <p>EN EL ULTIMO DE LOS CASOS, PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL(OS) PEDIDO(S), SE SOLICITARÁ LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA EN EL ANEXO 9, EN ORIGINAL Y COPIA, A TODOS LOS LICITANTES QUE HAYAN SIDO ADJUDICADOS.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SE DEBERA ENTENDER POR POR "ELABORACION DE LOS PEDIDOS". FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>EN EL NUMERAL 3.3.2 PREFERENCIAS EMPRESAS COLIMENSES SE ESTABLECE QUE PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE LICITAN, SE PREFERIRÁ EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE CUENTEN CON EL CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE, EXTENDIDO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO VIGENTE EN EL ESTADO. SE ESTABLECE ADEMÁS UN PORCENTAJE DIFERENCIAL DEL PRECIO OFERTADO POR LOS LICITANTES QUE CUENTEN CON DICHO CERTIFICADO HASTA 5% RESPECTO DE AQUELLAS EMPRESAS QUE NO LO TENGAN, POR LO QUE SE CONSIDERARÁ ESTE HECHO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS QUE SE RECIBAN, DEBIENDO EXHIBIRLO ANTE EL COMITÉ. ESTE CERTIFICADO DEBERÁ ADJUNTARSE A SU PROPUESTA TÉCNICA, DEBIDAMENTE ACTUALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.</p> <p>PREGUNTA: SE DEBERA ENTENDER QUE A UNA EMPRESA QUE CUENTE CON EL "CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE" SE LE PERMITIRA UNA PROPUESTA ECONOMICA 5% MAS ALTA Y POR ARRIBA DE LA PROPUESTA ECONOMICA DE UN LICITANTE QUE NO CUENTE CON DICHO CERTIFICADO. ¿FAVOR DE ESPECIFICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>Es correcto se dará preferencia a un licitante con certificado de empresa colimense, con un 7% de acuerdo al decreto 191 que reforma el artículo 11 de la LASASPEC, de fecha 09 de octubre de 2010.</p> 
<p>EN EL NUMERAL 3.4.1.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SE ESTABLECE EN EL DOCUMENTO 10.- ACREDITACIÓN POR PARTE DEL LICITANTE DE HABER CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO</p>	<p>Documento que acredita que el licitante ha cumplido con la obligación de proporcionar información actualizada al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)</p> 

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>PREGUNTA: FAVOR DE ESPECIFICAR QUE SE DEBERA ENTENDER POR ESTA ACREDITACION. FAVOR DE ESPECIFICAR.</p>	<p>expedido por la cámara a la que se encuentre afiliado</p>
<p>4.1.-CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN SE ESTABLECE QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE, SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS A LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS POSTERIORES A LA FECHA EN QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEBIDAMENTE INTEGRADA Y REQUISITADA, EN CADA UNIDAD MEDICA (ANEXO 1), PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY; ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES QUE ANTE LA FALTA O RETRASO EN LOS PAGOS POR NINGUN MOTIVO SE SUSPENDERA LA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA ELIMINACION DEL TEXTO QUE DICE "ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES QUE ANTE LA FALTA O RETRASO EN LOS PAGOS POR NINGUN MOTIVO SE SUSPENDERA LA ENTREGA DE MEDICAMENTO, MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO", YA QUE DICHO TEXTO PONE EN RIESGO LA OPERACION DEL PROVEDOR ADJUDICADO. FAVOR DE CONSIDERAR.</p>	<p>No se acepta eliminar. Se aclara que la presente licitación se refiere a insumos, reactivos y equipo (no a medicamentos). Por ningún motivo se suspenderá la prestación del servicio integral materia del objeto de la presente licitación.</p>
<p>EN EL NUMERAL 5.2.- EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS: SE ESTABLECE QUE SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPUESTAS SON SOLVENTES Y POR LO TANTO, SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS, EL PEDIDO SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA CUYO PRECIO UNITARIO POR BIEN, SEA EL MÁS BAJO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SE DEBERA ENTENDER POR "EL PEDIDO SE ADJUDICARA A LA PROPUESTA CUYO PRECIO UNITARIO POR BIEN, SEA MAS BAJO" SI LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS SE REALIZA POR EL MONTO TOTAL GLOBAL DE LO OFERTADO. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Esto quiere decir que en la evaluación de la propuesta económica se dará preferencia al precio más bajo, en función a los renglones.</p>
<p>6.- FIRMA DEL CONTRATO Y DE LOS PEDIDOS, ESTABLECE QUE EL PEDIDO SE FINCARA EN LA FECHA QUE DETERMINE LA CONVOCANTE Y A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES HABLES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SE DEBERA ENTENDER EN EL TEXTO "EL PEDIDO SE FINCARA". FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>En este caso se refiere a la elaboración del contrato.</p>
<p>SIN REFERENCIA PREGUNTA: SE DEBERA ENTENDER QUE LAS PARTIDAS FACTURABLES CORRESPONDEN A "BIOMETRIA DEL DONADOR RECHAZADO", "UNIDADES PROCESADAS EN EL CETS", "UNIDADES PROCESADAS DE PUESTOS DE SANGRADO" Y LOS "PROCEDIMIENTOS POR AFERESIS". ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACION?</p>	<p>Es correcta su interpretación</p>

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>ANEXO 11, MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTABLECER LOS CONSUMOS MAXIMOS POR TIPO DE PARTIDA FACTURABLE Y QUE CORRESPONDERAN AL TOTAL DE LO OFERTADO DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: "BIOMETRIA DEL DONADOR RECHAZADO", "UNIDADES PROCESADAS EN EL CETS", "UNIDADES PROCESADAS DE PUESTOS DE SANGRADO" Y LOS "PROCEDIMIENTOS POR AFERESIS". FAVOR DE PROPORCIONAR.</p>	<p>Productividad aproximadamente por año:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Unidades procesadas en el CETS y puesto de sangrado: 9,000 5. Los procedimientos por aféresis: 40 6. Biometría del donador rechazado: 2,000
---	---



PREGUNTAS DE CÁRACTER LEGAL

DE DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>ANEXO 2-A FORMATO DE RESUMEN DE PROPUESTA TECNICA, PARTIDA PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI LA "PARTIDA" SE REFIERE AL TIPO DE PRUEBAS DENOMINADAS "BIOMETRIA DEL DONADOR RECHAZADO", "UNIDADES PROCESADAS EN EL CETS", "UNIDADES PROCESADAS DE PUESTOS DE SANGRADO" Y LOS "PROCEDIMIENTOS POR AFERESIS". FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Es correcto</p>
<p>ANEXO 2-A FORMATO DE RESUMEN DE PROPUESTA TECNICA, DESCRIPCION SINTETIZADA DE LOS BIENES. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI LA "DESCRIPCION SINTETIZADA DE LOS BIENES" SE REFIERE A LA CONSOLIDACION TECNICA DEL EQUIPO Y PARA LAS PARTIDAS FACTURABLES ("BIOMETRIA DEL DONADOR RECHAZADO", "UNIDADES PROCESADAS EN EL CETS", "UNIDADES PROCESADAS DE PUESTOS DE SANGRADO" Y LOS "PROCEDIMIENTOS POR AFERESIS"). FAVOR DE ACLARAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unidades procesadas en el CETS 2. Unidades procesadas de puestos de sangrado 3. Los procedimientos por aféresis 4. Biometría del donador rechazado
<p>ANEXO 6, MODELO DE PRECIOS, ESTABLECE QUE LOS PRECIOS SERÁN SUJETOS DE UNA REVISIÓN ANUAL Y EL INCREMENTO NO PODRÁ SER SUPERIOR A LA INFLACIÓN ANUAL, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS MEDICAMENTOS QUE ESTÁN SUJETOS A LAS ACTUALIZACIONES QUE EMITA LA COMISIÓN COORDINADORA PARA LA NEGOCIACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD, CUYO PRECIO VARIARÁ DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN DE LA CITADA COMISIÓN. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DEBERA ENTENDERSE COMO "PROCEDIMIENTOS DE BANCO DE SANGRE" A LOS TEXTOS QUE SE MENCIONAN COMO "MEDICAMENTOS". FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Aclaración: si, dice medicamento en la propuesta, favor de modificar a reactivos y otros insumos para banco de sangre.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>ANEXO 11, MODELO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DESCRIPCION. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR QUE DEBERA CONTENER EL RECUADRO DENOMINADO COMO "DESCRIPCION:". FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Descripción deberá contener el nombre de cada una de las pruebas a ofertar</p>
<p>ANEXO 12 VIGENCIA DE LA PROPUESTA TECNICA. ESTABLECE QUE SE MANTENDRA LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA TECNICA, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 36066001-008-16 Y HASTA LA FIRMA DEL PEDIDO PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR PARA EL ANEXO 12 QUE DEBERA DE ENTENDERSE COMO "HASTA LA FIRMA DEL PEDIDO". FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Se refiere a la firma del contrato.</p>
<p>ANEXO 13 VIGENCIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA. SE ESTABLECE QUE SE MANTENDRA LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 36066001-009-16 Y HASTA LA FIRMA DEL PEDIDO, LO CUAL ÚNICAMENTE SERÁ MODIFICADO TRATÁNDOSE DE BIENES O SERVICIOS SUJETOS A PRECIOS OFICIALES, SE RECONOCERÁN LOS INCREMENTOS AUTORIZADOS, POR LO QUE SERÁN SUJETOS DE UNA REVISIÓN ANUAL Y EL INCREMENTO NO PODRÁ SER SUPERIOR A LA INFLACIÓN ANUAL. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR PARA EL ANEXO 13 QUE DEBERA DE ENTENDERSE COMO "HASTA LA FIRMA DEL PEDIDO". FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Se refiere a la firma del contrato.</p>
<p>ANEXO 14, CARTA GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS, SE ESTABLECE QUE LOS BIENES ADJUDICADOS CUENTAN CON GARANTIA MINIMA POR 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION O VICIOS OCULTOS, CONSIDERANDO LA SUSTITUCION DEL TOTAL DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE ANEXO 14, YA QUE LA CONTRACION QUE EMANE DE LAS PRESENTES BASES CORRESPONDE A LA DOTACION DE UN "SERVICIO" Y NO A LA DOTACION DE "BIENES". FAVOR DE CONSIDERAR SU ELIMINACION.</p>	<p>Se acepta eliminar anexo 14 de las bases de la licitación.</p>
<p>ANEXO 12, MODELO DE CONTRATO PREGUNTA: DERIVADO A QUE EN EL CUERPO DE LAS PRESENTE BASES NO SE PROPORCIONA EL MODELO DEL CONTRATO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OTORGAR EL MODELO DEL CONTRATO. FAVOR DE PROPORCIONAR.</p>	<p>El contrato se proporcionará al licitante adjudicado.</p>

PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO

DE DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V.


JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>EN EL NUMERAL 2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION INCISO G. SOLICITA COPIA DEL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES (ANVERSO Y REVERSO), EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS). PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR REGISTROS DE SALUD CUYA VIGENCIA SEA MENOR A LOS 5 AÑOS QUE SOLICITA EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta. El registro sanitario deberá estar vigente, en caso de no estarlo deberá presentar la prorroga vigente emitida por la COFEPRIS y mantenerlo vigente a la fecha del término del contrato.</p>
<p>EN EL NUMERAL 2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION INCISO G. SOLICITA COPIA DEL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES (ANVERSO Y REVERSO), EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS). PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DE LA RESPECTIVA SOLICITUD DE PROROGA ANTE COFEPRIS EN CAMBIO DEL REGISTRO DE SALUD VIGENTE ¿SE PERMITE?</p>	<p>Se acepta. El registro sanitario deberá estar vigente, en caso de no estarlo deberá presentar la prorroga vigente emitida por la COFEPRIS y mantenerlo vigente a la fecha del término del contrato.</p>
<p>APARTADO A, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS, CARACTERISTICAS GENERALES, SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO AUTOMATIZADO COMPLETO MODERNO DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA O QUIMIOLUMINISCENCIA Y ENSAMBLADOS DE MANERA INTEGRAL EN EL PAÍS DE ORIGEN; PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS PRUEBAS SEROLÓGICA QUE LA NOM 253 SSA1-2012 ESTABLECE COMO OBLIGATORIAS (HIV, HCV, AGSHB, CHAGAS Y SÍFILIS). PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA INSTALACION DE UNA PLATAFORMA ALTERNA PARA LAS PRUEBAS DE CHAGAS Y SIFILIS CUYAS CARACTERISTICAS TECNICAS SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: • SIN LA MANIPULACIÓN DE REACTIVOS: CARTUCHOS DE REACTIVOS AUTOCONTENIDOS, PRECALIBRADOS Y LISTOS PARA UTILIZARSE • LECTOR INTEGRADO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA CARTUCHOS DE REACTIVOS, MUESTRAS Y CALIBRADORES • CARTUCHOS REFRIGERADOS A 4°C Y ESTABLES HASTA MÁS DE 2 MESES EN EL INSTRUMENTO • SENCILLO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CON GRADILLAS QUE ACEPTA HASTA 30 MUESTRAS • INTERFAZ CON WINDOWS Y MONITOR PLANO DE LCD "TOUCH SCREEN", CON PETICIONES INTUITIVAS • HASTA A220 CARTUCHOS DE REACTIVOS EN EL INSTRUMENTO • DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS</p>	<p>No se acepta, por la infraestructura del CETS y la demanda de hemocomponentes; además de que dos equipos requieren de un trabajador adicional.</p>

"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>DE LA SEMANA • HASTA 64 PRUEBAS/HORA TIEMPO AL PRIMER RESULTADO: ~ 30 MINUTOS • PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ALEATORIO O POR LOTES • CARGA CONTINUA DE MUESTRAS • DETECCIÓN DE COÁGULOS • FUNCIÓN DE STAT • VALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE RESULTADOS • MULTIREGLAS DE WESTGARD • GRÁFICAS LEVEY-JENNINGS • LA TECNOLOGÍA QUIMIOLUMINISCENTE INCREMENTA LA EXACTITUD Y SENSIBILIDAD • SIN INTERFERENCIA ÓPTICA ¿SE PERMITE?</p>	
<p>APARTADO A, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS, CARACTERISTICAS GENERALES, SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGIA CUYA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO MINIMO ES DE 200 PRUEBAS POR HORA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA INSTALACION DE UNA PLATAFORMA CUYA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO ES DE 189 PRUEBAS POR HORA. ¿SE PERMITE?</p>	<p>Si se acepta. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>APARTADO A, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS, CARACTERISTICAS GENERALES, SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGIA DONDE EL MARCADOR DE HIV DEBERA DETECTAR ANTIGENO Y ANTICUERPO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR PROPONER UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGIA DONDE EL MARCADOR DE HIV SEA SOLO ANTICUERPOS. ¿SE PERMITE?</p>	<p>No se acepta, el kit debe detectar antígeno y anticuerpo del HIV tipo I y II, y de la proteína P24. De conformidad con los numerales 9.4.12 y 9.4.12.1 de la NOM 253 SSA1-2012</p>
<p>APARTADO A, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS, CARACTERISTICAS GENERALES, SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGIA DONDE LA TOMA DE MUESTRA Y/O REACTIVO SEA CON PUNTA DE ACERO INOXIDABLE, QUE NO UTILICE PUNTILLAS DESECHABLES PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR PROPONER UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGIA DONDE LA TOMA DE MUESTRA SE REALICE POR PUNTAS DESECHABLES. ¿SE PERMITE?</p>	<p>No se acepta, debe apegarse a lo establecido. De conformidad con los numerales 9.4.12 y 9.4.12.1 de la NOM 253 SSA1-2012</p>
<p>APARTADO A, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS, CARACTERISTICAS GENERALES, SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA CENTRIFUGA CLÍNICA DE VELOCIDAD CON UN RANGO DE VELOCIDAD DE 1.600 A 5,300 RPM, CON ROTOR PARA 24 TUBOS DE 12X100 MM Y UNA</p>	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature







Handwritten signature

Handwritten signature

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>CENTRIFUGA PARA MICROTUBO DE 1.5 ML CON ROTOR DE 24, QUE ALCANCE LA VELOCIDAD DE 250 A 15,000 RPM PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS CENTRIFUGAS QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN DICHO APARTADO SE DEBERA CONTEMPLAR LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS EN LA PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Si, se debe de presentar los documentos técnicos.</p>
<p>APARTADO B, SISTEMA INFORMATICO PARA LA DETERMINACION DE DONADORES EN BS Y PS, ESTABLECE QUE EL PROGRAMA INFORMATICO DEBERA DE CONTAR CON REPORTE DE BITACORA POR USO DE REACTIVOS. PREGUNTA: SE PERMITE LA ELIMINACION DE ESTE PUNTO YA QUE LA CONTRATACION QUE EMANE DE LAS PRESENTES BASES ES POR UN SERVICIO INTEGRAL Y NO DE BIENES. ¿SE PERMITE?</p>	<p>No se acepta, apegarse a lo establecido.</p>
<p>APARTADO C, CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS A PORPORCIONAR, ESPECIFICA QUE SE DEBERA PROPORCIONAR REACTIVO POR QUIMIOLUMINISCENCIA O INMUNOENZIMÁTICO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI VIH-1, ANTI VIH-2 Y ANTI VIH-1 Y P24. QUE INCLUYE: CONTROLES, REACTIVOS, CALIBRADORES Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CUYO REACTIVO A UTILIZAR CONTEMPLA SOLO LA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI VHI 1 Y 2. ¿SE PREMITE?</p>	<p>No se acepta, apegarse a lo establecido. El kit debe detectar antígeno y anticuerpo del HIV tipo I y II, y de la proteína p24. De conformidad con los numerales 9.4.12 y 9.4.12.1 de la NOM 253 SSA1-2012</p>
<p>APARTADO D, CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACION DE LAS BIOMETRIAS HEMATICAS. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTA PERMITIR LA PROPUESTA TECNICA DE UN ANALIZADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS: TECNOLOGÍA: LA TECNOLOGÍA DE DISPERSIÓN DE LUZ LÁSER DE DIFERENCIAL DE 5 PARTES WBC; MÉTODO DE IMPEDANCIA DE CBC: WBC, RBC Y PLT, ABSORBANCIA DE LUZ PARA MEDICIÓN HGB. PARÁMETROS: 26 PARÁMETROS, INCLUYENDO DIFERENCIAL DE 5 PARTES CON DOS HISTOGRAMAS Y DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN DE RBC Y PLT: BBASO, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC,HCT, MCV, RDW-SD*, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT*, MPV, PDW-SD*, PDW-CV*, P-LCC*, P-LCR* MODOS/VOLÚMENES DE MUESTRA: MANUAL DE TUBO CERRADO/110 µL; MANUAL DE TUBO ABIERTO/110µL; CARGADOR AUTOMÁTICO OPCIONAL/110 µL RENDIMIENTO 60 PRUEBAS/HORA BASE DE DATOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 100.000 PACIENTES CONTROL DE CALIDAD 24 LOTES DE CONTROL DE CALIDAD, BASE DE DATOS DE CONTROL DE</p>	<p>Si se acepta, es permitido.</p>

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>CALIDAD INDEPENDIENTE, GRÁFICOS LEVY-JENNINGS, OPCIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS PARA CARGAR VALORES OBJETIVOS DE CONTROL DE CALIDAD, Y CÓDIGO QR DE LECTURA PARA LA ENTRADA DE DATOS DE REFERENCIA. IMPRESIÓN IMPRESORAS OPCIONALES EXTERNAS COMPATIBLES CON MICROSOFT WINDOWS LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS DE MANO ESTÁNDAR INTERFAZ DE USUARIO GRÁFICOS EN COLOR DE 600 X 800, PANTALLA TÁCTIL LCD DE 10.4 PULGADAS CAPACIDADES DE INTERCONEXIÓN RS232, USB, ETHERNET; INTERFAZ DE USUARIO MULTILINGÜE ENERGÍA ELÉCTRICA LÍNEA DEDICADA, VOLTAJE SELECCIONABLE PARA UNA SOLA FASE, 100 VAC (6 AMPERIOS) - 240 VAC (3 AMPERIOS) TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO 15 A 30°C HUMEDAD RELATIVA 10-80% (SIN CONDENSACIÓN) PESO 35 K/77 LIBRAS DIMENSIONES 52 (A) X 41 (P) X 49 (D) CM; 20 (A) X 16 (P) X 19 (D) PULGADAS TRES REACTIVOS SIN CIANURO DILUYENTE, DISOLVENTE Y LIMPIADOR IDIOMAS DE USUARIO CROATA, INGLÉS, FRANCÉS, GRIEGO, ALEMÁN, HÚNGARO, ITALIANO, POLACO, PORTUGUÉS, RUSO, ESPAÑOL, TURCO CAPACIDAD DE LA MUESTRA 100 TUBOS: 10 BASTIDORES CON 10 TUBOS DE MUESTRA POR BASTIDOR LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INCORPORADO MEZCLADOR INCORPORADO RECONOCIMIENTO DE LA TAPA SÓLO SE MEZCLAN Y SE PROCESAN LOS TUBOS TAPADOS ¿SE PERMITE?</p>	
<p>APARTADO E, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACION DE AFERESIS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA MÁQUINA PARA LA REALIZACIÓN DE AFÉRESIS QUE PESA MENOS DE 27 KG, DE FÁCIL PORTABILIDAD PARA PROCEDIMIENTOS A PIE DE CAMA Y MANEJO DE VOLÚMENES EXTRACORPÓREOS BAJOS ADECUADAS PARA PLASMAFERESIS EN NIÑOS DE BAJO PESO CORPORAL. ¿SE ACEPTA</p>	<p>No se acepta. No se realiza plasmaféresis, solo plaquetaféresis en donadores sanos mayores de 18 años. estos procedimientos se llevan acabo en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y no en hospital.</p> 
<p>APARTADO E, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACION DE AFERESIS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA MÁQUINA DE AFÉRESIS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA MÁQUINA PARA LA REALIZACIÓN DE AFÉRESIS QUE PESA MENOS DE 27 KG, DE FÁCIL PORTABILIDAD PARA PROCEDIMIENTOS A PIE DE CAMA SIN LA CARACTERÍSTICA DE MANGUITO, YA QUE ESTE ES PRIVATIVO DE UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, LO QUE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta, apegarse a lo establecido.</p> 
<p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA</p>	  

Handwritten signature

Handwritten mark


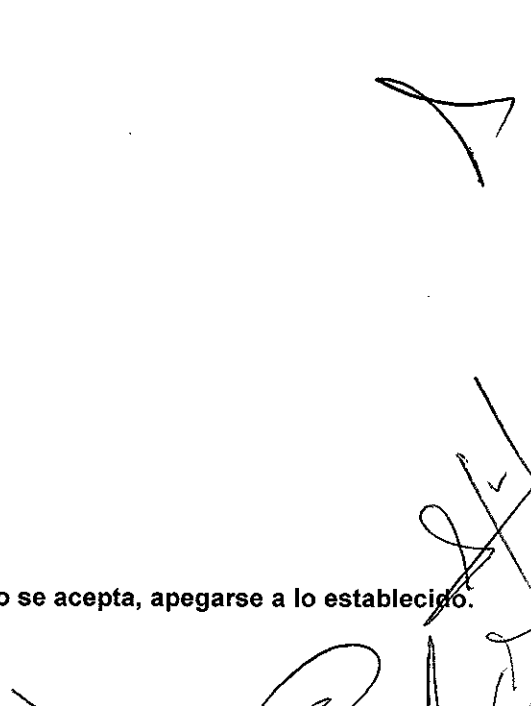
Handwritten mark

<p>CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO EX VIVO DE PLAQUETAS DE LA CAPA DE LEUCOCITOS OBTENIDAS A PARTIR DE SANGRE ENTERA Y DE PLAQUETAS DE AFÉRESIS, QUE INACTIVA UN AMPLIO ESPECTRO DE VIRUS, BACTERIAS Y PARÁSITOS, ASÍ COMO LOS LEUCOCITOS CONTAMINANTES DEL DONANTE, EN CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. EL DISPOSITIVO EMPLEA UN COMPUESTO FOTOACTIVO QUE SE ILUMINA CON LUZ ULTRAVIOLETA (UVA) DE LONGITUD DE ONDA LARGA (DE 320 A 400 NM) PARA EL TRATAMIENTO FOTOQUÍMICO DE LOS CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, LO CUAL ELIMINA EL RIESGO DE TRANSFUNDIR VIRUS EMERGENTES COMO ZIKA CHIKUNGUNYA Y DENGUE, ENTRE OTROS MUCHOS, ASÍ COMO LAS REACCIONES ADVERSAS POST-TRANSFUSIONALES, QUE ADEMÁS CUENTA CON APROBACIÓN DE FDA Y CE, ENTRE OTRAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta, sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>APARTADO F EQUIPO MEDICO LINEAMIENTOS GENERALES, REACTIVOS Y CONSUMIBLES PUNTO 2, ESTABLECE QUE TODOS LOS REACTIVOS CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES Y ACCESORIOS DEBERÁN PRESENTARSE LISTOS PARA SER UTILIZADOS. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLAEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR BIENES QUE POR SU NATURALEZA O ESTABILIDAD TENGAN PREPARACION POR PARTE DEL USUARIO, DEBIENDO ENTREGAR EL PROVEEDOR TODO LOS INSUMOS Y MATERIALES PARA SU PREPARACION Y SIN COSTO ADICIONAL A LA INSTITUCION. ¿SE PERMITE?</p>	<p>Si se acepta, siempre y cuando solo sean soluciones buffer y soluciones de lavado.</p>
<p>APARTADO F, EQUIPO MEDICO LINEAMIENTOS GENERALES, REACTIVOS Y CONSUMIBLES PUNTO 3, LA VIGENCIA DE LOS REACTIVOS, CALIBRADORES Y CONTROLES NO DEBERÁ SER MENOR A 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. PREGUNTA: DERIVADO A QUE LA CONTRATACION QUE EMANE DE LA PRESENTE LICITACION ES POR UN "SERVICIO INTEGRAL" Y NO POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR DICHO PUNTO. FAVOR DE CONSIDERAR.</p>	<p>No se acepta, se aclara que la caducidad de los insumos y reactivos de hematología e inmunohematología deben ser de un mínimo de tres meses, para el área de serología debe ser de seis meses y para todos los demás materiales como lo son las bolsas de recolección de sangre entre otros, debe ser como mínimo de un año.</p>
<p>APARTADO G, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA PREGUNTA: SE PERMITE OFERTAR TECNICAMENTE UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACION DE GRUPOS SANGUINEOS ABO Y RH POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA DE TECNOLOGÍA DE AGLUTINACIÓN EN COLUMNA. ¿SE PERMITE?</p>	<p>Si se acepta, siempre y cuando también se realice el grupo inverso y el de débil. Sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.</p>

PREGUNTAS DE CARACTER TÉCNICO

DE DICIPA S.A. DE C.V.

JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. CARTA DE RESPALDO, DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE, POR LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO "1".</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO APOSTILLADO SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta</p> 
<p>DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. CARTA DE RESPALDO, DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE, POR LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO "1".</p> <p>PREGUNTA: DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS A LOS DIFERENTES PAISES A TRAVES DE FILIALES Y/O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE LA ENTREGA DE DICHAS CARTAS EXPEDIDAS POR ALGUNA DE LAS FIGURAS JURIDICAS ANTES MENCIONADAS ACOMPAÑADAS DE COPIA SIMPLE DE LA AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se acepta considerando que en dado caso que no se cuente con la carta del fabricante se podrá presentar carta de apoyo emitida por la filial en México y que sea el titular del registro sanitario.</p>
<p>ANEXOS TECNICOS: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGIATIPO I Y II: CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION A LOS PROVEEDORES LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN EQUIPO DE SIMILARES O MAYORES CARACTERISTICAS AL SOLICITADO</p> <p>1. REFERENCIA: ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA II QUE LOS REACTIVOS SEAN LIBRES DE CIANURO DE LA MISMA MARCA QUE LOS INSTRUMENTOS.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN ANALIZADOR QUE UTILICE REACTIVOS NO LIBRES DE CIANURO AVALANDO SU INOCUIDAD AL USUARIO Y AL MEDIO AMBIENTE CON LAS CARTAS DE SEGURIDAD DE LOS REACTIVOS Y UN ANÁLISIS DE DESECHOS EMITIDO</p>	<p>No se acepta, apegarse a lo establecido.</p> 



COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
 "SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
 TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
 JUNTA DE ACLARACIONES

DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE.	
------------------------------	--

**PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO
 DE PROMADIX S. DE R.L. DE C.V.**



PREGUNTA	RESPUESTA
Se solicita a la convocante permitir se oferten equipos que cumplan con la finalidad que es realizar el estudio señalado en estas bases, sin tener que apegarse a las características de los equipos señaladas en los anexos.	No se acepta, apegarse a lo establecido.
Despues de revisar ampliamente las características de los equipos enlistados en los anexos hacemos la observación que dichos equipos solo se pueden encontrar con Roche, por lo que sería beneficiado el proveedor que actualmente está dando el servicio siendo el que tendría la carta de apoyo de dicho fabricante.	No es correcta su observación.

**PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO
 DE LABORTAORIOS LICON S.A.**

PREGUNTA	RESPUESTA
1.-APARTADO G. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN SI PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA REALIZACIÓN DEL GRUPO DIRECTO E INVERSO EN UN SOLO PASO LA TARJETA DE GEL QUE CONTENGA (ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CONTROL, A1 Y B); ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 9.5.2.1 INCISO A Y PUNTO 9.5.3.1 DE ESTA NORMA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Si, es correcta la apreciación.
2. APARTADO G. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA. SE REQUIERE	

[Handwritten signature]




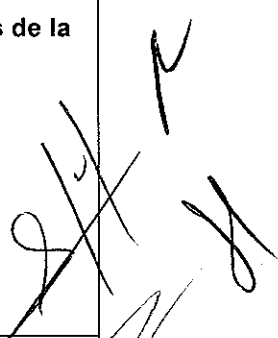




[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




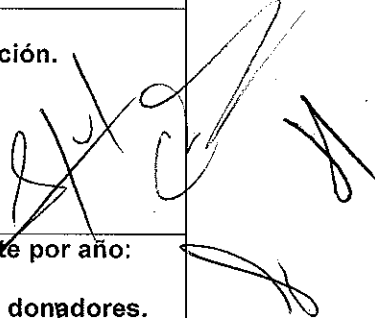





[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

<p>GRUPO ABO Y RH (2D) Y PRUEBAS DE GRUPO INVERSO EN TARJETAS DE GEL. POR LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO NO ES POSIBLE CUMPLIR CON LA CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES , POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS PERMITAN ENTREGAR UNA CADUCIDAD MINIMA DE 8 MESES JUNTO CON UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HACER CAMBIO FISICO EN CASO DE CADUCAR EL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>Si se acepta, siempre y cuando se entregue una carta compromiso de canje.</p> 
<p>3. APARTADO G. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA. SE REQUIERE TARJETAS DE COMPATIBILIDAD EN TARJETAS DE GEL. POR LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO NO ES POSIBLE CUMPLIR CON LA CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES , POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS PERMITAN ENTREGAR UNA CADUCIDAD MINIMA DE 6 MESES JUNTO CON UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HACER CAMBIO FISICO EN CASO DE CADUCAR EL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>Esta prueba no forma parte de las bases de la presente licitación.</p>  
<p>4. APARTADO G. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI DEBEMOS CONSIDERAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN GEL LA UTILIZACIÓN DE 3 POZOS POR PRUEBA (PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y AUTOCONTROL). ¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>Esta prueba no forma parte de las bases de la presente licitación.</p> 
<p>5.- SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI PARA EL APARTADO G. EQUIPO</p>	   



JUNTA DE ACLARACIONES

<p>AUTOMATIZADO PARA INMUNOHEMATOLOGIA, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE DEBEMOS ENTREGAR CARTA DE APOYO, DEL PROVEEDOR DEL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD, EL CUAL DEBE CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD (EMA), EN LAS ÁREAS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSAI-2012 EN EL PUNTO 15.1.4, ADICIONAL DEL PROGRAMA SOLICITADO DEL CNTS.</p> <p>¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>Si, es correcta la apreciación.</p> 
<p>6.- ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE EN INSUMOS NECESARIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DONADOR. PARA LOS ANTISUEROS ANTI A, ANTI B, ANTI AB Y ANTI D. LAPRESENTACIÓN A ENTREGAR DEBE DE SER DE 10 ML.</p> <p>¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>Si, es correcta la apreciación.</p> 
<p>7.- ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE EN INSUMOS NECESARIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DONADOR. PARA LA LECTINA H Y LECTINA A1 LA PRESENTACION A ENTREGAR DEBERA DE SER DE 5ML.</p> <p>¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>Si, es correcta la apreciación.</p> 
<p>8.- ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE EN INSUMOS NECESARIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DONADOR. ANTI SUERO ANTI IgG (COOMBS). LA PRESENTACION A ENTREGAR DEBERA DE SER DE 10 ML.</p> <p>¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>Si, es correcta la apreciación.</p> 
<p>9.- SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE INDICAR LA CANTIDAD A SURTIR TANTO PARA GRUPO SANGUINEO DIRECTO E INVERSO</p>	<p>Productividad aproximadamente por año: CETS=16,000 predonantes y 8,000 donadores. HGMzo= 2.000 predonantes y 1,000 donadores HGT: A reserva de lo que se recolecte una vez</p>     

COMITE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS A/1
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-009-16
"SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO"
JUNTA DE ACLARACIONES

A SI COMO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CRUZADA.	abierto este puesto de sangrado. No se realizan pruebas de compatibilidad.
--	---