

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **22:10** horas del día **28** de **Febrero** de **2018**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 numeral 4° y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los participantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-008-18**, relativa: **PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

El acto fue presidido por el **C.P. Arnoldo Moreno Medina, Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales**, quien fue autorizado mediante oficio DA/368/2018, de fecha 28 del mes y año en curso, y firmado por la Directora Administrativa, la LAET. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.

2.- La convocante hace la siguiente precisión, que la documentación deberá venir foliada.

3.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desestimada.

4.- La convocante hace las siguientes aclaraciones:

a).- Con respecto a los "Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes en el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas de la licitación", punto **3.18. CARTA COMPROMISO (Anexo 13)** se aclara lo siguiente:

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

Dice:

"El que suscribe \_\_\_\_\_ representante legal de la empresa \_\_\_\_\_, manifiesta que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional. 36066001-008-18** para la contratación del "**Servicio Integral para el Suministro de Insumos y Comodato de Equipos para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de los Servicios de Salud del Estado de Colima**", me comprometo bajo protesta de decir verdad a pagar la nómina, seguro social, impuestos federales y estatales, viáticos y cualquier importe derivado de la relación obrero patronal que tenga con todas y cada una de las personas que integren mi grupo de trabajo, durante el período del servicio, sin responsabilidad alguna para los Servicios de Salud del Estado de Colima, así como también me responsabilizo de cualquier acción u omisión de mi grupo de trabajo que perjudique a la misma secretaria y/o a terceros".

Debe decir:

"El que suscribe \_\_\_\_\_ representante legal de la empresa \_\_\_\_\_, manifiesta que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional. 36066001-008-18** para la contratación del "**Servicio Integral para el Suministro de Insumos y Comodato de Equipos para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de los Servicios de Salud del Estado de Colima**" me comprometo bajo protesta de decir verdad a garantizar los bienes con las características señaladas en el anexo número 1 técnico contra defectos de calidad y fabricación por un periodo de 12 meses a partir de la entrega del bien."

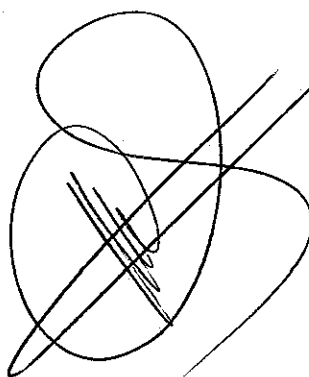

b).- De igual manera se comunica que en el numeral 5, Firma de contrato de la **Licitación Pública Nacional. 36066001-008-18** para la contratación del "**Servicio Integral para el Suministro de Insumos y Comodato de Equipos para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de los Servicios de Salud del Estado de Colima**":

Dice:

"5. Firma del contrato (anexo 14)"

Debe decir:

"5. Firma del contrato."



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

c).- Asimismo se precisa que en el numeral 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, inciso K:

Dice:

"El licitante deberá incluir carta de apoyo de los fabricantes o titular del registro sanitario, distribuidor primario y/o Subdistribuidor en papel membretado y con firma autógrafa del representante legal, en la que éste manifieste respaldar la propuesta que se presente, por la clave descrita en el Anexo 1.!"

Debe decir:

"El licitante deberá incluir carta de apoyo de los fabricantes o titular del registro sanitario, distribuidor primario y/o Subdistribuidor en papel membretado y con firma autógrafa del representante legal, en la que este manifieste respaldar la propuesta que se presente, por la clave descrita en el Anexo 1; Aplicable para los equipos de Serología Diagnóstica, Biometría Hemática y Aféresis; así como para el sistema informático."

d).- En el requisito "3.19.- ISO 9001:2015 del Licitante", se hace la siguiente precisión:

Dice:

"3.19.- ISO 9001:2015 del Licitante. Los licitantes deberán presentar dentro de su propuesta original para cotejo y copia certificada del certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 y/o ISO 9001:2015 del licitante, cuyo alcance sea "venta, distribución, instalación, operación y mantenimiento de equipos de banco de sangre, ofreciendo servicios integrales.", vigente y expedido por un organismo certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C."

Debe decir:

"3.19 ISO 9001:2015 del Licitante: Los licitantes deberán presentar dentro de su propuesta original para cotejo y copia certificada del certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 y/o ISO 9001:2015 del licitante, cuyo alcance sea "venta, distribución, instalación, operación y mantenimiento de equipos de banco de sangre, ofreciendo servicios integrales.", vigente, lo cual deberá hacer constar que cuentan con la experiencia en la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad; por lo cual, deberán de integrar dentro de su propuesta técnica, copia certificada de su constancia de certificación en sistema de gestión de

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

calidad ISO 9001:2015 y/o ISO 9001:2008; en caso de presentar esta ultima; deberán presentar sus tramites para iniciar con la certificación ISO 9001:2015; así mismo, presentar al menos una carta de recomendación original a favor del participante expedida por un organismo público, dirigida a la convocante, mencionando que el participante ha coadyuvado en las tareas de implementación de algún sistema de aseguramiento de la calidad, acompañando esta de copia certificada de la certificación obtenida."

e).- Finalmente, en el numeral 4.1, **PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA**, inciso h:

**Dice:**

"El licitante deberá presentar copia simple, legible y vigente del registro sanitario (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), del equipo debidamente identificado por el número de partida y propuesta."

**Debe decir:**

"El licitante deberá presentar copia simple, legible y vigente del registro sanitario (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), del equipo debidamente identificado."

5.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

6. - Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:


**LICITANTE: IMPROMED SA DE CV**




PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LOS ESCRITOS Y	LOS ESCRITOS Y ANEXOS DEBERAN DIRIGIRSE AL DR IGNACIO FEDERICO

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>ANEXOS PUEDEN SER DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  <b>SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>  <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</b>  <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>  <b>SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES</b></p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-008-18</p> <p>"PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE OS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"</p> <p>AT'N: DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ                  SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. COLIMA, COL.</p> <p>¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?</p>	<p>VILLASEÑOR RUIZ, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</p>
<p>2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA LICITACIÓN EN CARPETA DE 3 ARGOLLAS</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA.</p>
<p>3. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA FECHA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN BASES SE MENCIONA QUE EL SERVICIO SE LLEVARÁ A CABO A PARTIR DEL 02 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL SE LLEVARÁ A CABO EL 06 DE MARZO DEL 2018.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>LA VIGENCIA DE CONTRATOS SERÁ DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5 "FIRMA DEL CONTRATO", DE ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</p>
<p>4.-                  4.1 INCISO F) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTE TEXTO SE ANEXARA A NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA                  LOS PRECIOS OFERTADOS DEBERÁN SER FIJOS, SIN ESCALATORIA DURANTE LA VIGENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y</p>	<p>NO ES NECESARIO, YA QUE EN EL REQUISITO 1.7 VIGENCIA DE LA OFERTA SEÑALA QUE ESTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE PARTIR DEL 02 DE MARZO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
DURANTE LA VIGENCIA DE ACUERDO AL PUNTO 1.7 DE LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR	
1. ANEXO 2 ECONOMICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA FORMA DE PRESENTAR NUESTRAS PROPUESTA ES POR PARTIDA O POR PAQUETE FAVOR DE ACLARAR	POR PARTIDA ÚNICA.
6.- ANEXO 2 ECONOMICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR LAS CANTIDADES A COTIZAR	EL CETS PROCESA UN PROMEDIO DE 700 UNIDADES POR MES Y SUS PUESTOS DE SANGRADO EN TECOMAN Y MANZANILLO 100/MES CADA UNO. ADEMÁS, DE 15 A 20 PROCEDIMIENTOS DE AFERESIS Y DE 4 A 6 PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO.
7.-4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. REFERENTE A INCISO H.  SOLICITAN: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y VIGENTE DEL REGISTRO SANITARIO (ANVERSO Y REVERSO) EXPEDIDO POR LA COFEPRIS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEL EQUIPO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y PROPUESTA. NOS PUEDEN ACLARAR SI EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS O INSUMOS A NO SE ENCUENTRE VIGENTE NOS ACEPTE PRESENTARLO CON SU CORRESPONDIENTE TRAMITE DE PRÓRROGA. ¿SE ACEPTA?	SI.
8.- PREGUNTA 2. 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. REFERENTE A INCISO H.  REFERENTE AL REGISTRO SANITARIO VIGENTE QUE SOLICITAN. COMENTAMOS QUE EXISTEN VARIOS EQUIPOS O INSUMOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA EMITIDA POR LA SS EN DONDE SE ACLARA QUE NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO O BIEN, COPIA SIMPLE DE LAS HOJAS DEL DIARIO OFICIAL DONDE	SI.








SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.


P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
REFERENCIEMOS LOS EQUIPOS O INSUMOS. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>9.- PREGUNTA 1. PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TECNICO. NUMERAL 2.</b> SOLICITAN EQUIPOS NUEVOS DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. CON LA INTENSIÓN DE NO INCREMENTAR EL VALOR ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS DE VANGUARDIA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	<p><b>SI, SIEMPRE Y CUANDO NO PRESENTE FALLAS; EN CASO DE PRESENTAR MAS DE TRES FALLAS EN EL PRIMER MES DE USO, DEBERAN CAMBIARLO POR UNO NUEVO.</b></p>
<p><b>10.- PREGUNTA 2: EQUIPO NECESARIO PARA EL CETS Y SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO. PÁGINA 43.</b> SOLICITAN "SILLÓN DE DONACIÓN CON COMPARTIMENTOS PARA LA COLOCACIÓN DE LA BALANZA AGITADORA, TIJERAS, PINZAS Y TUBOS DE RECOLECCIÓN DE SANGRE. CON INTERRUPTOR PARA CAMBIOS DE POSICIONES. TAPICERÍA LAVABLE" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE OFERTE UN EQUIPO CON ALTA CALIDAD EN TAPICERÍA DE VINILO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIANO / ANTIMICROBIANO PATENTADO PARA EVITAR CRECIMIENTOS DE BACTERIAS Y MANCHAS. FÁCIL DE DESINFECTAR PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ACTIVADOR LINEAL A CADA LADO DE LA CABEZA DE LA SILLA DE DONANTES, CONTROLA EL MOTOR QUE PERMITE UN FÁCIL POSICIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO. PORQUE NO REUNIRIA LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE LOS COMPARTIMENTOS ADICIONALES PARA LA COLOCACION DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO.</b></p>
<p><b>11.- PREGUNTA 3: EQUIPO NECESARIO PARA EL CETS Y SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO. PÁGINA 43.</b> SOLICITAN "BALANZA AGITADORA PARA BOLSA DE SANGRE, ADAPTABLE A LOS SILLONES DE DONACIÓN. CON PANTALLA DIGITAL QUE INDIQUE LOS DATOS DE DONACIÓN, CON MEMORIA Y BATERÍA DURABLE."</p>	<p><b>NO SE ACEPTA.</b></p>







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA OFERTAR UN EQUIPO QUE PERMITA MANIPULAR EL TABLERO EVITANDO CURVARSE PARA ACCEDER AL EQUIPO. LA ANTENA ÓPTICA PERMITE UNA ALARMA VISUAL QUE SE NOTARA A DISTANCIA INDICANDO AL OPERADOR LA LOCALIZACIÓN CORRECTA DEL ASIENTO DEL ASIENTO DEL DONANTE.	
12.- PREGUNTA 4: EQUIPO NECESARIO PARA EL CETS Y SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO. PÁGINA 44. SOLICITAN "MESA MAYO PARA EL ÁREA DE SANGRADO". ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE SOLICITA "TIJERA MAYO PARA EL ÁREA DE SANGRADO?"	NO, LO QUE SE SOLICITA ES MESA MAYO PARA LA COLOCACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO.
13.- PREGUNTA 5: EQUIPO NECESARIO PARA EL CETS Y SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO. PÁGINA 44. PREGUNTA 5: SOLICITAN "CONGELADOR PARA BANCO DE SANGRE VERTICAL CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 14.- COMPONENTES SANGUÍNEOS CON TEMPERATURA DE -30 C". REGULADOR DIGITAL DE LA TEMPERATURA DEL MICROPROCESADOR CON MONITOR PRECONFIGURADO A -37° Y ALARMA INCORPORADA; ¿SE ACEPTA A MI REPRESENTADA OFERTAR CON CAPACIDAD PARA 140 LITROS QUE EQUIVALE A UN VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO SUPERIOR A 100 BOLSAS?	SI.
15.- 24.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONE LA PRODUCTIVIDAD DEL CETS, PUESTOS DE SANGRADO Y SERVICIOS DE TRANSFUSION, YA QUE ESA INFORMACION ES BASICA PARA PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA Y PODER DEFINIR SI EL EQUIPO SOLICITADO VA ACORDE A SUS PRODUCTIVIDADES	EL CETS PROCESA UN PROMEDIO DE 700 UNIDADES POR MES Y SUS PUESTOS DE SANGRADO EN TECOMAN Y MANZANILLO 100/MES CADA UNO.
16.- 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO J) SOLICITAN QUE EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE UN CONTRATO CELEBRADO DURANTE LOS ULTIMOS 2 AÑOS, CON ALGUNA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, U OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS CUYO OBJETO SEA LA PRESTACION DEL SERVICIO	FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 4.1 INCISO J).

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>OBJETO DE ESTA LICITACION.</b>                      PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS QUE ESTEN VIGENTES, SIN SER UNA LIMITANTE LO SOLICITADO EN BASES.                      LO QUE IMPORTA REALMENTE QUE ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTREN ACTUALMENTE VIGENTE.</p>	
<p><b>17.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA, PUNTO 2.</b>                      SOLICITAN QUE SE DEBERAN INSTALAR EQUIPOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, LOS QUE DEBERAN SER NUEVOS.                      PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 2 AÑOS, QUE SEAN DE TECNOLOGIA DE PUNTA Y QUE ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCINAMIENTO, ESTA PETICION SE HACE DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE INSTALACION SON DEMASIADO CORTOS Y SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS NUEVOS EN SU MAYORIA SON DE IMPORTACION, Y NO SE PODRA CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTIPULADO EN BASES, QUE ESTA PETICION NO SEA LIMITATIVA PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</p>	<p>MISMA RESPUESTA DEL PUNTO 9 PREGUNTA 1 PROPUESTA TECNICA ANEXO NUMERO 1 TECNICO. NUMERAL 2</p>
<p><b>18.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA, PUNTO 3.</b>                      REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CETS, SERVICIOS DE TRANSFUSION Y SUS PUESTOS DE SANGRADO PARA LOGRAR EL OPTIMO DESEMPEÑO.                      PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD NO INFORME EL NUMERO Y LOS NOMBRES DE LOS PUESTOS DE TRANSFUSION, TAMBIEN SUS PRODUCTIVIDADES Y POR ULTIMO EL EQUIPAMIENTO QUE SE DEBERA INSTALAR EN CADA UNO DE ESTOS.                      ESTA INFORMACION ES MUY IMPORTANTE PARA SABER CUALES SERAN LA ADECUACIONES A REALIZAR.</p>	<p>DEBERAN AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES EN EL APARTADO DE EQUIPAMIENTO POR AREAS.</p>
<p><b>19.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA, PUNTO 7.</b>                      HACER REPORTES DE REFERENCIA E INCIDENCIAS SEMANALMENTE.</p>	<p>EL FORMATO SE DEFINIRA EN EL MOMENTO REQUERIDO Y DEBERA INCLUIR FECHA Y HORA DE LA FALLA, NOMBRE DEL EQUIPO, MODELO FALLA PRESENTADA Y TIEMPO DE</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS FORMATOS PARA REPORTAR LAS INCIDENCIAS, YA QUE EN BASES NO SE INCLUYO</p>	<p>CORRECCION.</p>
<p>20.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA, PUNTO 17. MENCIONAN PRESENTAR UN PLAN DE CALIDAD PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO. PREGUNTA; SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTEHAGA DE NUESTRO CONOCIMIENTO A QUE SE REFIERE , NOS ENLISTE LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE ESTOS TENDRAN, YA QUE NOS SON CLAROS.</p>	<p>EL PLAN DE CALIDAD QUE SE SOLICITA ES PARA MINIMIZAR LAS FALLAS DE LOS EQUIPOS Y LA FALTA DE REACTIVOS QUE ACTUALMENTE SE PRESENTAN.</p>
<p>21.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA, PUNTO 18. MENCIONAN QUE SE DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE MEDICION, ANALISIS , MEJORA Y HACER DEL CONOCIMIENTO DEL CETS DE LOS RESULTADOS ASI COMO DE SUS AVANCES. PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS RESPETUOSA QUE ACLARE Y PRECISE A QUE SE REFIERE EN ESTE PUNTO, YA QUE ENTENDEMOS QUE COMO PRESTADORES DEL SERVICIO NOS CORRESPONDE PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE CADA UNA ESTAS Y CORRESPONDE AL PERSONAL DEL CETS MOSTRAR UN PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA QUE INCLUYA LAS ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS, YA QUE SON ELLOS QUIENES CUALES SON LOS PUNTOS A MEJORAR</p>	<p>LO QUE SE LE SOLICITA ES PARTE DE LO QUE COMO EMPRESA DEBEN DE CONTAR; UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PARA EVITAR ENTREGAR REACTIVOS CADUCADOS, MULTIPLES FALLAS EN LOS EQUIPOS, CON EL CONSIGUIENTE ATRASO EN LA DISPONIBILIDAD DE HEMOCOMPONENTES.</p>
<p>22.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA, PUNTO 19. MENCIONAN QUE SE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA DE CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME. PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS LAS CARACTERISTICAS QUE DEBERA TENER EL PROGRAMA Y SU ALCANCE, YA QUE SE ENTIENDE QUE SON OBLIGACIONES INTERNAS DE CETS.</p>	<p>LO QUE SE LE SOLICITA ES PARTE DE LO QUE COMO EMPRESA DEBEN DE CONTAR; UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PARA EVITAR ENTREGAR REACTIVOS CADUCADOS, MULTIPLES FALLAS EN LOS EQUIPOS, CON EL CONSIGUIENTE ATRASO EN LA DISPONIBILIDAD DE HEMOCOMPONENTES.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>23.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA, PUNTO 20 MENCIONAN QUE SE DEBERA MSOTRAR UN PROGARAM DE MEJORA CONTINUA QUE INCLUYA LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE ACUERDO A LAS SITUACIONES MAS COMUNES A RESOLVER. PREGUNTA; SOLICTAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE PUNTO YA QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION DE CUALES SON LAS SITUACIONES MAS COMUNES A RESOLVER, Y ADEMAS NO ESTA POR DEMAS MENCIONAR QUE LAS ACCIONES CORERCTIVAS Y PREVENTIVAS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL DEL CETS Y NO AL PROVEEDOR DEL SERVICIO, YA QUE NUESTRA FUNCION ES PROVEER DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.</p>	<p>EL CUESTIONAMIENTO SE REFIERE AL PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE SU SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD QUE COMO EMPRESA PROVEDORA DEBEN TENER Y PRESENTAR.</p>
<p>24.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS EN BASES ESTAN SOLCITANDO 2 EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA BANCO DE SANGRE, EN UNO PIDEN QUE SE HAGAN LAS PRUEBAS DE HCV,HBSAG Y HIV CON LA METODOLOGIA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA Y EN EL OTRO EQUIPO REALIZAR LAS PRUEBAS DE SIFILIS Y CHAGAS POR LA METODOLOGIA DE ELISA, YA QUE ADEMAS ESTEN AVALADOS PARA SU USO EN BANCO DE SANGRE. PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE REALICE LOS 5 MARCADORES AL MISMO TIEMPO , CON UNA VELOCIDAD DE 200 PRUEBAS POR HORA, PERMITIENDO REALIZAR PRUEBAS DE URGENCIAS, LO CUAL PERMITE LIBERAR CCOMPOENETES SANGUINEOS CON MAYOR RAPIDEZ, ESTO TRAE UN BENEFICIO PARA EL CETS Y LOS PACIENTES, CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINISCENCIA, ESTE EQUIPO ES OPERADO POR UN SOLO USUARIO, ADEMAS ESTA APROBADO PARA SU USO EN BANCO DE SANGRE. ESTA PETICION SE HACE CON LA FINALIDADE DE QUE CUENTEN CON UN SOLO EQUIPO Y NO DOS COMO LO SOLICITAN EN BASES,</p>	<p>SI.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>PERMITIENDO QUE SOLO UN QUIMICO SE DEDIQUE A OPERARLO, DE OTRA MANERA VAN A REQUERIR DE 2 PERSONAS PARA PODER LIBERAR LAS UNIDADES.</p> <p>EL CONTAR CON DOS EQUIPOS SE INCREMENTA DE MANERA MUY IMPORTANTE LOS ERRORES YA QUE SE DEBERA PRIMERO PROCESAR EN UN EQUIPO Y LUEGO EN EL OTRO YA QUE HAY UNA MAYOR MANIPULACION DE MUESTRAS, ESO INCREMENTARA LOS TIEMPOS DE LIBERACION DE LAS UNIDADES, CORRIENDO EL RIESGO DE NO PROVEER DE MANERA OPORTUNA A LOS HOSPITALES Y PONER EN RIESGO A LOS PACIENTES.</p>	
<p>25.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA CARACTERISTICAS SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DEL EQUIPO PARA LA REALIZACION DE LAS BIOMETRIAS HEMATICAS.</p> <p>LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO PARA EL CETS Y LOS PUESTOS DE SANGRADO CORRESPONDEN A UN MODELO Y MARCA DE EQUIPO EN ESPECIFICO, LO CUAL LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA.</p> <p>LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUIPO DE HEMATOLOGÍA QUE UTILIZA IMPEDANCIA MODIFICADA PARA HACER EL RECUENTO Y CLASIFICACIÓN DE CEULAS SANGUÍNEAS "FLUJO DIGITAL DE CORRIENTE DIRECTA" (DIGITAL FLOW DC).</li> <li>• QUE EMPLEE ÚNICAMENTE 2 REACTIVOS PARA SU OPERACIÓN, LISANTEW Y DILUYENTE.</li> <li>• VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE SOLO 9 MICROLITROS.</li> <li>• 21 PARAMETROS REPORTABLES.</li> <li>• REPORTE ÚNICO DE PARÁMETROS COMO "P-LCC" (PLAQUETAS GIGANTES) Y P-LCR (RADIO PLAQUETAS).</li> <li>• SOFTWARE LINUX.</li> <li>• PANTALLA TOUCH-SCREEN.</li> <li>• CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO PARA 500 MIL RESULTADOS</li> </ul>	<p>SI.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>DE PACIENTES.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 70 PRUEBAS POR HORA.</li> <li>• MODOS DE PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS, MODO SANGRE COMPLETA, MODO PREDILUCION Y MODO CAPILAR.</li> <li>• CUENTE CON INTERFASE PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO.</li> <li>• MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL.</li> <li>• UNIDAD UPS O NO BREAK INTEGRADO O ADICIONAL CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 15 MINUTOS DE CARGA PARA RESPALDO.</li> <li>• CONTROL DE CALIDAD INTERNO CON TRES NIVELES.</li> <li>• SE INCLUIRÁ AGITADOR PARA TUBO (12 PZAS.</li> </ul> <p>ESTAS CARACTERISTICAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO PARA LABORATORIO CLINICO, YA QUE LOS PARAMETROS SOLICITADOS POR LA NOM-253-SSA1-2012 SON MENOS.</p> <p>PREGUNTA;SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS SOLCITADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INTERFAZABLES</li> <li>- VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 60 MUESTRAS POR HORA.</li> <li>- Y OTRAS QUE CCHARACTERISTICAS SIMILARES A LO SOLICITADO.</li> </ul> <p>ADEMAS CUMPLIENDO CABALMENTE CON LOS SOLICITADO POR NOM-253, SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</p>	
<p>26.- PUNTO 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA NO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS INCISOS H), I) Y K), SON PARA LOS EQUIPOS Y SUS REACTIVOS QUE CUENTAN CON CEDULA TECNICA Y LA BOLSA PARA DONACION DE SANGRE.</p> <p>PREGUNTA; DEL RESTO DEL EQUIPAMIENTO ADICIONAL QUE SE MENCIONA EN BASES,</p>	


SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

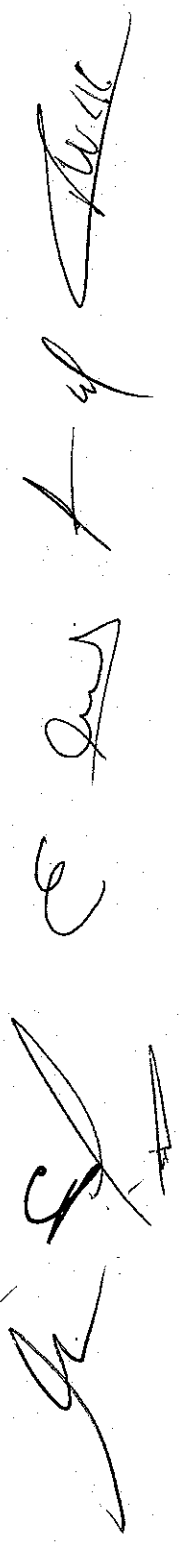
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>SOLO SE DEBERA PRESENTAR EL FOLLETO Y UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE SER ASIGANDO INSTALARIAMOS EL EQUIPO SOLICITADO, YA QUE NO SE CUENTA CON CEDULAS TECNICAS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?, FAVOR DE CONFIRMAR.</p>	
<p>27.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS A PROPORCIONAR LAS CUALES DEBERAN SER IGUALES O SUPERIORES A LOS DESCRITOS. MENCIONAN QUE LAS PRUEBAS HIV, HCV Y HBSAG DEBERAN SER POR ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA Y LAS DE SIFILIS Y CHAGAS POR EL METODO INMUNOENZIMATICO. PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS 5 PRUEBAS POR QUIMIOLUMINISCENCIA Y QUE EL PANEL COMPLETO SE REALICE EN UN SOLO EQUIPO. ESTA PETICION SE HACE CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR REALIZANDO LAS 5 PRUEBAS EN UN SOLO EQUIPO Y NO RETROCEDER AL PEDIR 2 EQUIPOS OPARA REALIZAR LAS 5 PRUEBAS.</p>	<p>SI SE ACEPTA; Y NO SE TRATA DE RETROCEDER, SE TRATA DE PRESENTAR UN EQUIPO CON EL MINIMO NUMERO DE FALLAS QUE EL QUE ACTUALMENTE PRESENTA.</p>
<p>28.- ANEXO NUMERO 1, PROUESTA TECNICA CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PARA LA REALIZACION DE AFERESIS. PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONES EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DE OBTENCION DE PLAQUETAS DE REACAMBIO PALSMATICOS A REALIZARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, YA QUE EN BASES NO VIENE ESTA INFORMACION Y ES VITAL PARA NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.</p>	<p>DE 15 A 20 PROCEDIMIENTOS DE AFERESIS Y DE 4 A 6 PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMATICO.</p>
<p>29.- 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA INCISO I) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA COPIA LEGIBLE DE LOS CERTIFICADOS ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:2015 DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO, COPIA LEGIBLE DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA, CE, CLV, TUV DE LOS EQUIPOS OFERTADOS PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SOLO SE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES</p>	<p>DEBERA PRESENTAR INDISTINTAMENTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: ISO 9001:2008, Y/O ISO 9001:2015 Y/O ISO 13485; FDA, CE, CLV, TUV, DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SEGÚN SEA EL CASO QUE LO REQUIERA.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>CERTIFICADOS DE FDA, CE, CLV O TUV. ESTRA PETICION LA HACEMOS FUNDAMENTADA EN LO SIGUIENTE; SE ENTIENDE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA O USFDA CON SUS SIGLAS EN INGLÉS) ES UNA AGENCIA FEDERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS; UNO DE LOS DEPARTAMENTOS EJECUTIVOS FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS. LA FDA ES RESPONSABLE DE PROTEGER Y PROMOVER LA SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, PRODUCTOS DE TABACO, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS, MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS RECETADOS Y DE VENTA LIBRE, VACUNAS, PRODUCTOS BIOFARMACÉUTICOS, TRANSFUSIONES DE SANGRE, DISPOSITIVOS MÉDICOS, EQUIPOS, PRUEBAS PARA DIAGNOSTICO, RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (ERED), COSMÉTICOS, ALIMENTOS ANIMALES Y PRODUCTOS VETERINARIOS.</p> <p>PARA EL CASO DEL CERTIFICADO CE APORTA VENTAJAS TANTO A LOS FABRICANTES COMO A LOS CONSUMIDORES: POR UN LADO, LOS <b>FABRICANTES</b> SE BENEFICIAN DE QUE, OBTENIENDO DICHO CERTIFICADO, PUEDEN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN TODOS LOS PAÍSES DE LA UE. DEL MISMO MODO, PARA OBTENER EL CERTIFICADO SE FIJAN UNOS REQUISITOS ESTANDARIZADOS Y APLICABLES A LOS FABRICANTES DE TODOS LOS PAÍSES SIN DISTINCIÓN, POR LO QUE SE ASEGURA LA IGUALDAD DE TRATO Y SE EVITA QUE HAYA DISCRIMINACIÓN. POR OTRO LADO, PARA LOS <b>CONSUMIDORES</b> APORTA UNA LA VENTAJA CLARA: EL PODER CONFIAR EN LOS PRODUCTOS QUE ADQUIEREN EN EL CERTIFICADO, YA QUE TENER DICHO MARCADO IMPLICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES, ENTRE ELLOS LOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE USO DE ESTOS PRODUCTOS.</p> <p>POR ULTIMO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA NOM ISO 9001 PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE A PROCESOS AL DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y MEJORAR LA</p>	<div style="text-align: center;">  </div>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>EFICACIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, PARA AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE. EN EL APARTADO 4.4 SE INCLUYEN REQUISITOS ESPECÍFICOS CONSIDERADOS ESENCIALES PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE A PROCESOS.</p> <p>LA NORMA ISO INTERNACIONAL ESPECIFICA LOS REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CUANDO UNA ORGANIZACIÓN:</p> <p>A) NECESITA DEMOSTRAR SU CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR REGULARMENTE SERVICIOS QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y LOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES, Y</p> <p>B) ASPIRA A AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN EFICAZ DEL SISTEMA, INCLUIDOS LOS PROCESOS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y LOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES.</p> <p>TODOS LOS REQUISITOS DE ESTA NORMA ISO 9001 SON GENÉRICOS Y SE PRETENDE QUE SEAN APLICABLES A TODAS LAS ORGANIZACIONES, SIN IMPORTAR SU TIPO, TAMAÑO Y EL PRODUCTO SUMINISTRADO.</p>	<p>A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</p>
<p>30.- 3.19 ISO 9001:2015 DEL LICITANTE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:2015 DEL LICITANTE, CUYO ALCANCE SEA "VENTA, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y</p>	<p>A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</p>

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signatures and marks]*

16



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE, OFRECIENDO SERVICIOS INTEGRALES.”, VIGENTE Y EXPEDIDO POR UN ORGANISMO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C</b></p> <p>PREGUNTA; DE ACUERDO AL OBJETO DE ESTA LICITACION QUE ES LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CETS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SU ALCANCE ES EL SERVICIO INTEGRAL PARA BANCO DE SANGRE, ESTA PETICION SE HACE EN BASE A LOS SIGUIENTE:</p> <p>EL ALCANCE DEL SGC DEBE BASARSE EN LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN, SUS PROCESOS OPERATIVOS, LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS REQUISITOS RELEVANTES DE LAS PARTES INTERESADAS, EL RESULTADO DE UN PENSAMIENTO BASADO EN EL RIESGO, LAS CONSIDERACIONES COMERCIALES Y LOS REQUISITOS CONTRACTUALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.</p> <p>POR LO QUE EL ALCANCE DE NUESTRO SGC ES SUFICIENTE MENTE CLARO YA QUE IDENTIFICA LO QUE HACE NUESTRA EMPRESA, PROPORCIONAR SERVICIOS INTEGRALES.</p> <p>CONSIDERANDO ESTO ULTIMO NUESTRA EMPRESA EL SGC SON LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA BANCO DE SANGRE, YA QUE NUESTRO SERVICIO INCLUYE LAS TRES FASES DEL PROCESO, QUE SON EL PROPORCIONAR TODO LO QUE SE REQUIERE PARA LA OBTENCION, PROCESAMIENTO, ALMACENAJE Y TRASLADO DE LOS COMOPENTES SANGUIEO Y SON LA FASES PRE-ANALITICO, LA FASE ANALITICO Y LA FASE POST ANALITICO.</p>	<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">      </div>

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>31.- 2.9 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE.                  ENTENDEMOS QUE NO ES OBLIGATORIO</p>	<p>SI ES CORRECTA SU APRECIACION.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EMPRESA CLIMENSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	
41.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER COMPLEMENTAR LOS ANEXOS 5,6,7 Y 10 DE ACUERDO A LOS TEXTOS DE LA CONVOCATORIA DEL PUNTO 3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS ANEXOS 5,6,7 Y 10 DE CONFORMIDAD A LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, NO SE ACEPTAN OPCIONES.
32.- 3.10 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. ENTENDEMOS QUE PRESENTAR ESTE CERTIFICADO ES OPCIONAL Y NO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTE LICITACION. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION.
33.- 3.11 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA.
34.- 3.12 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS ACLARE, SI LA LICENCIA DE GIRO, SE REFIERE AL AVISO DE FUNCIONAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.	SI, DEBERA PRESENTAR SU AVISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE.
35.- 3.17 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL ANEXO 12 PARA PROPUESTAS CONJUNTAS CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
36.- 3.18 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR EL TEXTO CORRECTO DEL ANEXO 13 DE LAS PRESENTES BASES.	A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
37.- 3.20 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO SE DEBE DE ANEXAR EL FORMATO EN BLANCO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS DEBIDAMENTE FIRMADO COMO PARTE INTEGRANTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA.
38.- 3.21 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACALRE SI PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS INTEGRAR EL ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO Y RUBRICADO O	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EL FORMATO DE MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE

A y F  
 J  
 C  
 A

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
SOLO ES DE CONOCIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.	FIRMADO COMO PARTE INTEGRANTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA.
39.- 4.1 INCISO J) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS SON A 2 AÑOS CONCLUIDOS O SUPERIORES A 2 AÑOS.	LOS CONTRATOS PUEDEN CORRESPONDER AL AÑO 2016 O AL AÑO 2017 INDEPENDIEMENTE DE QUE ESTÉ VIGENTES O NO Y/O QUE SE HAYAN CELEBRADO EN AÑOS ANTERIORES Y QUE SE ENCUENTREN VIGENTES EN EL AÑO 2016 O 2017.
40.- 5. FIRMA DEL CONTRATO (ANEXO 14) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL NUMERO DEL ANEXO ES EL 15. ¿FAVOR DE ACLARAR?	A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
41.- ANEXO 9 (PUNTO 3.14) ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE DEBEMOS PONER EN EL APARTADO EN BLANCO? EL QUE SUSCRIBE <b>EDUARDO AVALOS</b> , REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA <b>IMPROMED, S.A. DE C.V.</b> , EN ATENCIÓN AL PUNTO 3.14 DE LAS PRESENTES BASES MANIFIESTO <b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD</b> QUE (SI O NO) TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO) EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-008-18 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.	EL LICITANTE DEBERÁ PONER EN EL APARTADO EN BLANCO LAS RAZONES O JUSTIFICACIONES PARA SUBCONTRATAR O NO.

**LICITANTE DISTRIBUIDORA LHAG, S.A. DE C.V.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 1</b> <b>REF. : 3 Y 4</b> <b>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ESCRITOS EN FORMATO LIBRE QUE FORMEN</b>	<b>ES CORRECTO, LOS ESCRITOS Y ANEXOS DEBERAN DIRIGIRSE AL DR IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>PARTE DE NUESTRA PROPUESTA DEBEN IR DIRIGIDOS A:  <b>DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ</b>  <b>SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>  <b>Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.</b></p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 2</b>  <b>REF: 3</b>  <b>PREGUNTA:</b> EN CASO DE QUE ALGUN PUNTO NO NOS APLIQUE, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA INCLUIR ESCRITO DE NO APLICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN "REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN, DEBERA PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS SOLICITADOS, Y EN CASO DE QUE ALGUNO NO LE APLIQUE, DEBERÁ PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON LA LEYENDA "NO APLICA".</p>
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 3</b>  <b>REF: 1.10 IDIOMA</b>  <b>PREGUNTA:</b> PARA EL CASO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES QUE VENGAN EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE DE ÚNICAMENTE LO REFERENCIADO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA.</p>
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 4</b>  <b>REF: 3.12</b>  <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CABALMENTE EN ESTE NUMERAL NOS PERMITA PRESENTAR DE MANERA INDISTINTA LA LICENCIA DE GIRO Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE A 2017 A NOMBRE DEL LICITANTE ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO 3.12 DE LAS BASES (LICENCIA DE GIRO EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE) DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA DE GIRO VIGENTE A 2017 A NOMBRE DEL LICITANTE, EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, LA CUAL DEBERA CORRESPONDER AL DOMICILIO DEL LOCAL EN ELQUE FUNCIONA U OPERA LA EMPRESA.</p>
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 5</b>  <b>REF:3.20 FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS</b>  <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS ANEXO 14 UNICAMENTE SE UTILIZARA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIO IR DENTRO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTA NUESTRA</p>	<p>PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO 3.20, "FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS", DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 14 DE ESTAS BASES, DEBIDAMENTE FIRMADO.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR</p>	
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 6</b>  <b>REF: 3.21 MODELO DE CONTRATO (ANEXO 15)</b>  <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MODELO DEL CONTRATO ANEXO 15 ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO DEBE INCLUIRSE DENTRO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO 3.21, "MODELO DE CONTRATO", DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 15 DE ESTAS BASES, DEBIDAMENTE FIRMADO.</p>
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 7</b>  <b>REF: 5.2 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS</b>  <b>PREGUNTA:</b> ENTENDEMOS QUE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS MENCIONADA EN EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTO LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN</p>
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 8</b>  <b>REF: 5.2 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS</b>  <b>PREGUNTA:</b> EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LA POLIZA DE FIANZA DEBERÁ SER DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>LA GARANTIA DEL BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEÑALADA EN EL REQUISITO 5.1 ES OBLIGATORIA PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN</p>
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 9</b>  <b>REF: 3.18 CARTA COMPROMISO (ANEXO 13)</b>  <b>PREGUNTA:</b> EN ESTE NUMERAL SOLICITAN CARTA GARANTIA DE LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE CALIDAD Y DE FABRICACIÓN, HACIENDO REFERENCIA AL ANEXO 13, Y REVISANDO EL ANEXO 13, ES UNA CARTA GARANTÍA A PAGAR CUALQUIER IMPORTE DERIVADO DE LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL QUE INTEGREN EL GRUPO DE TRABAJO.</p> <p>POR LO ANTERIOR MENCIONADO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL SE DEBERA PRESENTAR EL ANEXO 13 Y EN FORMATO</p>	<p>A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.







<p>LIBRE LA CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE CALIDAD Y DE FABRICACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 3.18</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	
<p><b>PREGUNTA ADMINISTRATIVA NO. 10</b>  <b>REF: 3.11 ACREDITACION DE SOLVENCIA ECONOMICA</b>  <b>PREGUNTA:</b> PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAN LA DECLARACIÓN ANUAL 2017, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE ANTE EL SAT SE TIENE COMO FECHA LIMITE PRESENTAR DICHA DECLARACION ANUAL HASTA EL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL 2016,          ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PARA DAR CUMPLIENTO AL REQUISITO 3.11 DE LA CONVOCATORIA "ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA", LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA DECLARACIÓN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ASI MISMO DEBERÁ PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES DEL AÑO 2017.</p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.11</b>  <b>REF.: ANEXO NUMERO 1 TECNICO, (O)</b>  <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS</b>  <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE PODER REFERENCIAR E IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS NOS PERMITA ENUMERAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA.</p>


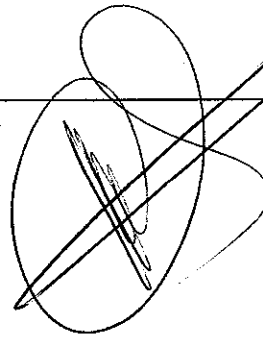

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.1</b>  <b>REF.: 4.1 INCISO H)</b>  <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA EL CASO DE AQUELLOS BIENES QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO , OFICIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS INDICANDO QUE NO REQUIEREN O EN SU CASO DOF EN DONDE SE ENLISTAN LOS BIENES QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.2</b>  <b>REF.: 4.1 INCISO I) , ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:2015 DE LOS EQUIPOS</b></p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL CASO ESPECIFICO DEL ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:2015 DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER PRESENTAR INDISTINTAMENTE ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:20115 Y/O ISO 13485, YA QUE ESTE ULTIMO AVALA LA GESTION DE CALIDAD PARA LOS FABRICANTES DE EQUIPOS MEDICOS ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>DEBERA PRESENTAR INDISTINTAMENTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: ISO 9001:2008, Y/O ISO 9001:2015 Y/O ISO 13485; FDA, CE, CLV, TUV, DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SEGÚN SEA EL CASO QUE LO REQUIERA.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.3</b>  <b>REF.: 4.1 INCISOS H) REGISTRO SANITARIO, I) CERTIFICADOS ISOS 9001 Y/O 13485, CE, FDA, CLV, TUV.</b></p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS ASI COMO LOS CERTIFICADOS ISOS 9001 Y/O 13485, CE, FDA, CLV, TUV POR FAMILIA E IDENTIFICÁNDOLOS PARA EL EQUIPOS/BIEN QUE APLIQUE ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>FAVOR DE REMITIRSE A LA PREGUNTA 4.1 INCISO h)</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.4</b>  <b>REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, EQUIPAMIENTO MÉDICO LINEAMIENTOS GENERALES, SEGUNDO PARRAFO</b></p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CARACTERISTICAS Y CANTIDADES QUE SE REQUIEREN PARA LOS BAUMANOMETRO, BÁSCULA, TERMÓMETRO DIGITAL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN</p>	<p><b>SE REQUIEREN 5 DE CADA UNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAUMANOMETRO TIPO ANAEROIDE; BASCULA CON ESTADIMETRO;TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDIR TEMPERATURA CORPORAL; Y LAS LAMPARAS DE EXPLORACION, QUE SEAN DE MANO (TIPO PLUMA), DE PREFERENCIA CON LUZ TIPO LED.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.5</b>  <b>REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, EQUIPAMIENTO MÉDICO LINEAMIENTOS GENERALES, SEGUNDO PARRAFO</b></p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE CAPACIDAD Y SENSIBILIDAD NECESITAN LA BÁSCULA SOLICITADA?</p>	<p><b>BASCULA CON ESTADIMETRO.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.6</b>  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, EQUIPAMIENTO MÉDICO LINEAMIENTOS GENERALES, SEGUNDO PARRAFO</p> <p><b>PREGUNTA:</b> EN EL CASO DE EL TERMOMETRO DIGITAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL RANGO DE TEMPERATURA Y SI LO REQUIEREN CON SONDA.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p><b>SE REQUIERE UN TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL DE LOS DONADORES.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.7</b>  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGÍA PARA LOS MARCADORES DE HCV, HIV, HBsAg  PIPETAS AUTOMATIZADAS DE 10 a 100 ul. Y DE 100 A 1,000 ul</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGÍA PARA LOS MARCADORES DE HCV, HIV, HBsAg, SOLICITAN PIPETAS, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CANTIDADES QUE REQUIEREN DE ESTAS PIPETAS</p>	<p><b>SE REQUIEREN DOS DE CADA UNA.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.8</b>  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS EQUIPO ANALIZADOR DE MICROPLACAS TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA LOS MARCADORES DE SIFILIS Y CHAGAS.  PIPETAS AUTOMATIZADAS DE 10 a 100 ul. Y DE 100 A 1,000 ul</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL ANALIZADOR DE MICROPLACAS TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA LOS MARCADORES DE SIFILIS Y CHAGAS, SOLICITAN PIPETAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CANTIDADES QUE REQUIEREN DE ESTAS PIPETAS</p>	<p><b>SE REQUIEREN DOS DE CADA UNA.</b></p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.9</b> REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS A PROPORCIONAR EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS PRUEBA DE AGLUTINACIÓN CON ANTÍGENO ROSA DE BENGALA I.D</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS PRUEBA DE AGLUTINACIÓN CON ANTÍGENO ROSA DE BENGALA I.D, SOLICITAN EL SIGUIENTE EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pipeta automatizada de 5 a 50 ul.</li><li>• Pipeta automatizada de 10 a 100 ul.</li><li>• Lámpara de luz blanca</li></ul> <p>POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CANTIDADES QUE REQUIEREN Y CARACTERISTICAS DE LA LAMPARA,</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p><b>SE REQUIEREN DOS PIPETAS AUTOMATIZADAS DE CADA UNA DE LAS CAPACIDADES INDICADAS Y UNA LAMPARA DE LUZ BLANCA CON PANTALLA DIFUSORA EN METACRILATO, DE 15 A 20 WATTS; Y CON MEDIDAS DE 32 cm DE LARGO, 15 cm DE ANCHO Y 10 cm DE ALTO.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.10</b> ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS A PROPORCIONAR EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS PRUEBA DE AGLUTINACIÓN CON ANTÍGENO ROSA DE BENGALA I.D</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS PRUEBA DE AGLUTINACIÓN CON ANTÍGENO ROSA DE BENGALA I.D, SOLICITAN EL SIGUIENTE EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotator de placa (Agitador para muestras en placa)</li></ul> <p>POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LO REQUIEREN CON ANGULO RECIPROCO U ORBITAL ASI COMO CANTIDADES A REQUERIR?</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p><b>SE REQUIERE UN AGITADOR CON ROTOR DE PLACA CON VELOCIDAD DE ROTACION DE 20 A 300 rpm, ORBITA DE ROTACION DE 20mm, CON RELOJ CON TIEMPO VARIABLE GRADUADO EN MINUTOS, DE 0 A 30 min.</b></p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.11</b>                  ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS A PROPORCIONAR SISTEMA POR MÉTODO INMUNOENZIMÁTICO PARA LA DETECCIÓN EN SUERO Y PLASMA DE SÍFILIS.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> EN ESTE APARTADO SOLICITAN MICROPIPETAS CALIBRADAS CON SU CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, RAZON POR LA CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE QUE CAPACIDAD REQUIEREN LAS MICROPIPETAS ASI COMO CANTIDAD</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>UNA PIPETA AUTOMATIZADA DE 10 a 100ul Y UNA DE 100 A 1000 ul.</p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.12</b>                  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACION DE LAS BIOMETRIAS HEMATICAS</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL EQUIPO PARA REALIZACION DE LAS BIOMETRIAS HEMATICAS, SOLICITAN AGITADOR PARA TUBO (12 PZAS.), POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LO REQUIEREN ROTATIVO O ROLLER ASI COMO CANTIDAD?</p>	<p>TIPO MEZCLADOR OSCILATORIO; Y SE REQUIERE UNO PARA EL CETS Y UNO PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS DE SANGRADO.</p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.13</b>                  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACION DE LAS BIOMETRIAS HEMATICAS</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL EQUIPO PARA REALIZACION DE LAS BIOMETRIAS HEMATICAS, SOLICITAN EL SIGUIENTE EQUIPO ADICIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pipetas automatizadas de 10 a 100 ul. Y de 100 a 1,000 ul.</li> <li>• Dosificador de 1 a 10 mL.</li> <li>• Baño María.de acero inoxidable con un rango de temperatura de 5 a 100 °C, con una uniformidad de la temperatura de 0.1 °C.</li> <li>• Tres Centrifugas clínicas de velocidad dual de 2,400 a 3,500 rpm, con rotor para 12 tubos de 75 x 13 mm.</li> </ul>	<p>DOS DE CADA UNA DE LAS PIPETAS PARA EL CETS Y UNA DE CADA UNA PARA LOS PUESTOS DE SANGRADO                  UN DOSIFICADOR PARA EL CETS Y UNO PARA CADA PUESTO DE SANGRADO.                  UN BAÑO MARÍA PARA EL CETS Y UNO PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS DE SANGRADO.                  UNA CENTRIFUGA PARA EL CETS Y UNA PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS DE SANGRADO.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CANTIDADES QUE REQUIEREN,</p>	
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.14</b>                  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACION DE LAS BIOMETRIAS HEMATICAS</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL EQUIPO PARA REALIZACION DE LAS BIOMETRIAS HEMATICAS, SOLICITAN EL SIGUIENTE EQUIPO ADICIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baño María.de acero inoxidable con un rango de temperatura de 5 a 100 °C, con una uniformidad de la temperatura de 0.1 °C.</li> </ul> <p>POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CANTIDADES A REQUERIR,</p>	<p><b>UNO PARA EL CETS Y UNO PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS DE SANGRADO.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.15</b>                  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PARA REALIZACION DE AFERESIS</p> <p><b>PREGUNTA:</b> EN EL EQUIPO PARA REALIZACION DE AFERESIS., SOLICITAN EL SIGUIENTE EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pipetas de 100 a 1,000 ul.</li> </ul> <p>POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CANTIDADES QUE REQUIEREN</p>	<p><b>UNO PARA EL CETS.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.16</b>                  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, EQUIPO NECESARIO PARA EL CETS Y SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO EQUIPO DETECTOR DE HEMOLISIS</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON QUE CARACTERISTICAS REQUIERE EL EQUIPO DETECTOR DE HEMOLISIS,</p>	<p><b>EQUIPO PARA LA DETERMINACION DE LA HEMOGLOBINA (METODO DE CIANURO DE HEMOGLOBINA (HiCN)), CON PRINCIPIO DE MEDICION DE VANZZETI (AZIDA METAHEMOGLOBINA MODIFICADA), CON RANGO DE MEDICION DE 0.03 a3.0 G/DL. CON LECTURA DE 2 LONGITUDES DE ONDA 570-880nm.QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO 13485.</b></p>

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

[Handwritten mark or signature at the bottom left corner.]

[Handwritten signature at the bottom center.]

[Handwritten signature at the bottom right.]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

FAVOR DE CLARAR	
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.17.</b>                  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, EQUIPO NECESARIO PARA EL CETS Y SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO REFRIGERADOR PARA CONSERVACIÓN DE SANGRE</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON QUE VOLUMEN SE REQUIERE EL REFRIGERADOR PARA CONSERVACIÓN DE SANGRE</p> <p>FAVOR DE CLARAR</p>	<p><b>REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE CON CAPACIDAD DE 528 lb Y/O 240 kg.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.18</b>                  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, EQUIPO NECESARIO PARA EL CETS Y SUS DOS PUESTOS DE SANGRADO CONGELADOR PARA BANCO DE SANGRE VERTICAL CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 100 COMPONENTES SANGUÍNEOS CON TEMPERATURA DE -30 °C.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON QUE VOLUMEN SE REQUIERE EL CONGELADOR PARA BANCO DE SANGRE SOLICITADO</p> <p>FAVOR DE CLARAR</p>	<p><b>DE 23 A 25 pies cúbicos DE CAPACIDAD.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO. 19</b>                  REF.: 4.1 ANEXO NUMERO 2 ECONOMICO</p> <p><b>PREGUNTA:</b> PARA EL CASO DE LA PROPUESTA ECONOMICA EN EL NUMERAL 4.1 DE LAS PRESENTES BASES NOS ESTAN HACIENDO MENCIÓN AL ANEXO NUMERO 2 ECONOMICO, SIN EMBARGO AL IR AL ANEXO ECONOMICO, VIENE EL ANEXO 2 Y 2-A, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DE DEBERÁ INCLUIR SOLO EL ANEXO 2 O AMBOS (ANEXO 2 Y 2-A), FAVOR DE ACLARAR</p>	<p><b>SE DEBERÁ PRESENTAR AMBOS , ANEXO 2 Y 2-A.</b></p>

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

[Large handwritten signature or mark at the bottom center of the page.]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO.20</b> <b>REF.: 4.1 ANEXO NUMERO 2 ECONOMICO</b></p> <p><b>PREGUNTA:</b> EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN NO MENCIONAN EL VOLUMEN DE PRUEBAS REQUISITADAS PARA EL SERVICIO, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE PODER PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE LAS CANTIDADES QUE SE REQUIEREN OFERTAR</p>	<p><b>EL CETS PROCESA UN PROMEDIO DE 700 UNIDADES POR MES Y SUS PUESTOS DE SANGRADO EN TECOMAN Y MANZANILLO, 100/MES CADA UNO.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO. 21</b> <b>REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGÍA PARA LOS MARCADORES DE HCV, HIV, HBsAg</b></p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS EN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES, DONDE SOLICITAN VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO MÍNIMO 170 PRUEBAS POR HORA, SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE PROCESA 90 PRUEBAS POR HORA. SE ACEPTA?</p>	<p><b>SI SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO. 22</b> <b>REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGÍA PARA LOS MARCADORES DE HCV, HIV, HBsAg</b></p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS EN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES, DONDE SOLICITAN EQUIPO CON DISCO DE INCUBACIÓN PARA 54 POSICIONES,</p>	<p><b>SI SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON 32 POSICIONES PARA CUBETAS DE ENSAYO. SE ACEPTA?</p>	
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO. 23</b>  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGÍA PARA LOS MARCADORES DE HCV, HIV, HBsAg</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS EN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES, DONDE SOLICITAN DISCOS DE REACTIVOS QUE CONTIENE 25 POSICIONES PARA PACKS DE REACTIVOS., SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON 18 POSICIONES DE REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SI SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO. 24</b>  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE SEROLOGÍA PARA LOS MARCADORES DE HCV, HIV, HBsAg</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS EN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES, DONDE SOLICITAN VOLUMEN DE PIPETEO DE REACTIVO DE 40 A 64 UL POR TEST, SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO QUE TRABAJE CON VOLUMEN DE PIPETEO DE 10 A 50 UL ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>SI SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b></p>
<p><b>PREGUNTA TÉCNICA NO. 25</b>  REF.: ANEXO NÚMERO 1 TECNICO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONEN LA CANTIDAD DE PRUEBAS A REALIZARSE PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN B.S.</p>	<p><b>EL CETS PROCESA UN PROMEDIO DE 700 UNIDADES POR MES Y SUS PUESTOS DE SANGRADO EN TECOMAN Y MANZANILLO, 100/MES CADA UNO.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

LICITANTE: DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Numeral 1.7 VIGENCIA DE LA OFERTA. Este numeral especifica que la vigencia de la oferta será a partir del 02 DE MARZO y hasta el hasta el 31 diciembre del 2018.</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante aclare cuál será la fecha correcta de la prestación del servicio ya que la fecha de fallo (06 marzo 2018) se establece posterior al inicio de la prestación de los servicios.</p> <p>Favor de aclarar la fecha correcta.</p>	<p>LA VIGENCIA DE CONTRATOS SERÁ DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5 "FIRMA DEL CONTRATO", DE ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</p>
<p>Numeral 3.19 solicita que Los licitantes Los licitantes deberán presentar dentro de su propuesta original para cotejo y copia certificada del certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 y/o ISO 9001:2015 del licitante, cuyo alcance sea "venta, distribución, instalación, operación y mantenimiento de equipos de banco de sangre, ofreciendo servicios integrales.", vigente y expedido por un organismo certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente eliminar el texto "expedido por un organismo certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C." ya que esta entidad no expide certificados de este tipo.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p><b>A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</b></p>
<p>5. FIRMA DEL CONTRATO. Establece que el presente contrato abarcara UN EJERCICIO FISCAL. (DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018).</p> <p>Pregunta: favor de aclarar la fecha de inicio de la prestación del servicio ya que en otros apartados menciona como inicio de la prestación del servicio el 02 de marzo.</p>	<p>EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO SERÁ DE CONFORMIDAD CON LA VIGENCIA DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE MARZO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5 "FIRMA DEL CONTRATO", DE ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

Favor de aclarar.	
-------------------	--

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Anexo 1, punto 2.- Proporcionar e instalar los equipos necesarios para la prestación del servicio, los que deberán ser NUEVOS, de tecnología de vanguardia; y por ningún motivo bienes correspondientes a saldos o remanentes, descontinuados o que no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.</p> <p>Pregunta: se permite ofertar equipos usados en buenas condiciones de uso.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p><b>SI, SIEMPRE Y CUANDO NO PRESENTE FALLAS; EN CASO DE PRESENTAR MAS DE TRES FALLAS EN EL PRIMER MES DE USO, DEBERAN CAMBIARLO POR UNO NUEVO.</b></p>
<p>Anexo 1, punto 15- Que la Empresa cuente con un sistema de gestión de la calidad establecido (ISO 9001:2015, vigente y expedido por un organismo certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C).</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente eliminar el texto "expedido por un organismo certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C." ya que esta entidad no expide certificados de este tipo.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p><b>A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</b></p>
<p>Anexo 1, analizador automatizado para pruebas de serología.</p> <p>Equipo completamente automatizado que cuente con las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema automatizado de piso.</li> <li>2. Con capacidad de recibir alimentación de muestras en acceso continuo o en lote.</li> <li>3. Con capacidad de recibir hasta 120 muestras en una sola carga.</li> <li>4. Con capacidad de recibir contenedores para muestras de 6 mm y hasta 15 mm de diámetro y hasta 100 mm de alto.</li> <li>5. Con software en idioma español.</li> <li>6. Sistema operativo basado en ambiente Windows.</li> <li>7. Que cuente con un principio de medición por</li> </ol>	<p><b>SI. SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b></p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.









- quimioluminiscencia.
8. Con la capacidad de refrigeración abordo para 29 posiciones de reactivos.
  9. Identificación de reactivos a través de radiofrecuencia.
  10. Con la capacidad de realizar una sola plataforma analítica la determinación para la identificación de la presencia del Antígeno de superficie de la Hepatitis B, la presencia del antígeno p24 y anticuerpos contra HIV, presencia de anticuerpos contra HCV, presencia de anticuerpos contra Trypanosoma Cruzi y presencia de anticuerpos contra Treponema Pallidum.
  11. Que cuente con validación por parte del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para las 5 determinaciones analíticas (Antígeno de superficie de la Hepatitis B, antígeno p24 y anticuerpos contra HIV, anticuerpos contra HCV, anticuerpos contra Trypanosoma Cruzi y anticuerpos contra Treponema Pallidum).
  12. Con una velocidad de análisis de 180 muestras por hora.
  13. Que utilice puntas desechables para la dispensación de muestras.
  14. Con capacidad de verificar el volumen de dispensación y aspiración por la pipeta de muestras.
  15. Con capacidad de verificar la presencia de coágulos por la pipeta de muestras.
  16. Con capacidad de verificación de nivel de líquidos para la pipeta de muestras por gradiente neumático.
  17. Cubetas de reacción desechables.
  18. Con la capacidad de alimentación continua de reactivos y consumibles de operación sin necesidad de pausar el sistema.
  19. Con capacidad de monitorear inventario abordo de reactivos y consumibles de operación a través del software.
  20. Con capacidad de interacción del usuario con el software a través de un monitor sensible al tacto.
  21. Con capacidad para interfaz de manera bidireccional.
  22. Con lector de código de barras para muestras abordo.
  23. Con la capacidad de realizar graficos de Levey-Jennings muestras de control de calidad.
  24. Con la capacidad de aplicar reglas de Westgard.
  25. Con la capacidad de aplicar normas de RiliBAK.


SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

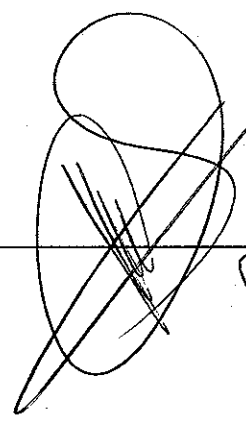
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>¿Se permite?</p>	
<p><b>ANEXO 1 EQUIPO PARA BIOMETRIAS HEMATICAS.</b></p> <p>Se permite ofertar un equipo que cuente con las características que a continuación se describen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Número de parámetros: 18 párametros.</li> <li>2. Capacidad de procesamiento: 60 muestras por hora para muestras de sangre completa.</li> <li>3. Tamaño de muestra 10 µL de sangre completa y de 25 µL muestras con diluyente (prediluido).</li> <li>4. Pantalla táctil a color para facilitar su uso.</li> <li>5. Impresión y visualización en pantalla de histogramas.</li> <li>6. Almacenamiento de más 1000 resultados de muestras.</li> <li>7. Impresora térmica incluida.</li> <li>8. Puerto especializado para lector de código de barras y puerto USB.</li> <li>9. Principio de medición por medio de impedancia.</li> <li>10. Estadísticas de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings.</li> <li>11. Interfaz del usuario con capacidades en múltiples idiomas.</li> <li>12. Tubo abierto manual.</li> <li>13. Parámetros de leucocitos:  WBC Conteo total de leucocitos  LYM% Porcentaje de linfocitos  LYM# Conteo total de linfocitos  MID% Porcentaje de Células de rango medio  MID# Conteo total de células de rango medio  GRA% Porcentaje de granulocitos  GRA# conteo total de Granulocitos</li> <li>14. Parámetros de eritrocitos:  RBC Conteo de eritrocitos  HGB Hemoglobina  HCT Hematocrito  MCV Volumen corpuscular medio  MCH Hemoglobina corpuscular media  MCHC Concentración de hemoglobina corpuscular media  RDW Amplitud de la distribución de eritrocitos</li> <li>15. Parámetros de trombocitos:  PLT Conteo de plaquetas  MPV Volumen plaquetario medio</li> </ol>	<p><b>SI. SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b></p>







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL      A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>PDW Ancho de Distribución de Plaquetas.                  PCT Trombocrito                  16. Control de Calidad interno a 3 niveles.</p> <p>Se permite?</p>	
<p><b>ANEXO 1 EQUIPO PARA REALIZACION DE AFERESIS</b></p> <p>Se permite ofertar una plataforma para pruebas de aféresis que cumpla con las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Equipo de aféresis de multicomponente (plaquetas y/o plasma y/o células tallo y/o leucoreducción) el precio incluirá los separadores celulares e insumos necesarios para efectuar cada tipo de procedimiento.</li> <li>2. Equipo para realizar procedimientos de Aféresis Unipunción.</li> <li>3. Equipo portátil con facilidad de transporte en las diferentes áreas de la unidad médica para evitar el movimiento de los pacientes con un peso menor a 27 kg.</li> <li>4. Con capacidad para realizar procedimientos de donación y terapéuticos como recolección de plaquetas, plasma, recambios plasmáticos, reducciones celulares, recolecciones de células madre.</li> <li>5. Con Sistemas de Detección de burbujas de aire, monitores de Presión.</li> <li>6. Parámetros programables según necesidades del usuario y ajustables a las condiciones del donador o paciente.</li> <li>7. Equipo con bombas de Sangre total, de Plasma y de Anticoagulante.</li> <li>8. Equipo con sistema de Pesaje para mejorar el control de fluidos extracorpóreos y de soluciones de reinfusión.</li> <li>9. Con equipos desechables opcionales para realizar procedimientos en pacientes adultos y pediátricos.</li> <li>10. Equipo con sistema de Centrifugación para campana de Tipo Latham y Bowl moldeado y sensor de humedad en el interior de la centrífuga.</li> <li>11. Equipo con sensor óptico y sensor de línea para la detección de fases de centrifugación de componentes sanguíneos.</li> <li>12. Equipo con 4 tarjetas electrónicas que contengan los diferentes protocolos a manejar.</li> <li>13. Equipo con los siguientes accesorios: funda</li> </ol>	<p><b>DEBERAN AJUSTARSE A LAS BASES.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>protectora para máquina, brazaletes para regular la presión ejercida en el brazo del donador o paciente, mesa de transporte.</p>	
---	--

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>Numeral 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, inciso h) el licitante deberá presentar copia simple, legible y vigente del registro sanitario (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), del equipo debidamente identificado por el número de partida y propuesta.</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si es correcto entender que será suficiente con presentar copia del registro sanitario vigente en el momento de la presentación de las propuestas sin que le reste una vigencia de 5 años. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>SI.</p>
<p>Numeral 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, inciso h) el licitante deberá presentar copia simple, legible y vigente del registro sanitario (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), del equipo debidamente identificado por el número de partida y propuesta.</p> <p>Pregunta: Es correcto entender que en caso de que el registro sanitario se encuentre vencido, será suficiente integrar la solicitud del tramite de prorroga en junto con el registro origen. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>SI.</p>
<p>Numeral 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, inciso h) el licitante deberá presentar copia simple, legible y vigente del registro sanitario (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), del equipo debidamente identificado por el número de partida y propuesta.</p> <p>Pregunta: Es correcto entender que en caso de que</p>	<p>SI.</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>los bienes ofertados se encuentren exentos de registro, será suficiente integrar la publicación del Diario Oficial de la Federación donde los excluye de registro por ser considerados de bajo riesgo para la salud.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p><b>Numeral 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, inciso h)</b> el licitante deberá presentar copia simple, legible y vigente del registro sanitario (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), del equipo debidamente identificado por el número de partida y propuesta.</p> <p>Pregunta: En lo relativo para este numeral solicitamos a la convocante aclarar que se deberá entender como partida propuesta.</p> <p>Favor de aclarar</p>	<p><b>A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</b></p>
<p><b>Numeral 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, inciso h)</b> el licitante deberá presentar copia simple, legible y vigente del registro sanitario (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), del equipo debidamente identificado por el número de partida y propuesta.</p> <p>Pregunta: ¿En lo relativo para este numeral solicitamos a la convocante aclarar que se deberá entender cómo propuesta?</p> <p>Favor de aclarar</p>	<p><b>A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</b></p>
<p><i>Numeral 4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.</i></p> <p>Pregunta: Es correcto entender que dicho contrato</p>	<p><b>SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37, NÚMERALES 4 Y 5 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA QUE DICEN TEXTUALMENTE: ART. 37 DE LA LAASSPEC PROPUESTAS CONJUNTAS, NÚMERAL 4 " CUANDO LA PROPUESTA CONJUNTA RESULTE</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

<p><i>deberá ser celebrado entre las partes con roles y funciones de cada uno de los integrantes debiendo establecer en este instrumento jurídico el representante común y especificando el número de proceso licitatorio de referencia para el cual reunieron esfuerzos, así como también debiendo integrar una copia certificada en su propuesta técnica.</i></p> <p><i>¿Es correcta nuestra apreciación?</i></p>	<p><b>ADJUDICADA CON UN CONTRATO, DICHO INSTRUMENTO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA, A QUIENES SE CONSIDERARÁ PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO, COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONTRATO ART. 37 DE LA LAASPEC PROPUESTAS CONJUNTAS, NÚMERAL 5 " LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA CONJUNTA PUEDAN CONSTITUIRSE EN UNA NUEVA SOCIEDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO DE PROPUESTA CONJUNTA, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN EN LA NUEVA SOCIEDAD LAS RESPONSABILIDADES DE DICHO CONVENIO"</b></p>
<p><b>Numeral 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, inciso i) El licitante deberá presentar junto con su propuesta técnica copia legible de los certificados ISO 9001 y/o ISO 13485 de los equipos, así como, copia legible de cualquiera de los siguientes certificados: FDA, CE, CLV, TUV de los equipos ofertados.</b></p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante eliminar la obligación de integrar los certificados ISO 9001 ya que esto esta relacionado con acciones administrativas y no de manufactura.</p> <p><i>¿Se permite?</i></p>	<p><b>DEBERA PRESENTAR INDISTINTAMENTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: ISO9001:2008, Y/O ISO 9001:2015 Y/O ISO 13485; FDA, CE, CLV, TUV, DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SEGÚN SEA EL CASO QUE LO REQUIERA.</b></p>
<p><b>Numeral 4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, inciso El licitante deberá presentar junto con su propuesta técnica copia legible de los certificados ISO 9001 y/o ISO 13485 de los equipos, así como, copia legible de cualquiera de los siguientes certificados: FDA, CE, CLV, TUV de los equipos ofertados.</b></p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si será suficiente presentar un solo documento en el caso de presentar un TUV ya que este contempla un ISO 13485, por lo que en un solo documento cumple con los dos puntos.</p> <p><i>¿Es correcta nuestra apreciación?</i></p>	<p><b>DEBERA PRESENTAR INDISTINTAMENTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: ISO9001:2008, Y/O ISO 9001:2015 Y/O ISO 13485; FDA, CE, CLV, TUV, DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SEGÚN SEA EL CASO QUE LO REQUIERA.</b></p>

*Am 66*  
*cap*  
*A*  
*E*  
*G*  
*A*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Large handwritten signature)*



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p><b>3.- EN EL ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS A PROPORCIONAR. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSA-2012 EN EL PUNTO 15.9.2 DEBEMOS ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN CUYO VALOR NO EXCEDERÁ DE TRES VECES DEL PUNTO DE CORTE, EL CUAL ES INDEPENDIENTE DE LOS CONTROLES QUE INCLUYE EL FABRICANTE PARA LOS ANALITOS HIV, HCV, HBC, SIFILIS, Y CHAGAS Y DEBERÁ SER RESPALDADO CON CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DEL CONTROL.</b></p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SI</p>
<p><b>4.- EN EL APARTADO EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CETS Y SUS 2 PUESTOS DE SANGRADO SOLICITAN UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO QUE INCLUYA TARJETAS DE GEL PARA LA REALIZACIÓN DE DDEBIL Y RH Y ANTICUERPOS IRREGULARES. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE:</b></p> <p>A) SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN, QUE DEBEMOS OFERTAR TARJETA DE GRUPO SANGUÍNEO EN GEL QUE CONTENGA ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CONTROL, A1 Y B EN UN SOLO PASO, PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL A LA NOM-253-SSA-2012.</p>	<p>SI</p>
<p>B) SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SEMIPANEL PARA LA INVESTIGACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON 3 CÉLULAS A UNA CONCENTRACIÓN DEL 0.8% EN PRESENTACIÓN DE 3X10 ML, LA CUAL INCLUYA LA CÉLULA DIEGO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SI</p>
<p>C) SI ES AFIRMATIVA EL INCISO B) SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE TENDRÁ QUE INCLUIR LAS TARJETAS DE GEL COOMBS PARA REALIZAR EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES ¿ES CORRECTA</p>	<p>SI, SE REALIZARIAN APROXIMADAMENTE 100 PRUEBAS POR MES.</p>

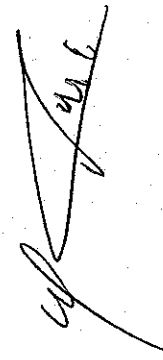



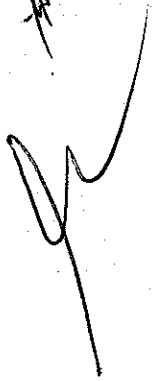
40





SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

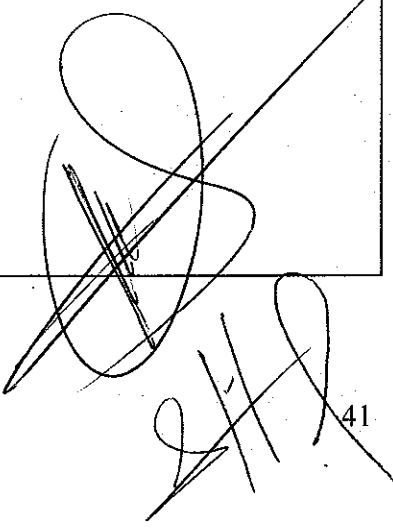
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

MI APRECIACIÓN Y QUE CANTIDAD SE REALIZARÍAN?															
D) SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZAR GRUPO SANGUÍNEO, D DÉBIL, RH Y ANTICUERPOS IRREGULARES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	<b>SI SE ACEPTA</b>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">1. PROCESO AUTOMÁTICO CONTINUO E INTEGRADO.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">2. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">3. RE SUSPENSIÓN DE LOS ERITROCITOS.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">4. DILUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">5. INCUBACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">6. MONITOREO DE NIVELES DE DILUYENTES, REACTIVO Y SOLUCIONES.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">7. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">8. PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE TRABAJO CON POSIBILIDAD DE COMBINAR TODAS LAS TÉCNICAS PARA UNA MISMA MUESTRA.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">9. PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE URGENCIA.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">10. INTERFACE BIDIRECCIONAL.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">11. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">12. CARRUSEL MÍNIMO PARA 48 MUESTRAS.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">13. ZONA DE INCUBACIÓN MÍNIMO PARA 24 TARJETAS.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">14. DETECCIÓN DE COÁGULOS.</td></tr> </table>	1. PROCESO AUTOMÁTICO CONTINUO E INTEGRADO.	2. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS.	3. RE SUSPENSIÓN DE LOS ERITROCITOS.	4. DILUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS.	5. INCUBACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.	6. MONITOREO DE NIVELES DE DILUYENTES, REACTIVO Y SOLUCIONES.	7. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA.	8. PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE TRABAJO CON POSIBILIDAD DE COMBINAR TODAS LAS TÉCNICAS PARA UNA MISMA MUESTRA.	9. PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE URGENCIA.	10. INTERFACE BIDIRECCIONAL.	11. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO.	12. CARRUSEL MÍNIMO PARA 48 MUESTRAS.	13. ZONA DE INCUBACIÓN MÍNIMO PARA 24 TARJETAS.	14. DETECCIÓN DE COÁGULOS.	
1. PROCESO AUTOMÁTICO CONTINUO E INTEGRADO.															
2. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS.															
3. RE SUSPENSIÓN DE LOS ERITROCITOS.															
4. DILUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS.															
5. INCUBACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.															
6. MONITOREO DE NIVELES DE DILUYENTES, REACTIVO Y SOLUCIONES.															
7. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA.															
8. PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE TRABAJO CON POSIBILIDAD DE COMBINAR TODAS LAS TÉCNICAS PARA UNA MISMA MUESTRA.															
9. PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE URGENCIA.															
10. INTERFACE BIDIRECCIONAL.															
11. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO.															
12. CARRUSEL MÍNIMO PARA 48 MUESTRAS.															
13. ZONA DE INCUBACIÓN MÍNIMO PARA 24 TARJETAS.															
14. DETECCIÓN DE COÁGULOS.															
CON EQUIPO DE RESPALDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INCUBADOR															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">1.</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">ZONAS INDEPENDIENTES DE INCUBACIÓN CON CAPACIDAD PARA 12 TARJETAS GEL CADA UNA.</td> </tr> </table>	1.	2	ZONAS INDEPENDIENTES DE INCUBACIÓN CON CAPACIDAD PARA 12 TARJETAS GEL CADA UNA.												
1.	2	ZONAS INDEPENDIENTES DE INCUBACIÓN CON CAPACIDAD PARA 12 TARJETAS GEL CADA UNA.													







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL      A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

2. 2 ZONAS INDEPENDIENTES CON CAPACIDAD PARA 12 TUBOS DE MUESTRA CADA UNA PARA PRE-INCUBACIÓN.
3. PANTALLA DIGITAL DE INTERFACE CON EL USUARIO PARA EL CONTROL Y LA VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE: TIEMPO DE INCUBACIÓN RESTANTE Y TEMPERATURA PARA CADA ZONA.
4. TEMPERATURA DE INCUBACIÓN PREFIJADA A 37°C.
5. TIEMPO DE INCUBACIÓN PREFIJADO A 15 MINUTOS, CON OPCIÓN POR PARTE DEL USUARIO DE PROGRAMAR DIFERENTES TIEMPOS.
6. ALARMA SONORA DE FINAL DE INCUBACIÓN PROGRAMABLE.
7. INDICACIÓN SONORA Y VISUAL DE CUALQUIER SITUACIÓN DE ERROR Y CORTE DE CORRIENTE.
8. GUÍA RÁPIDA DE PROCEDIMIENTO.
9. BANDEJA DE RESIDUOS EXTRAÍBLE.
10. CAPACIDAD: 24 TARJETAS DG GEL Y
11. 24 TUBOS DE MUESTRA
12. CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL DE GRUPO SANGUÍNEO ABO, DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD.
<b>CENTRIFUGA</b>
1. CAPACIDAD PARA CENTRIFUGAR 24 TARJETAS DE MANERA SIMULTÁNEA.
2. CABEZAL DE AJUSTE MAGNÉTICO EXTRAÍBLE E INTERCAMBIABLE.
3. PARÁMETROS DE CENTRIFUGACIÓN PREFIJADO PARA EL PROCESAMIENTO ÓPTIMO DE LAS TARJETAS DE GEL: ACELERACIÓN, VELOCIDAD, FRENADO Y TIEMPO.
4. PANTALLA DIGITAL DE INTERFACE CON VISUALIZACIÓN EN TIEMPO DE VELOCIDAD DE CENTRIFUGACIÓN Y TIEMPO RESTANTE

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL      A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES






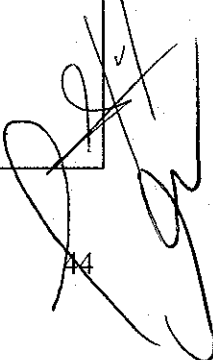
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.


DEL PROCESO.		
5. ALARMA SONORA Y VISUAL DE CUALQUIER SITUACIÓN DE ERROR Y CORTE DE CORRIENTE.		
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIO PARA ASEGURAR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LAS TARJETAS EN EL CABEZAL.		
7. CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN TARJETAS DE GEL DE GRUPO SANGUÍNEO ABO, DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD.		
5.- EN EL APARTADO INSUMOS NECESARIOS PARA SELECCIÓN DEL DONADOR SOLICITAN: ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN SE TENDRÁ QUE ENTREGAR FRASCOS DE 10 ML, DE ACUERDO AL CUADRO BÁSICO. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.	SI	
6.- EN EL APARTADO INSUMOS NECESARIOS PARA SELECCIÓN DEL DONADOR SOLICITAN: ANTI LECTINA A1 Y ANTI LECTINA H. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN SE TENDRÁ QUE OFERTAR PRESENTACIÓN DE 5 ML COMO LO MARCA EL CUADRO BÁSICO. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.	SI	
7.- EN EL APARTADO INSUMOS NECESARIOS PARA SELECCIÓN DEL DONADOR SOLICITAN: ANTI ANTISUERO ANTI IGG. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE LO QUE SOLICITAN ES EL SUERO DE COOMBS POLIESPECIFICO IGG - C3D DE 10 ML, DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO.  ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.	SI	
8.- EN EL APARTADO INSUMOS NECESARIOS PARA SELECCIÓN DEL DONADOR SOLICITAN: ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, ANTI LECTINA A1, ANTI LECTINA H, Y SUERO ANTI IGG COOMBS. SOLICITO ATENTAMENTE A LA	SI	

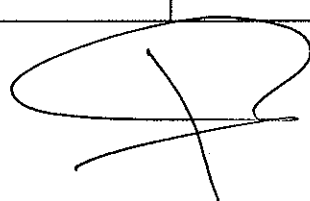
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

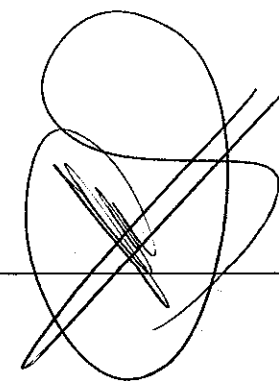
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE SE TENDRÁ QUE INCLUIR CONTROL RH Y ALBUMINA AL 22% PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.</p> <p>ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.</p>	
<p>9. SOLICITO A ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ PRESENTACIÓN DEBEMOS OFERTAR PARA LA REALIZACIÓN DE BRUCELOSIS, PRESENTACIÓN DE 150 PRUEBAS O 50 PRUEBAS.</p>	<p><b>PARA 150 PRUEBAS</b></p>
<p>10. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PRODUCTIVIDAD SE VAN A REALIZAR DE GRUPOS SANGUÍNEOS DIRECTO E INVERSO Y DE RASTREO DE ANTICUERPOS.</p>	<p><b>APROXIMADAMENTE 900 PRUEBAS AL MES DE GRUPO SANGUINEO Y EL 5% DE ESTAS PARA EL RASTREO DE ANTICUERPOS.</b></p>
<p>11. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE POR FAVOR EN EL PUNTO 3.19 ISO 9001:2015 DEL LICITANTE. ESTAN SOLICITANDO QUE LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 Y/O ISO9001:2015 DEL LICITANTE, CUYO ALCANCE SEA " VENTA, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE , OFRECIENDO SERVICIOS INTEGRALES, VIGENTE Y EXPEDIDO POR UN ORGANISMO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C.</p> <p>ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE ESTE ORGANISMO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION SOLO APLICA A LOS ORGANISMOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD QUE SON LOS LABORATORIOS DE ENSAYO ( MAQUILA ), LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN, LABORATORIOS CLÍNICOS, UNIDADES DE VERIFICACIÓN (ORGANISMOS DE INSPECCIÓN) Y ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN, PROVEEDORES DE ENSAYOS DE APTITUD Y NO PARA LOS LICITANTES EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001.2008 Y/O ISO 9001: 2015 .</p>	<p><b>A ESTE PUNTO SE LE DA RESPUESTA EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</b></p>







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>12. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN PARA EL PUNTO 4, INCISO I) QUE LO QUE SOLICITAN ES EL ISO 13485 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA DISPOSITIVOS MEDICOS ( EQUIPOS ) Y NO EL ISO 9001:2008 Y/O ISO 9001:2015 ( SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LOS LICITANTES )</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>LOS LICITANTES DEBERÁN HACER CONSTAR QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD; POR LO CUAL, DEBERÁN DE INTEGRAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA CERTIFICADA DE SU CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y/O ISO 9001:2008; EN CASO DE PRESENTAR ESTA ULTIMA; DEBERÁN PRESENTAR SUS TRAMITES PARA INICIAR CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015; ASI MISMO, PRESENTAR AL MENOS UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN ORIGINAL A FAVOR DEL PARTICIPANTE EXPEDIDA POR UN ORGANISMO PUBLICO, DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, MENCIONANDO QUE EL PARTICIPANTE HA COADYUVADO EN LAS TAREAS DE IMPLEMENTACION DE ALGÚN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, ACOMPAÑANDO ESTA DE COPIA CERTIFICADA DE LA CERTIFICACIÓN OBTENIDA.</p>
---	---

7.- En relación al punto 4 de proposiciones y 4.1 propuesta técnica y económica; se hace la aclaración que en el anexo 2 y 2-A deberán indicar el costo correspondiente al 10% del número de unidades procesadas del donador rechazado al que se le realizó biometría hemática y procedimiento por aferesis.

8.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, programado para el día 02 de marzo del año en curso, se difiere para el día **09 de marzo a las 17:00**, en tanto que el fallo programado para el día 06 de marzo del año en curso a las **12:00**, se difiere para el día **13 de marzo** del año en curso, a las **17:00 horas**.

9.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en el domicilio de la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

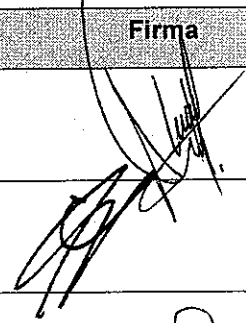
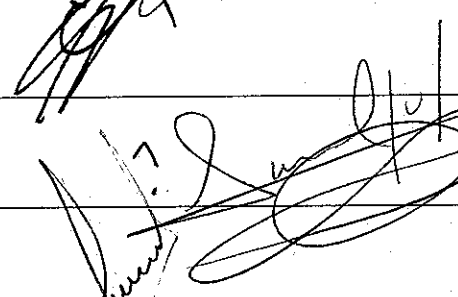
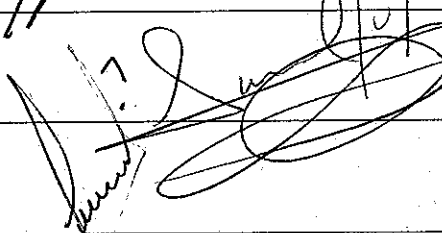




Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **24:00** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-008-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

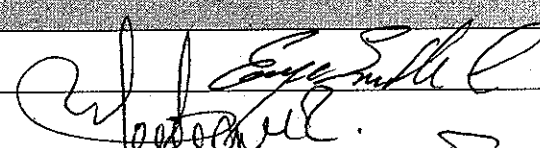
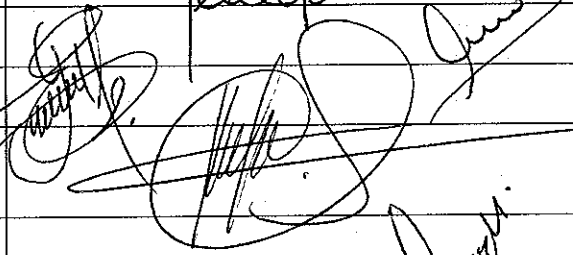
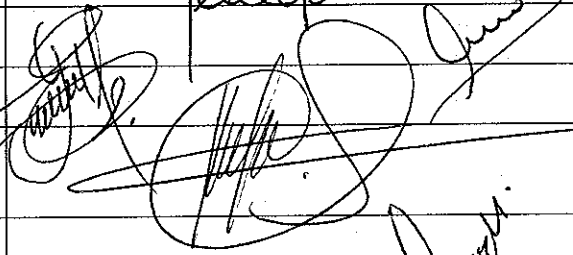
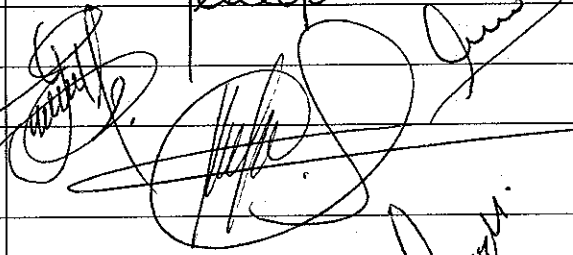
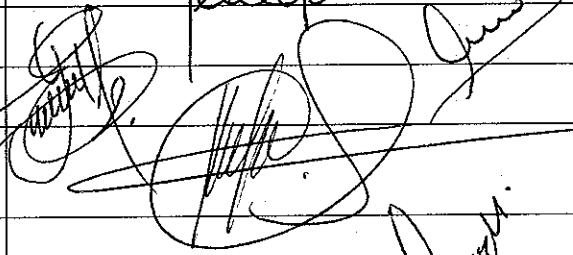
A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

**Funcionarios**

Nombre	Firma
<b>C.P. Arnoldo Moreno Medina</b> Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales	
<b>L.A. Carlos Arnoldo Campos Ochoa</b> Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado	
<b>C.P. Manuel Santa Ana Velasco</b> Representante de la Secretaría de Administración y Gestión Pública	
<b>ENF. MIL. Irela Zamora Vargas</b> Representante del REPSS	
<b>Lic. Jesús Carillo Hernández</b> Jefe del Departamento de Compras	
<b>Lic. Judith Estefanía Torres García</b> Coordinación de Asuntos Jurídicos	
<b>QFB Ma. Magdalena Valdez Velasco</b> Subdirectora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea	

**Licitantes**

<b>Enrique Smith Corvera</b> Impromed SA de CV	
<b>Marisela Munguía Ruiz</b> Distribuidora Lhag SA de CV	
<b>Diana Berenice García Badillo</b> Laboratorios Licon SA	
<b>Carlos Enciso Galina</b> CEPIT SA de CV	
<b>Teresa Montserrat Aguirre Velázquez</b> Distribuidora Química y Hospitalaria GAP SA de CV	
<b>Juliana Zarate Narvaez</b> Insumos Médicos Mar de Cortés SA de CV	