

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA


En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:00** horas del día **10 de Abril de 2018**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 numeral 4° y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los participantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-021-18**, relativa: **PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

El acto fue presidido por el **C.P. Arnoldo Moreno Medina, Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales**, quien fue autorizado mediante oficio **DA/604/2018**, de fecha 10 del mes y año en curso, y firmado por la Directora Administrativa, la LAET. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:


1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.


2.- Se precisa que los equipos que se entregarán en COMODATO, no deberán tener una fabricación de más de tres años, por lo que pueden ser nuevos o seminuevos (dentro del rango antes mencionado). Así como en **caso de presentar más de dos fallas subsecuentes, deberán cambiarlo por uno nuevo o seminuevo del mismo período de no mas de tres años de fabricación y en condiciones óptimas de uso**

3. - Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:

















SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES


PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

PREGUNTA DEL LICITANTE: Internet, S.A. de C.V.

A). DE CARACTER ADMINISTRATIVO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|--|
| 1.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA FECHA CORRECTA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, 16 de mayo de 2018 y hasta el hasta el 31 diciembre del 2019. | ES CORRECTA LA VIGENCIA LA CONTRATACION SERA DEL 16 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 2.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI NUESTROS ESCRITOS Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACION PUEDEN IR DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: Secretaría de Salud y Bienestar Social Gobierno del Estado de Colima Dirección Administrativa Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales Licitación Pública Nacional con Carácter de Presencial No. 36066001-021-18 “Para la contratación del Servicio Integral para el Suministro de Insumos y Comodato de Equipos para los Laboratorios de Hospitales, Jurisdicciones y Laboratorio Estatal de Salud Pública, de los Servicios de Salud del Estado de Colima” DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | Se acepta y será dirigida a nombre del Dr. Miguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar Social. |
| ¿SE ACEPTA? | |
| 3.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL FOLIO DE NUESTRA DOCUMENTACION DISTINTA SOLICITADA EN EL PUNTO 3 Y LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA PUEDA SER DE FORMA INDEPENDIENTE. ¿SE ACEPTA? | Se acepta. |







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

[Handwritten signatures]

PREGUNTAS DEL LICITANTE: LABORATORIOS LICON, S.A.

| PREGUNTA | RESPUESTA |
|---|-------------------------------|
| 1. PROPUESTA TECNICA. ANEXO NÚMERO 1 TECNICO. EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGIA EN TARJETAS DE GEL. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI DEBEMOS CONSIDERAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN GEL LA UTILIZACIÓN DE 3 POZOS POR PRUEBA (PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y AUTOCONTROL). ¿FAVOR DE ACLARAR? | CONSIDERAR 3 POZOS POR PRUEBA |

PREGUNTA DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA LHAG SA DE CV

| PREGUNTA | RESPUESTA |
|--|---|
| 1.-Solicitamos atentamente a la convocante que nos proporcionen la cantidad de pruebas que se realiza en el Hospital Materno Infantil y en el Instituto Estatal de Cancerología. | Para el caso del Hospital Materno infantil por ser de nueva creación no se cuenta con ese dato, y en el caso del Instituto Estatal de Cancerología en las cuadros F y G existe un error en la nomenclatura, Dice "CEC" debiendo decir "IEC" |

PREGUNTA DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA LHAG SA DE CV

| PREGUNTA | RESPUESTA |
|--|---|
| 1.-Solicitamos atentamente a la convocante que nos proporcionen la cantidad de pruebas que se realiza en el Hospital Materno Infantil y en el Instituto Estatal de Cancerología. | Esta pregunta ya fue contestada en la pregunta anterior |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





[Handwritten signatures]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1





PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| 4.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTRAS PROPUESTAS TECNICA-ECONOMICA Y DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL PUNTO 3, EN CARPETA DE 3 ARGOLLAS. ¿SE ACEPTA? | Se acepta. |
| 5.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR NUESTROS DOCUMENTOS ORIGINALES EN MICA PROTECTORA DE HOJAS PARA SU RESGUARDO. ¿SE ACEPTA? | Se acepta. |
| DEBIDO A QUE LA PUBLICACIÓN Y OBTENCIÓN DE BASES SE REALIZO EL DIA DE HOY, TENIENDO COMO FECHA LIMITE, PARA ENTREGA DE PREGUNTAS HOY MISMO A LAS 12:00 DEL DIA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE EL AMPLIAR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE PREGUNTAS, YA QUE DE LO CONTRARIO LIMITAN AL ANÁLISIS DE LAS BASES Y A LA PARTICIPACIÓN DE UN MAYOR NUMERO DE EMPRESAS QUE CONTRAVIENE A LO INDICADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. | APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL 2.2 DE LAS BASES |


B).- DE CARACTER TECNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|--|---|
| 6.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO ENTENDEMOS QUE ESTE ANEXO SERA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA Y DEBEMOS PRESENTARLO PERSONALIZADO Y FIRMADO COMO CARTA ADICIONAL EN NUESTRA LICITACION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 7.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I • CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 POSICIONES DE REACTIVOS EN REFRIGERACION PARA FRASCOS DE SISTINTOS TAMAÑOS Y CON CAPACIDAD DE COLOCAR REACTIVOS EN COPILLAS (MICROVOLUMEN DE REACTIVO) POR EL TIPO DE PRUEBAS OFERTADAS, LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PRUEBAS Y ASEGURANDO LA PRONTITUD DE LA ENTREGA DE RESULTADOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 40 POSICIONES DE REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN PARA FRASCOS DE DISTINTOS TAMAÑOS Y CON CAPACIDAD DE COLOCAR REACTIVOS EN FRASCOS DE 4 ML (PARA VOLÚMENES DE HASTA 1 ML DE REACTIVO) ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | NO SE ACEPTA, LA CANTIDAD DE POSICIONES REFRIGERADAS SON INSUFICIENTES PARA EL SERVICIO |







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|--|
| <p>8.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 POSICIONES DE REACTIVOS EN REFRIGERACION PARA FRASCOS DE SISTINTOS TAMAÑOS Y CON CAPACIDAD DE COLOCAR REACTIVOS EN COPILLAS (MICROVOLUMEN DE REACTIVO) <p>POR EL TIPO DE PRUEBAS OFERTADAS, LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PRUEBAS Y ASEGURANDO LA PRONTITUD DE LA ENTREGA DE RESULTADOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 26 POSICIONES DE REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN PARA FRASCOS DE DISTINTOS TAMAÑOS Y CON CAPACIDAD DE COLOCAR REACTIVOS EN FRASCOS DE 4 ML (PARA VOLÚMENES DE HASTA 1 ML DE REACTIVO) ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA, LA CANTIDAD DE POSICIONES REFRIGERADAS SON INSUFICIENTES PARA EL SERVICIO</p> |
| <p>9.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE TENER CURVAS PRECALIBRADAS POR LOTES DE REACTIVOS PARA TP, FIBRINOGENO Y DIMERO D; EVITANDO GASTO INNECESARIO DE TIEMPO, REACTIVO Y CONSUMIBLES. <p>POR EL TIPO DE PRUEBAS OFERTADAS Y DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE UN CORRECTO REPORTE DE RESULTADOS Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MISMOS ¿SE ACEPTA EQUIPO QUE REALICE CALIBRACIONES ÚNICAMENTE POR EL CAMBIO DE LOTE DE REACTIVOS DE ESTAS PRUEBAS?</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>POR LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS, AHORRO DE TIEMPO Y REACTIVO SE REQUIREN ESTA CARACTERISTICA</p> |
| <p>10.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • METODOLOGIA DE ANALISIS PARA PRUEBAS: CRONOMETRICAS (VISCOSIMETRIA), COLORIMETRIA (CROMOGENICAS), E INMUNOLOGICAS (INMUNOTURBIDIMETRICO). <p>¿SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO CON METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE PRUEBAS: COAGULOMÉTRICAS (DETECCIÓN DE COAGULO POR MÉTODO ÓPTICO), CROMOGENICAS E INMUNOLÓGICAS?</p> <p>YA QUE TIENE ALTA SENSIBILIDAD DE FORMACIÓN DEL COAGULO Y SE GENERA UNA CURVA DE REACCIÓN POR ANÁLISIS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>SOLICITAMOS METODOLOGIA CRONOMETRICA, COLORIMETRICA E INMUNOTURBIDIMETRICA PARA EVITAR INTERFERENCIAS CON MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS.</p> |
| <p>11.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO CON 2 NIVELES DE CONTROL DE CALIDAD CON CURVAS DE LEVEY-JENNINGS. DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD ADEMÁS DE LO REQUERIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INSTRUMENTO QUE INCLUYA LAS REGLAS DE WESTGARD PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE LOS ERRORES DEL CONTROL DE CALIDAD, ASÍ COMO | <p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES</p> |

Debarco

[Handwritten signatures]

[Vertical handwritten signatures and marks on the right margin]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|--|
| <p>CRITERIOS DE CORRIMIENTO DE CONTROLES POR TIEMPO O POR NÚMERO DE MUESTRAS, ¿SE DEBERÁ ACEPTAR UN EQUIPO CON SOLO ESTAS CARACTERÍSTICAS DE CURVAS LEVEY-JENNINGS? YA QUE GESTIONARA DE MANERA ADECUADA EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | |
| <p>12.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS: OPCIONAL Y MEMORIA PARA ALMACENAR UN NUMERO ILIMITADO DE PACIENTES EN DISCO DURO. <p>POR LA IMPORTANCIA DE UN ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MANERA CORRECTA Y PARA EVITAR ERRORES EN LA CARGA DE REACTIVOS EN EL INSTRUMENTO CONSIDERAMOS QUE UN EQUIPO CON LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS INTEGRADO PARA MUESTRAS Y REACTIVOS ES INDISPENSABLE. ¿SE DEBERÁ ACEPTAR UN EQUIPO QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS SEAN SOLO OPCIONALES? ¿PODEMOS OFERTAR EQUIPO QUE TENGA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS INTEGRADO EN EL INSTRUMENTO?, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIN MODIFICAR LO SOLICITADO EN BASES</p> |
| <p>13.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS: OPCIONAL Y MEMORIA PARA ALMACENAR UN NUMERO ILIMITADO DE PACIENTES EN DISCO DURO. <p>POR LA IMPORTANCIA DE UN ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MANERA CORRECTA Y PARA EVITAR ERRORES EN LA CARGA DE REACTIVOS EN EL INSTRUMENTO CONSIDERAMOS QUE UN EQUIPO CON LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS INTEGRADO PARA MUESTRAS Y REACTIVOS ES INDISPENSABLE. ¿SE DEBERÁ ACEPTAR UN EQUIPO QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS SEAN SOLO OPCIONALES? ¿PODEMOS OFERTAR EQUIPO QUE TENGA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS INTEGRADO EN EL INSTRUMENTO?, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>CON RESPECTO A LA MEMORIA PARA ALMACENAR UN NÚMERO ILIMITADO DE PACIENTES EN DISCO DURO, ¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE BASE DE DATOS DE HASTA 20,000 MUESTRAS? ESTO CONSIDERANDO QUE EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SE TENDRÁ EL RESPALDO TOTAL DE LOS RESULTADOS Y ESTE NÚMERO DE MUESTRAS EN MEMORIA ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES</p> |
| <p>14.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MINIMO 150 PRUEBAS POR HORA. | <p>NO SE ACEPTA, POR NECESIDAD DEL SERVICIO SE REQUIERE ESTA CARACTERÍSTICA</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|---|
| <p>GARANTIZANDO EL OPORTUNO PROCESO DE MUESTRAS, PRONTA ENTREGA DE RESULTADOS Y CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE PRUEBAS DEL LABORATORIO ¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR MÍNIMO 110 PRUEBAS POR HORA? ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | |
| <p>15.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CAPACIDAD DE CARGA DE 96 TUBOS DE NUESTRA PRIMARIO ABORDO. <p>GARANTIZANDO EL OPORTUNO PROCESO DE MUESTRAS, PRONTA ENTREGA DE RESULTADOS Y CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE PRUEBAS DEL LABORATORIO ¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CARGA DE 80 TUBOS DE MUESTRA A BORDO? ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES</p> |
| <p>16.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN I</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CAPACIDAD DE CARGA DE 96 TUBOS DE NUESTRA PRIMARIO ABORDO. <p>GARANTIZANDO EL OPORTUNO PROCESO DE MUESTRAS, PRONTA ENTREGA DE RESULTADOS Y CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE PRUEBAS DEL LABORATORIO ¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 TUBOS DE MUESTRA A BORDO? ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA POR LA NECESIDAD QUE REQUEREN LAS UNIDADES</p> |
| <p>17.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN II</p> <ul style="list-style-type: none"> • METODOLOGIA DE ANALISIS PARA PRUEBAS: CRONOMETRICA (VISCOSIMETRIA), COLORIMETRICAS (CROMOGENICAS) E INMUNOLOGICAS (INMUNOTURBIDIMETRICO). <p>¿SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO CON METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE PRUEBAS: COAGULOMÉTRICAS (DETECCIÓN DE COAGULO POR MÉTODO NEFELOMÉTRICO), CROMOGENICAS E INMUNOLÓGICAS? YA QUE TIENE ALTA SENSIBILIDAD DE FORMACIÓN DEL COAGULO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>SOLICITAMOS METODOLOGIA CRONOMETRICA, COLORIMETRICA E INMUNOTURBIDIMETRICA PARA EVITAR INTERFERENCIAS CON MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS</p> |
| <p>18.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN II</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CAPACIDAD DE 16 POSICIONES PARA REACTIVOS EN REFRIGERACION Y 20 POSICIONES DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES TAMAÑOS. <p>DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LAS UNIDADES HACEN SOLO PRUEBAS DE TIEMPO DE PROTROMBINA Y PARCIAL DE TROMBOPLASTINA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSTRUMENTOS CON CAPACIDAD DE COLOCAR 22 REACTIVOS A BORDO (8 REFRIGERADOS Y 14 NO REFRIGERADOS) CON LA CUAL SE CUBREN LAS NECESIDADES</p> | <p>NO SE ACEPTA, LA CANTIDAD DE POSICIONES REFRIGERADAS SON INSUFICIENTES PARA EL SERVICIO</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES









PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA


| | |
|--|---|
| DE PRUEBAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | |
| <p>19.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN II</p> <p>•CON CAPACIDAD DE 16 POSICIONES PARA REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN Y 20 POSICIONES DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES TAMAÑOS.</p> <p>DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LAS UNIDADES HACEN SOLO PRUEBAS DE TIEMPO DE PROTROMBINA Y PARCIAL DE TROMBOPLASTINA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSTRUMENTOS CON CAPACIDAD DE COLOCAR MENOS DE 16 REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DICHAS PRUEBAS YA QUE PARA SU REALIZACIÓN SOLO SE REQUIEREN DE 3 POSICIONES DE REACTIVO, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE 18 POSICIONES DE MUESTRA CON EL CUAL SE GARANTIZA LA ENTREGA OPORTUNA DE RESULTADOS ¿SE ACEPTA INSTRUMENTO CON DICHAS CARACTERÍSTICAS? ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA, LA CANTIDAD DE POSICIONES REFRIGERADAS SON INSUFICIENTES PARA EL SERVICIO</p> |
| <p>20.- PROPUESTA TÉCNICA ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (J) EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE COAGULACIÓN II</p> <p>•CON CAPACIDAD DE 16 POSICIONES PARA REACTIVOS EN REFRIGERACION Y 20 POSICIONES DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES TAMAÑOS.</p> <p>DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LAS UNIDADES HACEN SOLO PRUEBAS DE TIEMPO DE PROTROMBINA Y PARCIAL DE TROMBOPLASTINA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSTRUMENTOS CON CAPACIDAD DE COLOCAR 22 REACTIVOS A BORDO (8 REFRIGERADOS Y 14 NO REFRIGERADOS) CON LA CUAL SE CUBREN LAS NECESIDADES DE PRUEBAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA, LA CANTIDAD DE POSICIONES REFRIGERADAS SON INSUFICIENTES PARA EL SERVICIO</p> |
| <p>21.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) EQUIPO DE COAGULACION I. SOLICITAN</p> <p>CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 POSICIONES DE REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN PARA FRASCOS DE DISTINTOS TAMAÑOS Y CON CAPACIDAD DE COLOCAR REACTIVOS EN COPILLAS (MICRO VOLUMEN DE REACTIVO). CAPACIDAD DE TENER CURVAS PRE CALIBRADAS POR LOTES DE REACTIVOS PARA TP, FIBRINÓGENO Y DIMERO D; EVITANDO GASTO INNECESARIO DE TIEMPO, REACTIVO Y CONSUMIBLES. METODOLOGIA DE ANALISIS PARA PRUEBAS: CRONOMETRICAS (VISCOSIMETRIA), COLORIMETRIA (CROMOGENICAS), E INMUNOLOGICAS (INMUNOTURBIDIMETRICO. REPORTE INDIVIDUAL EN SEGUNDOS, INR, PORCENTAJE Y MG/DL.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE RECIBA MÁS OFERTAS SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE 22 REACTIVOS ABORDO (8</p> | <p>ACTUALMENTE EN EL MERCADO EXISTEN OTRAS MARCAS DE INSTRUMENTOS QUE CUMPLEN CON ESTA CARACTERÍSTICAS, TAN IMPORTANTES PARA SERVICIOS DE SALUD POR LO QUE NO SE ACEPTA.</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS
 LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA,
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|---|
| <p>POSICIONES CON REFRIGERACIÓN Y AGITACIÓN MAGNÉTICA Y 14 NO REFRIGERADOS) Y EN LA ZONA POSTERIOR INCLUYE 4 POSICIONES REFRIGERADAS ADICIONALES. EL ANILLO DEL CARRUSEL DE MUESTRA DISPONE DE ÁREAS DE REACTIVOS, DONDE SE PUEDEN UBICAR HASTA 10 VIALES DE REACTIVOS MÁS Y PUEDEN SER ASPIRANDO DESDE SU FRASCO ORIGINAL O COPILLAS.</p> <p>MODO DE CALIBRACIÓN DE MANERA AUTOMÁTICA: LA DETECCIÓN NEFELOMÉTRICA DEL COAGULO PERMITE AL EQUIPO MEDIR CON EXACTITUD LA FORMACIÓN DE HEBRAS DE FIBRINA</p> <p>EQUIPO QUE TIEMPO DE PROTROMBINA (SEG, %, RATIO; INR) TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (SEG, R), FIBRINÓGENO DERIVADO DE TP (MG/DL, G/L), TIEMPO DE TROMBINA (SEG, RATIO) DIMERO D NG/ML)</p> <p>LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADA EN BASES LA CUMPLE UNA SOLA MARCA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONTRAPONIÉNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SU ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>22.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) EQUIPO DE COAGULACION I.</p> <p>SOLICITAN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS: OPCIONAL Y MEMORIA PARA ALMACENAR UN NÚMERO ILIMITADO DE PACIENTES EN DISCO DURO. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 150 PRUEBAS POR HORA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS, Y TENGA LA CAPACIDAD PARA ALMACENAR 1000 PACIENTES CON DATOS DEMOGRÁFICOS Y HASTA 30 RESULTADOS (30,000TETS).</p> <p>CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 175 PRUEBAS POR HORA PARA TIEMPO DE PROTROMBINA CON FIBRINÓGENO DERIVADO Y 110 PRUEBAS POR HORA TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE CONTEMPLAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES</p> |
| <p>23.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) EQUIPO DE COAGULACION I</p> <p>SOLICITAN: PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE URGENCIAS, CALIBRADORES Y CONTROLES DE CALIDAD EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER POSICIÓN. PROGRAMACIÓN DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MUESTRAS FUERA DE RANGO Y DE DILUCIONES AUTOMÁTICAS DE MUESTRAS.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD PARA INGRESAR LAS MUESTRAS EN MODO URGENCIA O EN CARGA</p> | <p>NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE CONTEMPLAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES</p> |





SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|--|
| <p>CONTINUA, EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER POSICIÓN, PROGRAMANDO LA PRUEBA DEL PACIENTE, SIN NECESIDAD DE INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD CONFIGURABLE POR EL USUARIO, CALIBRACIÓN DEDICADA, CALIBRACIÓN DURANTE EL ANÁLISIS. CON CAPACIDAD DE CON 60 REGLAS DE RERUN Y RÉFLEX TETS CONFIGURABLES POR EL USUARIO ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>24.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) EQUIPO DE COAGULACION I. SOLICITAN. USO INDIVIDUAL DE CUBETAS DE REACCIÓN 1 MUESTRA = 1 CUBETA DE REACCIÓN; EVITANDO DESPERDICIO INNECESARIO DE ESTAS</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE 12 ROTORES DE ACRÍLICO CON 20 CUBETAS DE REACCIÓN CADA UNO (240 CUBETAS DE REACCIÓN A BORDO) LO QUE LE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA GRAN AUTONOMÍA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA , SE REQUIERE USO INDIVIDUAL DE CUBETAS PARA EVITAR EL DESPERDICIO DE ESTAS</p> |
| <p>25.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) EQUIPO DE COAGULACION I. SOLICITAN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 96 TUBOS DE MUESTRA PRIMARIO ABORDO.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 40 MUESTRAS ABORDO. ¿SE ACEPTA NUESTRA?</p> | <p>NO SE ACEPTA POR LA NECESIDAD QUE REQUEREN LAS UNIDADES</p> |
| <p>26.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACION II. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA PRUEBAS: CRONOMÉTRICA (VISCOSIMETRIA), COLORIMÉTRICAS (CROMOGENICAS) E INMUNOLÓGICAS (INMUNOTURBIDIMETRICO).</p> <p>PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO CON LECTURA POR ABSORBANCIA PUNTO FINAL. MÉTODOS CINÉTICOS, ALGORITMOS COAGULOMETRICOS, 3 CANALES DE LECTURA PARA TP Y APTT Y UN CANAL DE PRUEBAS CROMOGENICAS E INMUNOLÓGICAS. PT Y APTT PARA OPERACIÓN DE 2 CANALES CON EL USO DE PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA DE COAGULACIÓN Y DÍMERO D PARA OPERACIÓN DE 1 CANAL CON EL USO DE PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS CROMOGENICAS E INMUNOLÓGICAS FOTOMÉTRICAMENTE, CON EL USO DE CINÉTICA DE TIEMPO FIJO.</p> <p>LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA EN BASES LA CUMPLE UNA SOLA MARCA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN,</p> | <p>ACTUALMENTE EN EL MERCADO EXISTEN OTRAS MARCAS DE INSTRUMENTOS QUE CUMPLEN CON ESTA CARACTERÍSTICAS, TAN IMPORTANTES QUE ADEMÁS EVITAN INTERFERENCIAS CON MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADA, POR LO QUE NO SE ACEPTA.</p> |

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>CONTRAPONIÉNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SU ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>27.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) EQUIPO DE COAGULACION II. SOLICITAN CON CAPACIDAD DE 16 POSICIONES PARA REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN Y 20 POSICIONES DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES TAMAÑOS.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON INCUBADORA: 9 POCETAS PARA MUESTRAS, 3 POCETAS PARA REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA, LA CANTIDAD DE POSICIONES REFRIGERADAS SON INSUFICIENTES PARA EL SERVICIO</p> |
| <p>28.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) EQUIPO DE COAGULACION II. SOLICITAN CUENTE CON MICROPROCESADOR INTEGRADO, QUE DESPLIEGUE RESULTADOS DIRECTAMENTE EN PANTALLA: TIEMPOS, PORCENTAJES, INR, MG/DL.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON REPORTE DE RESULTADOS EN INR, RATIO Y PORCENTAJE DE ACTIVIDAD PARA TP, INTERFACE AL SISTEMA INFORMÁTICO DONDE SE PODRÁN VISUALIZAR LOS RESULTADOS PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO CON CUATRO HILERAS DE 20 CARACTERES CADA UNA, IMPRESORA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMAS CARACTERÍSTICAS</p> |
| <p>29.- 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO C).</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO I DONDE NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LOS PUNTOS NO SE PUDIERAN REFERENCIAR EN LOS, FOLLETOS, HOJAS DE MANUAL DE USUARIO Y/O MANTENIMIENTO, INSERTOS, FOTOGRAFÍAS, GUÍAS MECÁNICAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1 DE LAS PRESENTES BASES</p> |
| <p>30.- ANEXO NÚMERO 1 INCISO O) ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II</p> <p>SOLICITAN: ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA, AUTÓNOMO Y DE ACCESO ALEATORIO. METODOLOGÍA: FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, TURBIDIMETRIA DE PUNTO FINAL, TIEMPO FIJO, CINÉTICO, ISE OPCIONAL. REACTIVO/BANDEJA DE MUESTRA CON 35 POSICIONES PARA REACTIVOS Y 33 POSICIONES PARA MUESTRAS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (4º-15ºC). VOLUMEN DE REACTIVO: R1: 180-450 UL, R2: 30-250 UL.</p> | <p>SE ACPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

VOLUMEN DE MUESTRA: 3-45 UL
DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO, PROTECCIÓN CONTRA COLISIÓN VERTICAL Y COMPROBACIÓN DE INVENTARIO, PRECALENTAMIENTO DE REACTIVO.
LAVADO AUTOMÁTICO DE SONDA INTERIOR Y EXTERIOR.
BANDEJA ROTATORIA CONTENIENDO 40 CUBETAS
CUBETA REUTILIZABLE CON LONGITUD ÓPTICA 5MM.
FUENTE DE LUZ: LÁMPARA HALÓGENA-TUNGSTENO.
CALIBRACIÓN LINEAL (UN PUNTO, DOS PUNTOS, MULTIPUNTOS), LOGIT-LOG 4P, LOGIT-LOG 5P, RANURA EXPONENCIAL, POLINOMIAL, PARÁBOLA.
CONTROL DE CALIDAD: X-R, L-J, MULTIREGLA WESTGARD, CHEQUEO DE SUMA ACUMULATIVA, LOTE GEMELO.

PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

ACCESO ALEATORIO, DE QUÍMICA CLÍNICA, ELECTROLITOS Y PROTEÍNAS SÉRICAS.

EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, ENZIMÁTICO, COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO, INMUNOTURBIDIMÉTRICO, PUNTO FINAL E ISE.

CON 27 POSICIONES PARA REACTIVO POR DISCO DE REACTIVO (CON POSIBILIDAD A TENER MÁS DE UN DISCO), CAPACIDAD DE CARGA DE 100 MUESTRAS RUTINA/URGENTES, CON COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (6 A 10 °C)

**CON CONSUMO DE REACTIVO: 50-150µL
ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II
CON 2.0 – 16.5 µL VOLUMEN DE MUESTRA.**

**CON SENSOR DE FLUIDOS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS, COMPROBACIÓN DE INVENTARIO.
CON SISTEMA DESPUÉS DE CADA CICLO DE PIPETEO, LLEVA ACABO UN CICLO DE LAVADO PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE. DURANTE DICHO CICLO, LA AGUJA Y LOS TUBOS SE ENJUAGAN CON AGUA Y AGENTE LIMPIADOR.**

**CON ROTOR PARA UN ESPACIO MÁXIMO DE 60 CUBETAS
CON SEGMENTOS DE 10 CUBETAS DE UN SOLO USO, LAS CUALES ASEGURAN UNA ALTA CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS Y EVITAN LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE.**

**CON LÁMPARA DE HALÓGENO DE 20 W.
CON REGRESIÓN LINEAL, INTERPOLACIÓN LINEAL, LOGIT/LOG 5, EXPONENCIAL 5, 2 PUNTOS DE CALIBRACIÓN, MANTIENE 150 CURVAS.
CON CONTROL DE CALIDAD INDIVIDUAL, ACUMULATIVO, GRAFICAS DE L-J.**









LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES LAS CUMPLE SOLAMENTE UNA MARCA PROVENIENTE CHINA LO CUAL COMPROMETE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LIMITA LA PARTICIPACIÓN CONTRAPONIÉNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SU ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V. ¿SE ACEPTA?


SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1


PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|---|
| <p>31.- ANEXO NÚMERO 1 INCISO O) ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA II</p> <p>SOLICITAN: EQUIPO DE HEMATOLOGÍA QUE UTILIZA IMPEDANCIA MODIFICADA PARA HACER EL RECUENTO Y CLASIFICACIÓN DE CEULAS SANGUÍNEAS "FLUJO DIGITAL DE CORRIENTE DIRECTA" (DIGITAL FLOW DC), QUE EMPLEE ÚNICAMENTE 2 REACTIVOS PARA SU OPERACIÓN, LISANTEW Y DILUYENTE. VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE SOLO 9 MICROLITROS. 21 PARAMETROS REPORTABLES. REPORTE ÚNICO DE PARÁMETROS COMO "P-LCC" (PLAQUETAS GIGANTES) Y P-LCR (RADIO PLAQUETAS). SOFTWARE LINUX. PANTALLA TOUCH-SCREEN. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO PARA 500 MIL RESULTADOS DE PACIENTES. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 70 PRUEBAS POR HORA. MODOS DE PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS, MODO SANGRE COMPLETA, MODO PREDILUCION Y MODO CAPILAR.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE RECIBIR MÁS OFERTAS TÉCNICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÉTODO DE IMPEDANCIA VOLUMÉTRICA DE CONTEO DE CÉLULAS Y RESISTENCIA ELÉCTRICA. EQUIPO QUE SOLAMENTE EMPLEA 3 REACTIVOS, REACTIVO HEMOLIZANTE PARA CSC, REACTIVO HEMOLIZANTE DIF Y DILUYENTE. ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CON CAPACIDAD DE REPORTAR 19 PARÁMETROS CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES. PARÁMETROS REPORTABLES DE PLAQUETAS: PCT: CRIT DE PLAQUETAS VPM (MPV): VOLUMEN DE PLAQUETAS MEDIO ADP (PDW): ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE PLAQUETAS. SOFTWARE PROPIO DE LA MARCA. ALMACENAMIENTO DE DATOS DE HASTA 15,000 RESULTADOS INCLUYENDO HISTOGRAMAS. 60 MUESTRAS POR HORA. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES LAS CUMPLE SOLAMENTE UNA MARCA PROVENIENTE CHINA LO CUAL COMPROMETE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LIMITA LA PARTICIPACIÓN CONTRAPONIÉNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SU ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>32.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: ANALIZADOR SELECTIVO DE MUESTRAS DE FLUJO CONTINUO Y ALEATORIO.</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases.</p> |







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS
LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA,
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|---|
| <p>PARA CUBRIR ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I CON TECNOLOGÍA MICROSLIDE Y DILUCIONES ABORDO QUE PERMITE EL ANÁLISIS ALEATORIO DE SUERO, PLASMA Y ORINA EN CUALQUIER MOMENTO. ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>33.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: METODOLOGÍAS: ABSORBANCIA, ESPECTROFOTOMETRÍA, TURBIDIMETRIA, FLUORESCENCIA, POLARIZADA, ELECTRODOS SELECTIVOS DIRECTOS E INDIRECTOS. PARA CUBRIR ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I CON TÉCNICA COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICA (DE PUNTO FINAL Y CINÉTICA), POTENCIOMÉTRICA E INMUNOCINÉTICO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>SE ACPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>34.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: RENDIMIENTO DE HASTA 400 PRUEBAS/HORA CON ISE. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I CON RENDIMIENTO DE HASTA 350 PBA/HR. ACCESO CONTINUO SIN AFECTAR EL FLUJO DE TRABAJO DE LABORATORIO ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>35.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: CASETE ÚNICO PARA TODAS LAS PRUEBAS, DE 50 A 1,000 TEST POR CASETE, DEPENDIENDO DE LA PRUEBA PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I CON TECNOLOGÍA MICROSLIDE, QUÍMICA SECA QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>36.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: IDENTIFICACIÓN DEL CASETE POR CÓDIGO DE BARRAS. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I CON CARTUCHOS DE PRUEBAS CON CÓDIGOS DE BARRAS PARA CARGAR FÁCILMENTE EN UN PASO. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>37.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: CALIBRACIÓN: LINEAL Y NO LINEAL, CON ESTÁNDARES MÚLTIPLES CON UNO O DOS PUNTOS DE</p> | <p>Apegarse a lo solicitado en bases</p> |

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten signature/initials at the bottom center.

Handwritten signature/initials at the bottom right.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS
LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA,
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>CORRECCIÓN. PARA CUBRIR ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, EN DONDE SE PUEDEN PRE CALIBRAR UN NÚMERO ILIMITADO DE LOTES. ESTABILIDAD DE HASTA 6 MESES. CARGA DE INFORMACIÓN DE CÁLCULO DE CALIBRACIÓN EN LA MEMORIA USANDO UN DISQUETE DE CALIBRACIÓN, CALIBRA HASTA 30 PRUEBAS EN 60 MINUTOS. ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>38.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: VOLUMEN DE REACCIÓN DE 120 A 240 MICROLITROS. PARA CUBRIR ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I QUE EMPLEA SOLAMENTE UN MICROSLIDE POR PRUEBA CON UN VOLUMEN DE 5-11 µL DE MUESTRA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>39.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: QUE CUENTE CON UN CONTENEDOR CON CAPACIDAD DE 1,000 CUBETAS, RELLENABLE EN MARCHA PARA CUBRIR ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON CONTENEDOR QUE PUEDE ALMACENAR HASTA 60 MICROSLIDES, OFRECIENDO UN SISTEMA REDUCIDO POR RESULTADO REPORTADO Y UNA ELEVADA EFICIENCIA DEL USO DE LOS REACTIVOS SI LOS COSTOS Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN, EL EFECTO DE ARRASTRE Y LAS INTERFERENCIAS ASOCIADAS A LOS SISTEMAS BASADOS EN AGUA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>40.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: DETECCIÓN DE DETECCIÓN DE MUESTRA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE REFIERE A LA DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO EN LA MUESTRA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ?</p> | <p>Hacer caso omiso a este renglón</p> |
| <p>41.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: CON CAPACIDAD DE REACTIVOS EN EL SISTEMA DE 32 CASSETS. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON CAPACIDAD DE MÁS DE 60 POSICIONES DE REACTIVOS A BORDO CON UN AMPLIO MENÚ ACCESIBLE PARA ENTREGAR RESULTADOS INMEDIATOS PARA PRUEBAS DE RUTINA Y URGENCIAS. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>42.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>DICE: REFRIGERACIÓN DE LOS CASETES 10-15 ° C. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I CON TAMBOR DE SLIDES MANTIENE LA TEMPERATURA ENTRE 13 Y 23 °C, ADEMÁS DE CONTROLAR LA HUMEDAD RELATIVA ENTRE 26 Y 40%. ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>43.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: CONSUMO DE AGUA: 2 LITROS/HORA EN MODO OPERATIVO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I CON TECNOLOGÍA DE QUÍMICA SECA, NO UTILIZA TUBERÍAS, DRENAJES, VÁLVULAS DE PURGA O AGUA DES IONIZADA, ELIMINANDO LOS GRANDES COSTOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>44.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA I DICE: CONTROL DE TEMPERATURA, BAÑO DE AIRE A 37°C PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA I QUE UTILIZA SOLO UN INCUBADOR PARA PROCESAR TODOS LOS SLIDES POTENCIOMÉTRICOS, COLORIMÉTRICOS, CINÉTICOS E INMUNOCINÉTICOS A UNA TEMPERATURA DE 37°C ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>45.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA, AUTÓNOMO Y DE ACCESO ALEATORIO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II ANALIZADOR DE MULTIPARAMÉTRICO, SELECTIVO Y DE ACCESO ALEATORIO, DE QUÍMICA CLÍNICA, ELECTROLITOS Y PROTEÍNAS SÉRICAS. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>46.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: METODOLOGÍA: FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, TURBIDIMETRIA DE PUNTO FINAL, TIEMPO FIJO, CINÉTICO, ISE OPCIONAL. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II QUE USA FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, ENZIMÁTICO, COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO, INMUNOTURBIDIMÉTRICO, PUNTO FINAL E ISE. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>47.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: REACTIVO/BANDEJA DE MUESTRA CON 35 POSICIONES PARA REACTIVOS Y 33 POSICIONES PARA MUESTRAS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (4°-15°C). PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON 27 POSICIONES PARA REACTIVO POR DISCO DE REACTIVO (CON POSIBILIDAD A TENER MÁS DE UN DISCO), CAPACIDAD DE CARGA DE 100 MUESTRAS RUTINA/URGENTES, CON COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (6 A10 °C) ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>48.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: VOLUMEN DE REACTIVO: R1: 180-450 UL, R2: 30-250 UL. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON VOLUMEN DE REACTIVO R1: 50-150µL ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>49.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: VOLUMEN DE MUESTRA: 3-45 UL PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON VOLUMEN DE MUESTRA 2.0 – 16.5 µL ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>50.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO, PROTECCIÓN CONTRA COLISIÓN VERTICAL Y COMPROBACIÓN DE INVENTARIO, PRECALENTAMIENTO DE REACTIVO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON SENSOR DE FLUIDOS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS, COMPROBACIÓN DE INVENTARIO. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>51.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: LAVADO AUTOMÁTICO DE SONDA INTERIOR Y EXTERIOR. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON UN SISTEMA QUE DESPUÉS DE CADA CICLO DE PIPETEO, LLEVA ACABO UN CICLO DE LAVADO PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE. DURANTE DICHO CICLO, LA AGUJA Y LOS TUBOS SE ENJUAGAN CON AGUA Y AGENTE LIMPIADOR. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|---|
| <p>52.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: BANDEJA ROTATORIA CONTENIENDO 40 CUBETAS. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON UN ROTOR PARA UN ESPACIO MÁXIMO DE 60 CUBETAS. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>53.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: CUBETA REUTILIZABLE CON LONGITUD ÓPTICA 5MM. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON SEGMENTOS DE 10 CUBETAS DE UN SOLO USO, LAS CUALES ASEGURAN UNA ALTA CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS Y EVITAN LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>54.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: FUENTE DE LUZ: LÁMPARA HALÓGENA-TUNGSTENO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON UNA LÁMPARA DE HALÓGENO DE 20 W. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>55.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: 8 LONGITUDES DE ONDA: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 NM. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE CON 2 LONGITUDES DE ONDA. 340, 378, 409, 449, 480, 512, 520, 552, 538, 629, 652, 659 NM. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se puede responder su solicitud de oferta.</p> |
| <p>56.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: CALIBRACIÓN LINEAL (UN PUNTO, DOS PUNTOS, MULTIPUNTOS), LOGIT-LOG 4P, LOGIT-LOG 5P, RANURA EXPONENCIAL, POLINOMIAL, PARÁBOLA. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE CON REGRESIÓN LINEAL, INTERPOLACIÓN LINEAL, LOGIT/LOG 5, EXPONENCIAL 5, 2 PUNTOS DE CALIBRACIÓN, MANTIENE 150 CURVAS. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>57.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: CONTROL DE CALIDAD: X-R, L-J, MULTIREGLA WESTGARD, CHEQUEO DE SUMA ACUMULATIVA, LOTE</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

Asistente

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>GEMELO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON CONTROL DE CALIDAD INDIVIDUAL, ACUMULATIVO, GRAFICAS DE L-J. ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>58.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: METODOLOGÍA: FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, TURBIDIMETRIA DE PUNTO FINAL, TIEMPO FIJO, CINÉTICO, ISE OPCIONAL. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON FOTOMETRÍA, TURBIDIMETRÍA, CINÉTICO E ISE. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>59.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: VELOCIDAD DE 100 PRUEBAS POR HORADE MANERA CONSTANTE. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON VELOCIDAD DE HASTA 270 PRUEBAS POR HORA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>60.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: REACTIVO/BANDEJA DE MUESTRA CON 35 POSICIONES PARA REACTIVOS Y 33 POSICIONES PARA MUESTRAS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (4°- 15°C). PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON 50 POSICIONES DE REACTIVO EN REFRIGERACIÓN, CHAROLA REMOVIBLE CON PORTA TUBO DE MUESTRA EN CARRUSEL CON 10 POSICIONES CADA UNO, PERMITIENDO AL USUARIO HASTA UNA CARGA DE 40 MUESTRAS EN FORMA DE RUTINA Y URGENCIAS, CON UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE 8 A 15 °C. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>61.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: VOLUMEN DE REACTIVO: R1: 180-450 UL, R2: 30- 250 UL. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON VOLUMEN DE REACTIVO R1: 20 A 350 µL (INCREMENTO EN 1 µL) Y VOLUMEN R2: 20 A 180 µL (INCREMENTO EN 1 µL). ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>62.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: VOLUMEN DE MUESTRA: 3-45 UL. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|--|
| AUTOMATIZADO CON VOLUMEN DE MUESTRA 1.5 A 35 µL (INCREMENTOS EN 0.1 µL) ¿SE ACEPTA? | |
| <p>63.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO, PROTECCIÓN CONTRA COLISIÓN VERTICAL Y COMPROBACIÓN DE INVENTARIO, PRECALENTAMIENTO DE REACTIVO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO EQUIPADO CON SENSORES DE NIVEL DE LÍQUIDO, DETECCIÓN DE COÁGULO. ¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| <p>64.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: LAVADO AUTOMÁTICO DE Sonda INTERIOR Y EXTERIOR. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II, CON SISTEMA DE LAVADO INTERNO Y EXTERNO DE LA MICROPIPETA CON AGUA PURIFICADA. ¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| <p>65.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: BANDEJA ROTATORIA CONTENIENDO 40 CUBETAS PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON SISTEMA DE CUBETAS CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 72 CUBETAS EN LÍNEAS DE REACCIÓN. ¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| <p>66.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: CUBETA REUTILIZABLE CON LONGITUD ÓPTICA 5MM. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON CUBETA SEMIDESECHABLE CON SISTEMA DE LAVADO ABORDO, MEDICIÓN DIRECTA DE LA ABSORBANCIA DE LA CUBETA DE FORMA BICROMÁTICO O MONOCROMÁTICO. ¿SE ACEPTA?</p> | No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases |
| <p>67.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: TEMPERATURA DE OPERACIÓN 37°C. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON UN SISTEMA DE REACCIÓN DE 37 °C. ¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

Handwritten signature at the bottom left.


Handwritten signature at the bottom center.


Handwritten signature at the bottom center.


SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA


| | |
|--|---|
| <p>68.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: 8 LONGITUDES DE ONDA: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 NM. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE CON 12 LONGITUDES DE ONDA 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800 NM. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>69.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: CALIBRACIÓN LINEAL (UN PUNTO, DOS PUNTOS, MULTIPUNTOS), LOGIT-LOG 4P, LOGIT-LOG 5P, RANURA EXPONENCIAL, POLINOMIAL, PARÁBOLA. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II CON EQUIPO QUE PERMITE SELECCIONAR UN TIPO DE CALIBRACIÓN FACTOR, LINEAL, PUNTO A PUNTO, LOG-LOGIT, INTERPOLACIÓN SEGMENTARIA, INTERPOLACIÓN SEGMENTARIA O EXPONENCIAL. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>70.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: CONTROL DE CALIDAD: X-R, L-J, MULTIREGLA WESTGARD, CHEQUEO DE SUMA ACUMULATIVA, LOTE GEMELO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON SISTEMA QUE INTEGRA MODALIDADES DE CONTROL DE CALIDAD MEDIA-R Y X-R. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>71.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: METODOLOGÍA: FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, TURBIDIMETRIA DE PUNTO FINAL, TIEMPO FIJO, CINÉTICO, ISE OPCIONAL. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO E INMUNOTURBIDIMÉTRICO (PUNTO FINAL, CINÉTICO, CON O SIN BLANCO DE REACTIVO O MUESTRA). ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>72.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: VELOCIDAD DE 100 PRUEBAS POR HORA DE MANERA CONSTANTE. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON VELOCIDAD DE HASTA 200 PRUEBAS POR HORA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |







SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>73.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: REACTIVO/BANDEJA DE MUESTRA CON 35 POSICIONES PARA REACTIVOS Y 33 POSICIONES PARA MUESTRAS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO (4°-15°C). PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DONDE SE PUEDEN CARGAR HASTA 33 REACTIVOS DE FORMA SIMULTÁNEA, CON UN ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE Y EN REFRIGERACIÓN ASEGURANDO LA ESTABILIDAD. RACKS DE MUESTRA CON 16 POSICIONES PERMITIENDO AL USUARIO CARGAR HASTA 64 MUESTRAS. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>74.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: VOLUMEN DE REACTIVO: R1: 180-450 UL, R2: 30-250 UL. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON VOLUMEN DE REACTIVO 25 A 400 µL EN INCREMENTOS DE 1 µL. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>75.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: VOLUMEN DE MUESTRA: 3-45 UL. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON VOLUMEN DE MUESTRA 3 A 50 µL EN INCREMENTOS DE 1 µL (SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE TOTAL PRE-TRATADA, LÍQUIDOS BIOLÓGICOS Y OTROS LÍQUIDOS). ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás. Anteriormente en los números 49 y 62, oferta diferentes volúmenes de muestra (quiero entender que se trata de equipos diferentes).</p> |
| <p>76.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO, PROTECCIÓN CONTRA COLISIÓN VERTICAL Y COMPROBACIÓN DE INVENTARIO, PRECALENTAMIENTO DE REACTIVO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON UN SISTEMA DE DISPENSADO TERMOSTATIZADO Y CON SENSOR CAPACITIVO DE NIVEL DE LÍQUIDO. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás.</p> |
| <p>77.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: LAVADO AUTOMÁTICO DE SONDA INTERIOR Y EXTERIOR. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON SISTEMA DE LAVADO INTERNO Y EXTERNO DEL DISPENSADOR QUE EVITA EL ARRASTRE DE REACTIVOS Y MUESTRAS EVITANDO ASÍ LA CONTAMINACIÓN</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. CON LA OBSERVACIÓN QUE EN EL NUMERO 51, OFERTO LO MISMO CON OTRAS PALABRAS</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|---|
| POR ARRASTRE. ¿SE ACEPTA? | |
| 78.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: BANDEJA ROTATORIA CONTENIENDO 40 CUBETAS. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO QUE CONTIENE POSICIÓN DE CUBETAS 60 SEMI-DESECHABLES CON SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CUBETAS. ¿SE ACEPTA? | No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases |
| 79.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: CUBETA REUTILIZABLE CON LONGITUD ÓPTICA 5MM. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON POSICIÓN DE CUBETAS 60 SEMI-DESECHABLES CON UN SISTEMA QUE EMPLEA CUBETAS REUTILIZABLES, CONTANDO CON UN SISTEMA DE LAVADO ADEMÁS DE MOSTRAR EN PANTALLA EL ESTADO DE LA CUBETA COMO TODAS, REEMPLAZABLES E INSERVIBLES. ¿SE ACEPTA? | No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases |
| 80.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: TEMPERATURA DE OPERACIÓN 37°C. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON UN SISTEMA ELECTRÓNICO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE REACCIÓN A 37°C ¿SE ACEPTA? | Se acepta SU propuesta, sin ser obligatorio para los demás. Con la observación que en el número 67, oferto lo mismo: |
| 81.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: FUENTE DE LUZ: LÁMPARA HALÓGENA-TUNGSTENO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON UNA LÁMPARA DE HALÓGENO DE 6V / 10W. ¿SE ACEPTA? | No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases |
| 82.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II DICE: 8 LONGITUDES DE ONDA: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 NM. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON 8 FILTROS DE BANDA ESTRECHA PARA PROPORCIONAR 8 LONGITUDES DE ONDA CON RANGO DE 340NM A 620NM. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|--|
| <p>83.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: CALIBRACIÓN LINEAL (UN PUNTO, DOS PUNTOS, MULTIPUNTOS), LOGIT-LOG 4P, LOGIT-LOG 5P, RANURA EXPONENCIAL, POLINOMIAL, PARÁBOLA. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON LOG LOGIT DE 2 PARÁMETROS, LOG LOGIT DE 3 PARÁMETROS, LOG 5P, INVERSIÓN CUBICA, CUADRADO Y CUBICO. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>84.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA II DICE: CONTROL DE CALIDAD: X-R, L-J, MULTIREGLA WESTGARD, CHEQUEO DE SUMA ACUMULATIVA, LOTE GEMELO. PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO CON UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE L-J. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>85.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGÍA II DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO DE HEMATOLOGÍA QUE UTILIZA IMPEDANCIA MODIFICADA PARA HACER EL RECUENTO Y CLASIFICACIÓN DE CÉLULAS SANGUÍNEAS "FLUJO DIGITAL DE CORRIENTE DIRECTA" (DIGITAL FLOW DC). • QUE EMPLEE ÚNICAMENTE 2 REACTIVOS PARA SU OPERACIÓN, LISANTEW Y DILUYENTE. • VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA DE SOLO 9 MICROLITROS. • 21 PARÁMETROS REPORTABLES. • REPORTE ÚNICO DE PARÁMETROS COMO "P-LCC" (PLAQUETAS GIGANTES) Y P-LCR (RADIO PLAQUETAS). • CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO PARA 500 MIL RESULTADOS DE PACIENTES. • SOFTWARE LINUX. • VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 70 PRUEBAS POR HORA. <p>PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MÉTODO DE IMPEDANCIA VOLUMÉTRICA DE CONTEO DE CÉLULAS Y RESISTENCIA ELÉCTRICA. • EQUIPO QUE SOLAMENTE EMPLEA 3 REACTIVOS, REACTIVO HEMOLIZANTE PARA CSC, REACTIVO HEMOLIZANTE DIF Y DILUYENTE. • ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CON CAPACIDAD DE REPORTAR 19 PARÁMETROS CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES. • PARÁMETROS REPORTABLES GBS (WBC): CONTEO DE GLÓBULOS BLANCOS SANGUÍNEOS GRS (RBC): CONTEO DE GLÓBULOS ROJOS SANGUÍNEOS HGB: | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA HCT: PORCENTAJE DE HEMATOCRITOS (%) VCM (MCV): VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (FL) HCM (MCH): HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (PG) CHCM (MCHC): CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (G/DL) PLT: CONTEO DE PLAQUETAS %LI: PORCENTAJE DE LINFOCITOS %MO: PORCENTAJE DE MONOCITOS %GR: PORCENTAJE DE GRANULOCITOS LI: CONTEO DE LINFOCITOS MO: CONTEO DE MONOCITOS GR: CONTEO DE GRANULOCITOS CV-ADR (RDW-CV): COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL ANCHO DE LA DISTRIBUCIÓN DE GLÓBULOS ROJOS SANGUÍNEOS DE-ADR (RDW-SD): DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL ANCHO DE LA DISTRIBUCIÓN DE GLÓBULOS ROJOS SANGUÍNEOS PCT: CRIT DE PLAQUETAS VPM (MPV): VOLUMEN DE PLAQUETAS MEDIO ADP (PDW): ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE PLAQUETAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE PROPIO DE LA MARCA. • ALMACENAMIENTO DE DATOS DE HASTA 15,000 RESULTADOS INCLUYENDO HISTOGRAMAS. <p>60 MUESTRAS POR HORA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | |
| <p>86.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE COAGULACIÓN I DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 POSICIONES DE REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN PARA FRASCOS DE DISTINTOS TAMAÑOS Y CON CAPACIDAD DE COLOCAR REACTIVOS EN COPILLAS (MICRO VOLUMEN DE REACTIVO). • CAPACIDAD DE TENER CURVAS PRE CALIBRADAS POR LOTES DE REACTIVOS PARA TP, FIBRINÓGENO Y DÍMERO D; EVITANDO GASTO INNECESARIO DE TIEMPO, REACTIVO Y CONSUMIBLES. • METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA PRUEBAS: CRONOMÉTRICAS (VISCOSIMETRÍA), COLORIMETRÍA (CROMOGÉNICAS), E INMUNOLÓGICAS (INMUNOTURBIDIMÉTRICO). • CON CAPACIDAD DE CARGA DE 96 TUBOS DE MUESTRA PRIMARIO ABORDO. <p>PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN I CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA CON CAPACIDAD DE 22 REACTIVOS A BORDO (8 REFRIGERADOS DE 10 A 16° C, CON AGITACIÓN MAGNÉTICA Y 14 NO REFRIGERADOS), ADICIONALMENTE CUENTA CON UN ANILLO ALTERNO DE CARRUSEL DONDE SE PUEDEN UBICAR HASTA 10 VIALES DE REACTIVO MÁS. TODOS LOS REACTIVOS SE PUEDEN ASPIRAR DESDE EL FRASCO ORIGINAL O ADAPTADOR QUE PUEDE SER COPILLAS DE 0.5ML, 2 ML O DE 4 ML. • MODO DE CALIBRACIÓN DE MANERA AUTOMÁTICA. CALIBRACIÓN DEDICADA, CALIBRACIÓN DURANTE EL ANÁLISIS O CALIBRACIÓN POR ROTOR, CON CAPACIDAD PARA GUARDAR LA CALIBRACIÓN JUNTO CON SUS DATOS (CV, PENDIENTE, PUNTO DE INTERCEPCIÓN Y COEFICIENTE DE CORRELACIÓN | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten signature/initials at the bottom center.

Handwritten signature/initials at the bottom right.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>LINEAL) E IMPRIMIRLA.</p> <ul style="list-style-type: none"> EQUIPO QUE REALIZA TÉCNICAS COAGULOMÉTRICAS, COLORIMÉTRICAS O CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS DE COAGULACIÓN Y FIBRINÓLISIS. <p>EL CARGADOR DE ROTORES ADMITE HASTA 12 ROTORES DE ACRÍLICO DE 20 CUBETAS DE REACCIÓN CADA UNA (240 CUBETAS DE REACCIÓN A BORDO) LO QUE LE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA GRAN AUTONOMÍA. EN EL CARRUSEL DE MUESTRA SE PUEDE COLOCAR COPILLAS DE 0.5 ML Y 2 ML. ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>87.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACIÓN II DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA PRUEBAS: CRONOMÉTRICA (VISCOSIMETRÍA), COLORIMÉTRICAS (CROMOGÉNICAS) E INMUNOLÓGICAS (INMUNOTURBIDIMÉTRICO). CON CAPACIDAD DE 16 POSICIONES PARA REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN Y 20 POSICIONES DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES TAMAÑOS. <p>PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN II CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA PRUEBAS COAGULOMÉTRICO, NEFELOMÉTRICO, CROMOGÉNICO E INMUNOLÓGICO, CON AUTODILUCIÓN DE LA MUESTRA Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS PRUEBAS. <p>SISTEMA INTEGRADO CON TRES RESERVORIOS PARA REACTIVO MARCADOS CON LOS NÚMEROS CORRESPONDIENTES, DE LOS CUALES DOS (POSICIONES 1 Y 2) SE ENFRÍAN A UNA TEMPERATURA APROXIMADA DE 15°C, GRACIAS A UN REGULADOR DE EFECTO PELTIER PARA MEZCLARSE CON LOS AGITADORES MAGNÉTICOS. CHAROLA DE MUESTRA GIRATORIA, CON 20 POSICIONES QUE TIENEN UN DIÁMETRO DE 14.2 MM (PARA COPAS DE MUESTRA DE 14 MM Y TUBOS PRIMARIOS DE 13 X 75 MM). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>88.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACIÓN II DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA PRUEBAS: CRONOMÉTRICA (VISCOSIMETRÍA), COLORIMÉTRICAS (CROMOGÉNICAS) E INMUNOLÓGICAS (INMUNOTURBIDIMÉTRICO). CON CAPACIDAD DE 16 POSICIONES PARA REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN Y 20 POSICIONES DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES TAMAÑOS. <p>PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN II CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> ANALIZADOR SEMI-AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|--|
| <p>DE COAGULACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> METODOLOGÍA DE ANÁLISIS CINÉTICOS, ALGORITMOS COAGULOMÉTRICOS, CROMOGENICOS E INMUNOLÓGICOS, CON LECTURA POR ABSORBANCIA DE PUNTO FINAL. 12 POSICIONES DE INCUBACIÓN PARA MUESTRAS EN CUBETA Y 3 PARA REACTIVO MANTENIÉNDOLO DURANTE LA CORRIDA A TEMPERATURA AMBIENTE Y DURANTE EL ALMACENAMIENTO A 4-8°C. <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | |
| <p>89.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR DE GASES DICE: SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA ZONA DE ABSORCIÓN DE LAS MUESTRAS. PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR DE GASES CON SISTEMA QUE CUENTA CON INDICADORES LED QUE INDICAN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ASPIRACIÓN, PROCESAMIENTO Y EMISIÓN DE RESULTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás. El equipo deberá realizar dentro de sus parámetros o exámenes el Lactato.</p> |
| <p>90.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. ANALIZADOR DE HBA1C DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> EQUIPO PARA EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS "DIABETES Y LA DISLIPIDEMIA". NO REQUIERE CALIBRACIÓN. CUENTA CON UN FLUJO DE TRABAJO QUE PERMITE TENER AMBOS RESULTADOS DE HBA1C Y PERFIL DE LÍPIDOS EN 15 MINUTOS. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA POR EL MÉTODO DE MEDICIÓN TRANSMISIÓN FOTOMÉTRICA. LIBRE DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN CON AMPLIO MARGEN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA SU FUNCIONAMIENTO. OBTENCIÓN FÁCIL DEL VOLUMEN DE MUESTRA CON SOLO UNA PEQUEÑA PUNCIÓN EN EL DEDO, RÁPIDA Y SENCILLA APLICACIÓN DE LA MUESTRA (NO SE REQUIERE DE CAPILARES, TUBOS O PIPETAS) HBA1C 2 M L EN 340 SEC. <p>PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO ANALIZADOR DE HBA1C CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> SISTEMA DE MODULO ÚNICO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, QUE COMBINA LAS PRUEBAS DE DIABETES Y BTALASEMIA, LO CUAL PERMITE UNA PRUEBA RÁPIDA DE HBA1C O HBA2/F/A1C. CALIBRACIÓN UNA VEZ POR CARTUCHO. PROGRAMA RÁPIDO PARA HBA1C EN 3 MIN, RESULTADOS EXACTOS DE HBA2 Y HBF EN 6.5 MIN. CAPACIDAD DE NOTIFICAR HBA1C EN PRESENCIA DE HB, S, C, D Y E. EL SISTEMA D10 OFRECE UN MÉTODO INTEGRADO PARA LA SEPARACIÓN Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE RELATIVO DE DETERMINADAS HEMOGLOBINAS EN SANGRE. LA SEPARACIÓN SE | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten signature/initials at the bottom center.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|---|
| <p>BASA EN LOS PRINCIPIOS DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC). LAS HEMOGLOBINAS SEPARADAS ATRAVIESAN LA CÉLULA DE FLUJO DEL FOTÓMETRO, DONDE SE MIDEN LOS CAMBIOS DE ABSORBANCIA A 415 NM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0 Y 50°C, HUMEDAD RELATIVA ENTRE 10 Y 95%, CALIBRACIÓN ÚNICA POR CARTUCHO. • SISTEMA QUE EMPLEA GRADILLAS CON CAPACIDAD DE 10 TUBOS CON ADAPTADORES PARA TUBOS DE 12, 13 Y 14 MM, VIALES DE MUESTRA DE 1.5 ML, ACEPTACIÓN DE TUBO PRIMARIO DE DISTINTOS VOLÚMENES, MECANISMO DE AGUJA DE MUESTREO CON SENSOR ÓPTICO PARA MUESTRA, VÁLVULA DE INYECCIÓN DE 23 µL. <p>¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>91.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA I DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ID/AST PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, POSITIVAS E ID PARA LEVADURAS, SUSCEPTIBILIDAD CON SENSIDISCOS. • EL EQUIPO DEBERÁ TIENE PANELES O TARJETAS QUE INCLUYAN SUSTRATOS BIOQUÍMICOS LIOFILIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA, ASÍ COMO CONCENTRACIONES VARIABLES DE ANTIBIÓTICOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD BACTERIANA CON METODOLOGÍA CROMOGÉNICA Y FLUOROMÉTRICA. • CON SISTEMA DE INOCULACIÓN DE TARJETAS INTEGRADO O ADICIONAL, EL CUAL DEBE TENER UN SISTEMA DE AJUSTE DE INOCULO. • CON SISTEMA DE INOCULACIÓN, INCUBACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON INCUBADOR CONTROLADOR INTEGRADO. • EL EQUIPO OFERTADO DEBE SER FACTIBLE DE PROGRAMAR, VARIOS PARÁMETROS DE SUSCEPTIBILIDAD, DE ACUERDO AL TIPO DE ANTIBIÓTICO Y A LA EDAD DEL PACIENTE. • EL SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR Y ENVIAR ALERTAS SOBRE LA APARICIÓN DE FENOTIPOS DE RESISTENCIA POCO HABITUALES O DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMO ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEES (BETA LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO) Y MRSA (STAPHYLOCOCCUSAUREUSMETICILEN RESISTENTES), ENTRE OTROS. • CON PROGRAMA (SOFTWARE) PARA CLASIFICAR, PROCESAR Y REPORTAR LA INFORMACIÓN MÉDICO-EPIDEMIOLOGICA DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS, ASÍ COMO EL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS, NÚMERO DE MUESTRAS EN PROCESO Y | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|--|
| <p>PROGRAMADOS, PERFIL BIOQUÍMICO DE LA CEPA BIONÚMERO, INFORME DE DATOS GENERALES DE PACIENTES Y DE MUESTRAS ANTERIORES PROCESADAS, PORCENTAJE ACUMULADO DE SUSCEPTIBILIDAD POR CATEGORÍA Y CMI, TENDENCIA DE APARICIÓN DE MICROORGANISMOS EN TIEMPO O SERVICIO, TENDENCIA DE APARICIÓN DE CEPAS RESISTENTES EN TIEMPO O SERVICIO, CAPACIDAD DE CRUZAR INFORMACIÓN DE RESULTADOS POR FECHAS, MICROORGANISMOS, BIONÚMERO, SERVICIO, TIPO DE MUESTRA, SUSCEPTIBILIDAD.</p> <ul style="list-style-type: none">• DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA BASADA EN ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE PROTEÍNAS. QUE INCLUYA LOS REACTIVOS GRADO HPLC NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN, ASÍ COMO LOS ESTÁNDARES Y CONSUMIBLES. CON CAPACIDAD DE EMITIR RESULTADOS EN 30 MIN. REFERENCIADO CON CATÁLOGO BD BRUKERMALDIBIOTYPER.• CAPAZ DE PROCESAR 92 PRUEBAS EN 24 HORAS.• PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA I CON:• SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN (ID) Y/O SUSCEPTIBILIDAD (MIC) DE BACTERIAS Y/O LEVADURAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS (ESTÉRILES O CONTAMINADAS) DE PACIENTES.• PANELES DESHIDRATADOS PARA GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS, CON UN AMPLIO RANGO DE ANTIBIÓTICOS EN DISTINTAS CONFIGURACIONES BP, MIC. PANELES CROMOGÉNICOS RÁPIDOS PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS ANAERÓBICOS Estrictos, NEISSERIA, HAEMOPHILUS EN SOLO 4 HORAS, CON METODOLOGÍA COLORIMÉTRICA Y FLUOROMÉTRICA.• CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE INOCULACIÓN PROMPT UTILIZA UNA SOLA ASA PLÁSTICA CALIBRADA PARA CREAR UN INOCULO ESTANDARIZADO SIN AJUSTES DE TURBIDEZ QUE REQUIEREN DE MUCHO TIEMPO.• LAS SUSPENSIONES BACTERIANAS SE MANTIENEN ESTABLES HASTA POR 4 HORAS. USANDO EL RENOK PARA INOCULAR Y REHIDRATAR SIMULTÁNEAMENTE LOS 96 POZOS DE LOS PANELES DE MICROSCAN, PREPARACIÓN, INCUBACIÓN, Y ADICIÓN DE REACTIVOS DE FORMA AUTOMATIZADA.• EL SOFTWARE INCLUYE UN PROGRAMA QUE LE PERMITE TRANSMITIR INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES, LAS MUESTRAS Y LOS AISLAMIENTOS ENTRE EL ORDENADOR LABPRO Y OTROS SISTEMAS SANITARIOS, TALES COMO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO (LIS), SISTEMAS PHARMLINK O PRODUCTOS SURVEILLANCE DATA LINK NETWORK (SDLN), PUEDE TRANSMITIR LOS DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES Y LA INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS A LABPRO Y | |
|--|--|

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES


A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|---|
| <p>UTILIZAR ESOS DATOS PARA SOLICITAR Y/O PROCESAR PANELES EN EL EQUIPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONFIRMACIÓN DE BETA LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLESS) EN UN MISMO PANEL DE COMBO, CONFIRMACIÓN DE RESISTENCIA INDUCIDA A CLINDAMICINA, DETECCIÓN DE METICILINO RESISTENTES CON CEFOXITINA. EL SOFYWARE LABPRO EN ESPAÑOL PARA PROCESAR INFORMACIÓN, VALIDACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD, ASÍ COMO RESISTENCIAS CRUZADAS, EN AMBIENTE WINDOWS. ADEMÁS, LABPRO ES CAPAZ DE REALIZAR EL ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LOS MICROORGANISMOS AISLADOS EN SU HOSPITAL Y/O LABORATORIO EN TAN SOLO UNOS MINUTOS SIN LA NECESIDAD DE OTROS DISPOSITIVOS, PUEDE TAMBIÉN EXPORTAR EXCEL TODA LA INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y PROCESARLA LIBREMENTE REALIZANDO FILTROS, GRÁFICOS Y PRESENTACIONES. • SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS BASADO EN LA MEDICIÓN DE UNA SERIE DE SUSTANCIAS BIOQUÍMICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE LA MAYORÍA DE LAS BACTERIAS SIGNIFICATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA CLÍNICO. LOS PANELES CONTIENEN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN QUE CONSISTEN EN SUSTRATOS Y/O INHIBIDORES DEL CRECIMIENTO QUE, DEPENDIENDO DE LAS ESPECIES DE BACTERIAS PRESENTES, MUESTRAN CAMBIOS DE COLOR, AUMENTO DE LA TURBIDEZ O CAMBIOS DE FLUORESCENCIA DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN. CON UNA LECTURA Y EMISIÓN DE RESULTADOS DE 20 MIN DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN. • CON CAPACIDAD DE PROCESAR 96 PANELES POR DÍA EQUIVALENTE A 192 PRUEBAS | |
| <p>¿SE ACEPTA?</p> <p>92.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA I DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ID/AST PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, POSITIVAS Y ID PARA LEVADURAS, SUCEPTIBILIDAD CON SENSIDISCOS. • EL EQUIPO DEBERÁ TENER PANELES O TARJETAS QUE INCLUYAN SUSTRATOS BIOQUÍMICOS LIOFILIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA, ASÍ COMO CONCENTRACIONES VARIABLES DE ANTIBIÓTICOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD BACTERIANA CON METODOLOGÍA CROMOGENICA Y FLUOROMÉTRICA. • CON SISTEMA DE INOCULACIÓN DE TARJETAS INTEGRADO O ADICIONAL, EL CUAL DEBE TENER UN SISTEMA DE AJUSTE DE INOCULO. • CON SISTEMA DE INOCULACIÓN, INCUBACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON INCUBADOR CONTROLADOR INTEGRADO. | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |





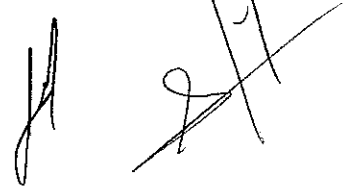

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

- CON MONITOR O PANTALLA E IMPRESORA INTEGRADO O ADICIONAL
- EL EQUIPO OFERTADO DEBE SER FACTIBLE DE PROGRAMAR, VARIOS PARÁMETROS DE SUSCEPTIBILIDAD, DE ACUERDO AL TIPO DE ANTIBIÓTICO Y A LA EDAD DEL PACIENTE.
- EL SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR Y ENVIAR ALERTAS SOBRE LA APARICIÓN DE FENOTIPOS DE RESISTENCIA POCO HABITUALES O DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMO ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEES (BETA LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO) Y MRSA (STAPHYLOCOCCUSAUREUSMETICILEN RESISTENTES), ENTRE OTROS.
- EL EQUIPO OFERTADO DEBE CUMPLIR CON LAS ACTUALIZACIONES DE LA CLSI (CLINICAL LABORATORY STANDARD INTERNACIONAL), DE ACUERDO A LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CMI).
- CON PROGRAMA (SOFTWARE) PARA CLASIFICAR, PROCESAR Y REPORTAR LA INFORMACIÓN MÉDICO-EPIDEMIOLÓGICA DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS, ASÍ COMO EL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS, NÚMERO DE MUESTRAS EN PROCESO Y PROGRAMADOS, PERFIL BIOQUÍMICO DE LA CEPA BIONÚMERO, INFORME DE DATOS GENERALES DE PACIENTES Y DE MUESTRAS ANTERIORES PROCESADAS, PORCENTAJE ACUMULADO DE SUSCEPTIBILIDAD POR CATEGORÍA Y CMI, TENDENCIA DE APARICIÓN DE MICROORGANISMOS EN TIEMPO O SERVICIO, TENDENCIA DE APARICIÓN DE CEPAS RESISTENTES EN TIEMPO O SERVICIO, CAPACIDAD DE CRUZAR INFORMACIÓN DE RESULTADOS POR FECHAS, MICROORGANISMOS, BIONÚMERO, SERVICIO, TIPO DE MUESTRA, SUSCEPTIBILIDAD.
- DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA BASADA EN ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE PROTEÍNAS. QUE INCLUYA LOS REACTIVOS GRADO HPLC NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN, ASÍ COMO LOS ESTÁNDARES Y CONSUMIBLES. CON CAPACIDAD DE EMITIR RESULTADOS EN 30 MIN. REFERENCIADO CON CATÁLOGO BD BRUKERMALDIBIOTYPER. CAPAZ DE PROCESAR 92 PRUEBAS EN 24 HORAS.
- LOS INSUMOS NO REQUIEREN DE REFRIGERACIÓN
- SE PROPORCIONA UN PROGRAMA DE CALIDAD EXTERNO Y DE PRUEBAS DE APTITUD.
- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA POR PARTE DEL FABRICANTE.

PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA I

[Vertical column of handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|--|
| <p>CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN (ID) MICROBIANA, GRAM POSITIVOS, GRAM NEGATIVOS ENTEROBACTICOS, LEVADURAS, ANAEROBIOS, GRAM NEGATIVOS FASTIDIOSOS, GRAM NEGATIVOS NO ENTEROBACTICOS, CON SOLUCIONES DE PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS (AST). • SISTEMA CON UN GRADIENTE PREDEFINIDO Y ESTABLE DE 15 CONCENTRACIONES DE ANTIBIÓTICOS EN UNA TIRA DE PLÁSTICO. USANDO UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE QUÍMICA SECA EN TARJETAS, DETERMINA LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA (MIC) EN ESCALA DE ANTIBIÓTICOS, AGENTES ANTIFÚNGICOS Y AGENTES ANTIMICOBACTERIANOS. MÁS DE 100 ANTIMICROBIANOS ESTÁN DISPONIBLES EN LA GAMA DE PRODUCTOS PARA LA PRUEBA DE BACTERIAS AERÓBICAS Y ORGANISMOS EXIGENTES. • LOS RESULTADOS DE LAS ESPECIES NO CLÍNICAMENTE VALIDADAS SE MARCAN EN EL INFORME DEL EQUIPO PARA ALERTAR AL PERSONAL DEL LABORATORIO DE QUE SE NECESITAN PRUEBAS ADICIONALES PARA VALIDAR EL RESULTADO. ESTOS PUEDEN INCLUIR ORGANISMOS CON DATOS DE RENDIMIENTO CLÍNICO INSUFICIENTES Y ORGANISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN MUESTRAS CLÍNICAS HUMANAS COMO SE INFORMA EN LA LITERATURA CIENTÍFICA. SE DESTACAN AUTOMÁTICAMENTE EN TODOS LOS ARCHIVOS IMPRESOS, EXPORTADOS O AUDITADOS. LOS USUARIOS PUEDEN EXPORTAR TODOS LOS ORGANISMOS DE SISTEMA CON FINES DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA O TENDENCIAS ID / AST, EPIDEMIOLOGÍA, ESTADÍSTICAS U OTROS FINES. • BASE DE DATOS Y ALGORITMOS PATENTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN MICROBIANA ROBUSTA Y PRECISA DE ORGANISMOS CLÍNICAMENTE RELEVANTES EN SU LABORATORIO. • SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN MICROBIANA QUE PROPORCIONA RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN EN MINUTOS UTILIZANDO UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS: TIEMPO DE VUELO DE IONIZACIÓN POR DESORCIÓN LÁSER ASISTIDA POR MATRIZ • INTERFAZ CON LIS Y OTROS SISTEMAS HOSPITALARIOS EN TIEMPO REAL. | |
| <p>¿SE ACEPTA?</p> <p>93.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA II DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ID/AST PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, POSITIVAS E ID PARA LEVADURAS, SUSCEPTIBILIDAD CON SENSIDISCOS. • EL EQUIPO DEBERÁ TIENE PANELES O TARJETAS QUE INCLUYAN SUSTRATOS BIOQUÍMICOS, LIOFILIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA, ASÍ COMO | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

















SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|--|
| <p>CONCENTRACIONES VARIABLES DE ANTIBIÓTICOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD BACTERIANA CON METODOLOGÍA CROMOGENICA Y FLUOROMÉTRICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON SISTEMA DE INOCULACIÓN DE TARJETAS INTEGRADO O ADICIONAL, EL CUAL DEBE TENER UN SISTEMA DE AJUSTE DE INOCULO. • CON SISTEMA DE INOCULACIÓN, INCUBACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON INCUBADOR CONTROLADOR INTEGRADA. • EL EQUIPO OFERTADO DEBE SER FACTIBLE DE PROGRAMAR, VARIOS PARÁMETROS DE SUSCEPTIBILIDAD, DE ACUERDO AL TIPO DE ANTIBIÓTICO Y A LA EDAD DEL PACIENTE. • EL SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR Y ENVIAR ALERTAS SOBRE LA APARICIÓN DE FENOTIPOS DE RESISTENCIA POCO HABITUALES O DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMO ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEES (BETA LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO) Y MRSA (STAPHYLOCOCCUSAUREUSMETICILEN RESISTENTES), ENTRE OTROS. • CON PROGRAMA (SOFTWARE) PARA CLASIFICAR, PROCESAR Y REPORTAR LA INFORMACIÓN MÉDICO-EPIDEMIOLÓGICA DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS, ASÍ COMO EL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS, NÚMERO DE MUESTRAS EN PROCESO Y PROGRAMADOS, PERFIL BIOQUÍMICO DE LA CEPA BIONÚMERO, INFORME DE DATOS GENERALES DE PACIENTES Y DE MUESTRAS ANTERIORES PROCESADAS, PORCENTAJE ACUMULADO DE SUSCEPTIBILIDAD POR CATEGORÍA Y CMI, TENDENCIA DE APARICIÓN DE MICROORGANISMOS EN TIEMPO O SERVICIO, TENDENCIA DE APARICIÓN DE CEPAS RESISTENTES EN TIEMPO O SERVICIO, CAPACIDAD DE CRUZAR INFORMACIÓN DE RESULTADOS POR FECHAS, MICROORGANISMOS, BIONÚMERO, SERVICIO, TIPO DE MUESTRA, SUSCEPTIBILIDAD. • DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA BASADA EN ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE PROTEÍNAS. QUE INCLUYA LOS REACTIVOS GRADO HPLC NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN, ASÍ COMO LOS ESTÁNDARES Y CONSUMIBLES. CON CAPACIDAD DE EMITIR RESULTADOS EN 30 MIN. REFERENCIADO CON CATÁLOGO BD BRUKERMALDIBIOTYPER. • CAPAZ DE PROCESAR 92 PRUEBAS EN 24 HORAS. <p>PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA II CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN | |
|---|--|





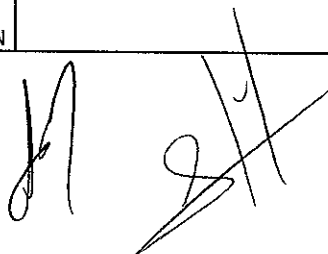SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|--|
| <p>(ID) Y/O SUSCEPTIBILIDAD (MIC) DE BACTERIAS Y/O LEVADURAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS (ESTÉRILES O CONTAMINADAS) DE PACIENTES.</p> <ul style="list-style-type: none">• PANELES DESHIDRATADOS PARA GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS (16-24 HRS), CON UN AMPLIO RANGO DE ANTIBIÓTICOS EN DISTINTAS CONFIGURACIONES, CON METODOLOGÍA COLORIMÉTRICA.• CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE INOCULACIÓN PROMPT UTILIZA UNA SOLA VARILLA ÚNICA PARA CREAR UN INOCULO ESTANDARIZADO SIN AJUSTES DE TURBIDEZ QUE REQUIEREN DE MUCHO TIEMPO, SE PUEDE SELECCIONAR LOS MÉTODOS DE INOCULACIÓN PARA AJUSTAR EL FLUJO DE TRABAJO.• LAS SUSPENSIONES BACTERIANAS SE MANTIENEN ESTABLES HASTA POR 4 HORAS. USANDO EL RENOK PARA INOCULAR Y REHIDRATAR SIMULTÁNEAMENTE LOS 96 POZOS DE LOS PANELES DE MICROSCAN, PREPARACIÓN, INCUBACIÓN, Y ADICIÓN DE REACTIVOS DE FORMA AUTOMATIZADA.• EL QUIPO INCLUYE SOFTWARE QUE LE PERMITE TRANSMITIR INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES, LAS MUESTRAS Y LOS AISLAMIENTOS ENTRE EL ORDENADOR Y OTROS SISTEMAS SANITARIOS, TALES COMO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO (LIS), SISTEMAS PHARMLINK O PRODUCTOS SURVEILLANCE DATA LINK NETWORK (SDLN), PUEDE TRANSMITIR LOS DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES Y LA INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS Y UTILIZAR ESOS DATOS PARA SOLICITAR Y/O PROCESAR PANELES EN EL EQUIPO.• EL SISTEMA IDENTIFICA MICROORGANISMOS Y DETERMINA LAS PAUTAS DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO DE BACTERIAS AISLADAS PROCEDENTES DE MUESTRAS CLÍNICAS. ASIMISMO, PROPORCIONA INFORMES TALES COMO EL INFORME DE DIAGNÓSTICOS, INFORMES DE PACIENTE E INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS. PRUEBAS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS GRAM NEGATIVOS FERMENTADORES Y NO FERMENTADORES, GRAM POSITIVOS: MICROCOCCACEAE Y STREPTOCOCCACEAE, LISTERIA. CONFIRMACIÓN EN EL MISMO PANEL COMBO DE BETA LACTAMASA DE AMPLIO ESPECTRO (BLEES), CONFIRMACIÓN DE RESISTENCIA INDUCIDA A CLINDAMICINA, DETECCIÓN DE METICILINO RESISTENTES CON CEFOXITINA.• EL SOFTWARE EN ESPAÑOL PUEDE PROCESAR INFORMACIÓN, VALIDACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD, ASÍ COMO RESISTENCIAS CRUZADAS, EN AMBIENTE WINDOWS. ADEMÁS, LABPRO ES CAPAZ DE REALIZAR EL ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LOS MICROORGANISMOS AISLADOS EN SU HOSPITAL Y/O LABORATORIO EN TAN SOLO UNOS MINUTOS SIN LA NECESIDAD DE OTROS DISPOSITIVOS, PUEDE TAMBIÉN EXPORTAR EXCEL TODA LA INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y PROCESARLA LIBREMENTE REALIZANDO FILTROS, | |
|---|--|

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>GRÁFICOS Y PRESENTACIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> SISTEMA QUE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS EMPLEA PANELES QUE CONTIENE SUSTANCIAS BIOQUÍMICAS QUE REACCIONAN CON LOS MICROORGANISMOS. EL CAMBIO DE COLOR O LA TURBIDEZ EN DETERMINADOS POCILLOS SE PRODUCE COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN DEL PH, LA ADICIÓN DE REACTIVOS, O LA PRESENCIA O AUSENCIA DE CRECIMIENTO. PANELES CONVENCIONALES (16-24HRS), CON 96 POCILLOS POR PLACA, CON UN TIEMPO DE LECTURA DE 5 MIN. <p>¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>94.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA II DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ID/AST PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, POSITIVAS E ID PARA LEVADURAS, SUSCEPTIBILIDAD CON SENSIDISCOS. EL EQUIPO DEBERÁ TIENE PANELES O TARJETAS QUE INCLUYAN SUSTRATOS BIOQUÍMICOS LIOFILIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA, ASÍ COMO CONCENTRACIONES VARIABLES DE ANTIBIÓTICOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD BACTERIANA CON METODOLOGÍA CROMOGENICA Y FLUOROMÉTRICA. EL SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR Y ENVIAR ALERTAS SOBRE LA APARICIÓN DE FENOTIPOS DE RESISTENCIA POCO HABITUALES O DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMO ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEES (BETA LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO) Y MRSA (STAPHYLOCOCCUSAUREUSMETICILEN RESISTENTES), ENTRE OTROS. CON PROGRAMA (SOFTWARE) PARA CLASIFICAR, PROCESAR Y REPORTAR LA INFORMACIÓN MÉDICO-EPIDEMIOLÓGICA DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS, ASÍ COMO EL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS, NÚMERO DE MUESTRAS EN PROCESO Y PROGRAMADOS, PERFIL BIOQUÍMICO DE LA CEPA BIONÚMERO, INFORME DE DATOS GENERALES DE PACIENTES Y DE MUESTRAS ANTERIORES PROCESADAS, PORCENTAJE ACUMULADO DE SUSCEPTIBILIDAD POR CATEGORÍA Y CMI, TENDENCIA DE APARICIÓN DE MICROORGANISMOS EN TIEMPO O SERVICIO, TENDENCIA DE APARICIÓN DE CEPAS RESISTENTES EN TIEMPO O SERVICIO, CAPACIDAD DE CRUZAR INFORMACIÓN DE RESULTADOS POR FECHAS, MICROORGANISMOS, BIONÚMERO, SERVICIO, TIPO DE MUESTRA, SUSCEPTIBILIDAD. CAPAZ DE PROCESAR 92 PRUEBAS EN 24 | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|--|
| <p>HORAS. PARA CUBRIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO DE BACTERIOLOGÍA II CON:</p> <ul style="list-style-type: none">• EQUIPO AUTOMATIZADO DE FÁCIL ACCESO A RESULTADOS ID Y AST EMPLEANDO ÁRBOL DE NAVEGACIÓN Y FILTROS DE BÚSQUEDA. CON CAPACIDAD DE EFECTUAR IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS, GRAM-NEGATIVOS, GRAM-POSITIVOS Y PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD.• SISTEMA QUE EMPLEA TARJETA PLÁSTICA CON 64 POCILLOS QUE CONTIENE UNA SUSPENSIÓN DESHIDRATADA AL AIRE DE UN PRODUCTO BIOQUÍMICO O ANTIBIÓTICO, REALIZA LOS ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD SUPERVISANDO CONTINUAMENTE EL CRECIMIENTO Y LA ACTIVIDAD DE LOS MICROORGANISMOS AL INTERIOR DE TARJETAS MEDIANTE UN SISTEMA ÓPTICO DE TRANSMITANCIA CON DIODOS EMISORES DE LUZ Y FOTODETECTORES DE SILICIO.• SISTEMA QUE FACILITA LA ELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO CON EL SISTEMA ADVANCED EXPERT SYSTEM QUE PROPORCIONA UN RÁPIDO Y PRECISO RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN FENOTÍPICA DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE ALARMA VISUAL BASADA EN LOS SIGUIENTES INDICADORES: VERDE: RESULTADOS DE CONCORDANCIA COMPLETA, AMARILLO: RESULTADOS DE NO CONCORDANCIA, SE REQUIERE REVISIÓN: ROJO: FENOTIPO DESCONOCIDO: PÚRPURA: FENOTIPO NO INCLUIDO EN LA BASE DE DATOS. EL SISTEMA INCLUSO SUGIERE CAMBIOS CUANDO SE RECONOCEN FENOTIPOS RESISTENTES.• DISEÑADO PARA PROPORCIONAR RESULTADOS DE ID/AST EN TAN SOLO 5-8 HORAS, CON UNA CAPACIDAD DE 30 A 60 TARJETAS POR MÓDULO CON OPCIÓN DE CONECTAR 2 MÓDULOS.• REALIZA LOS ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD SUPERVISANDO CONTINUAMENTE EL CRECIMIENTO Y LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS EN EL INTERIOR DE LOS POCILLOS DE LAS TARJETAS DE TEST.• EL SISTEMA ÓPTICO DE TRANSMITANCIA UTILIZA LUZ VISIBLE PARA MEDIR DIRECTAMENTE EL CRECIMIENTO DEL ORGANISMO. ESTE SISTEMA ÓPTICO SE BASA EN UNA LECTURA DE LUZ INICIAL EN UN POCILLO, ANTES DE QUE SE HAYA PRODUCIDO UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO. EL MUESTREO DE LA TRANSMITANCIA DE LUZ EN EL MISMO POCILLO CADA 15 MINUTOS MIDE EL CRECIMIENTO DEL ORGANISMO MEDIANTE LA CANTIDAD DE LUZ A LA QUE SE IMPIDE PASAR A TRAVÉS DEL POCILLO.• EL SISTEMA ÓPTICO UTILIZA DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) QUE PRODUCEN LUZ A LAS LONGITUDES DE ONDA ADECUADAS, Y FOTODETECTORES DE SILICIO PARA CAPTURA LA LUZ TRANSMITIDA. ESTE SISTEMA SE AUTOCALIBRA. <p>EL EQUIPO GARANTIZA UNOS RESULTADOS DE</p> | |
|---|--|

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>SUSCEPTIBILIDAD DE CALIDAD Y DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE ERROR HUMANO A TRAVÉS DE UNA VALIDACIÓN RÁPIDA, AUTOMÁTICA Y SISTEMÁTICA DE CADA RESULTADO DEL TEST DE SUSCEPTIBILIDAD. CADA RESULTADO DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBIDORA (CMI) SE COMPRUEBA CONTRA UNA BASE DE DATOS DE MÁS DE 3.500 FENOTIPOS Y 30.000 DISTRIBUCIONES DE CMI PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA CON FENOTIPOS PREVIAMENTE DEFINIDOS COMO RESISTENTES. ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>95.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE COAGULACION I. DICE: CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 POSICIONES DE REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN PARA FRASCOS DE DISTINTOS TAMAÑOS Y CON CAPACIDAD DE COLOCAR REACTIVOS EN COPILLAS (MICRO VOLUMEN DE REACTIVO). PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE 22 REACTIVOS ABORDO (8 POSICIONES CON REFRIGERACIÓN Y AGITACIÓN MAGNÉTICA Y 14 NO REFRIGERADOS) Y EN LA ZONA POSTERIOR INCLUYE 4 POSICIONES REFRIGERADAS ADICIONALES. EL ANILLO DEL CARRUSEL DE MUESTRA DISPONE DE ÁREAS DE REACTIVOS, DONDE SE PUEDEN UBICAR HASTA 10 VIALES DE REACTIVOS MÁS Y PUEDEN SER ASPIRANDO DESDE SU FRASCO ORIGINAL O COPILLAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>96.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE COAGULACION I. DICE: METODOLOGIA DE ANALISIS PARA PRUEBAS: CRONOMETRICAS (VISCOSIMETRIA), COLORIMETRIA (CROMOGENICAS), E INMUNOLOGICAS (INMUNOTURBIDIMETRICO). PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA DETECCIÓN NEFELOMÉTRICA DEL COAGULO PERMITE AL EQUIPO MEDIR CON EXACTITUD LA FORMACIÓN DE HEBRAS DE FIBRINA, LLEVANDO LA PRECISIÓN DE UN ANALIZADOR BIOQUÍMICO AL LABORATORIO DE COAGULACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>97.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE COAGULACION I. DICE: LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS: OPCIONAL Y MEMORIA PARA ALMACENAR UN NÚMERO ILIMITADO DE PACIENTES EN DISCO DURO. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS, Y TENGA LA CAPACIDAD PARA ALMACENAR 1000 PACIENTES CON SUS DATOS DEMOGRÁFICOS Y HASTA 30 RESULTADOS (30,000TETS) VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN FORMATO DE LISTADO O INFORME POR PACIENTE SELECCIONABLE POR EL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>98.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACION I. DICE: CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 150 PRUEBAS POR HORA. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE REALICE 175 PRUEBAS POR HORA PARA TIEMPO DE PROTROMBINA CON FIBRINÓGENO DERIVADO Y 110 PRUEBAS POR HORA TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>99.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACION I DICE: PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE URGENCIAS, CALIBRADORES Y CONTROLES DE CALIDAD EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER POSICIÓN. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD PARA INGRESAR LAS MUESTRAS EN MODO URGENCIA O EN CARGA CONTINUA, EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER POSICIÓN , PROGRAMANDO LA PRUEBA DEL PACIENTE, SIN NECESIDAD DE INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD CONFIGURABLE POR EL USUARIO, CALIBRACIÓN DEDICADA, CALIBRACIÓN DURANTE EL ANÁLISIS O CALIBRACIÓN POR ROTOR, CON CAPACIDAD PARA GUARDAR LA CALIBRACIÓN E IMPRIMIRLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>100.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACION I. DICE: PROGRAMACIÓN DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MUESTRAS FUERA DE RANGO Y DE DILUCIONES AUTOMÁTICAS DE MUESTRAS. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON 60 REGLAS DE RERUN Y RÉFLEX TETS CONFIGURABLES POR EL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>101.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACION I. DICE: USO INDIVIDUAL DE CUBETAS DE REACCIÓN 1 MUESTRA = 1 CUBETA DE REACCIÓN; EVITANDO DESPERDICIO INNECESARIO DE ESTAS. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON UN CARGADOR DE ROTORES QUE ADMITE HASTA 12 ROTORES DE ACRÍLICO CON 20 CUBETAS DE REACCIÓN CADA UNO (240 CUBETAS DE REACCIÓN A BORDO) LO QUE LE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA GRAN AUTONOMÍA, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE MANIPULAR MÚLTIPLES CUBETAS INDIVIDUALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACION I. DICE: CON</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |













SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>CAPACIDAD DE CARGA DE 96 TUBOS DE MUESTRA PRIMARIO ABORDO. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 40 MUESTRAS ABORDO, EN EL CARRUSEL DE MUESTRAS SE PUEDEN COLOCAR COPILLAS Y TUBOS DE DIVERSOS TAMAÑOS LOS CUALES PUEDEN IDENTIFICARSE POR MEDIO DE CÓDIGO DE BARRAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | |
| <p>102.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE COAGULACION II. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA PRUEBAS: CRONOMÉTRICA (VISCOSIMETRIA), COLORIMÉTRICAS (CROMOGENICAS) E INMUNOLÓGICAS (INMUNOTURBIDIMETRICO). PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO CON LECTURA POR ABSORBANCIA PUNTO FINAL. MÉTODOS CINÉTICOS, ALGORITMOS COAGULOMETRICOS, 3 CANALES DE LECTURA PARA TP Y APTT Y UN CANAL DE PRUEBAS CROMOGENICAS E INMUNOLÓGICAS. PT Y APTT PARA OPERACIÓN DE 2 CANALES CON EL USO DE PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA DE COAGULACIÓN A 630 NM FIBRINÓGENO- CLAUSSE PARA USO DE 1 CANAL CON PROCEDIMIENTOS DE COAGULACIÓN A 405 NM ANTTROMBINA Y DÍMERO D PARA OPERACIÓN DE 1 CANAL CON EL USO DE PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS CROMOGENICAS E INMUNOLÓGICAS FOTOMÉTRICAMENTE, CON EL USO DE CINÉTICA DE TIEMPO FIJO A 405 NM. QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE COAGULACION II. DICE: CON CAPACIDAD DE 16 POSICIONES PARA REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN Y 20 POSICIONES DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES TAMAÑOS. PARA CUMPLIR CON ESTE QUE CUENTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON INCUBADORA: 9 POSETAS PARA MUESTRAS, 3 POSETAS PARA REACTIVOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>103.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE COAGULACION II. DICE: USO INDIVIDUAL DE CUBETAS DE REACCIÓN 1 MUESTRA = 1 CUBETA DE REACCIÓN; EVITANDO DESPERDICIO INNECESARIO DE ESTAS</p> <p>PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE UTILICE ROTORES DE ACRÍLICO CON 20 CUBETAS DE REACCIÓN CADA UNO (240 CUBETAS DE REACCIÓN A BORDO) LO QUE LE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA GRAN AUTONOMÍA. EL ROTOR CONTIENE 20 CUBETAS DE REACCIÓN ÓPTICAS, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE MANIPULAR MÚLTIPLES CUBETAS INDIVIDUALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

República

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>104.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. EQUIPO DE COAGULACION II. DICE: CUENTE CON MICROPROCESADOR INTEGRADO, QUE DESPLIEGUE RESULTADOS DIRECTAMENTE EN PANTALLA: TIEMPOS, PORCENTAJES, INR, MG/DL. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON REPORTE DE RESULTADOS EN INR, RATIO Y PORCENTAJE DE ACTIVIDAD PARA TP, INTERFACE AL SISTEMA INFORMÁTICO DONDE SE PODRÁN VISUALIZAR LOS RESULTADOS PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO CON CUATRO HILERAS DE 20 CARACTERES CADA UNA, IMPRESORA INCORPORADA -LEDS DE COLORES PARA GUÍA DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>105.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALITICOS. UROANÁLISIS TIPO II. SOLICITAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO COMPACTO ANALIZADOR DE UROANÁLISIS. • ENTREGA DE RESULTADOS ESTANDARIZADOS. • UTILIZA TIRAS REACTIVAS QUE CUENTAN CON MAYA DE NYLON LAMINADA, QUE LA PROTEGE DE CONTAMINACIÓN Y ABRASIÓN. • REALIZA LA LECTURA DE LA TIRA CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN. • FONOMETRÍA DE REFLECTANCIA. • VELOCIDAD DE 50 PRUEBAS POR HORA. • MEMORIA PARA 100 RESULTADOS CON HORA Y FECHA. • CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDA CON 2 LÍNEAS Y 24 CARACTERES. • CAPAZ DE SER CONECTADO A UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. <p>PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIRAS DE PRUEBA DE ORINAS CON PROTECCIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO EN LAS ALMOHADILLAS DE GLUCOSA Y SANGRE. • RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO Y ESPERA ENTRADA DE DATOS VÍA TECLADO O LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS • SELECCIÓN VARIABLE DEL FORMATO A IMPRIMIR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, ASÍ COMO FECHA /DATOS • RANGOS AJUSTABLES PARA CONCENTRACIÓN, GRADOS Y UNIDADES • TRANSPORTE Y MEDICIÓN AUTOMÁTICO DE LAS TIRAS, ANALIZADOR DE ORINA SEMI AUTOMATIZADO, SISTEMA DE CARGA CONTINÚA, PROCESAMIENTO DE 500 PRUEBAS POR HORA. • PANTALLA CRISTAL LÍQUIDO DE 4 LÍNEAS X 24 CARACTERES. | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ALMACENA: LOS ÚLTIMOS 999 RESULTADOS • FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | |
| <p>106.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. UROANÁLISIS TIPO II. SOLICITAN: DICE: FONOMETRÍA DE REFLECTANCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRMA QUE SE REFIERE A FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | <p>Es correcta sus apreciación</p> |
| <p>107.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS EQUIPO DE INMUNIOLOGIA. DICE: VOLUMEN DE PIPETEO DE REACTIVO DE 40 A 64 UL POR TETS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN CONSUMO DE DE REACTIVO DE 50-80 MICROLITROS (R1/R2). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO de las bases</p> |
| <p>108.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA II. DICE: TEMPERATURA DE OPERACIÓN 37C. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE REFIERE A LA TEMPERATURA DE REACCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | <p>Es correcta sus apreciación</p> |
| <p>109.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. ANALIZADOR DE GASES. DICE: ARCHIVA HASTA 6000 DATOS DE PACIENTES, CONTROLES DE CALIDAD Y PROCESOS DE SOLUCIONES CONTROL, EN MEMORIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO QUE ALMACENA HASTA 12,000 DATOS EN MEMORIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| <p>110.- ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO INCISO O) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS ANALÍTICOS. EQUIPO DE BACTERIOLOGIA I Y II. DICE: SE PROPORCIONA UN PROGRAMA DE CALIDAD EXTERNO Y DE PRUEBAS DE APTTUD. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA POR PARTE DEL FABRICANTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIREMOS CON ESOS DOS PUNTOS UNA VEZ</p> | <p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |

Reglamento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|---|--|
| ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | |
| <p>111.- 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO C). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO DEBEMOS PRESENTAR LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS, HOJAS DE MANUAL, INSERTOS, FOTOGRAFÍAS, Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO I INCISO O). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | Es correcta su apreciación |
| <p>112.- 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO C). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO I INCISO O) DONDE NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LOS PUNTOS QUE DEBIDO A SU NATURALEZA TALES COMO NO BREAKS, IMPRESORA, MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REFACCIONES, REGULADORES, UPS, ETC. NO SE PUDIERAN REFERENCIAR EN LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS, HOJAS DE MANUAL, INSERTOS, FOTOGRAFÍAS, Y/O DOCUMENTOS NECESARIOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> | Se acepta su propuesta |
| <p>113.- 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO H). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL REGISTRO DEBERÁ SER IDENTIFICADO CON PARTIDA ÚNICA Y NÚMERO DE LA LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | Es correcta su apreciación |
| <p>114.- 1.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. ADECUACIONES FISICAS Y AMBIENTALES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE UNA VEZ ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (MINISPLIT INVERTER), EN LAS ÁREAS DE LABORATORIO DONDE SE REQUIERAN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE Y A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SALUD, ASÍ COMO ADECUACIÓN FÍSICA EN CASO DE SER NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.</p> | Es correcto y obligatorio para todos los participantes |
| <p>115.- 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO I). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTA CON PRESENTAR ISO 9001 Y/O ISO 13485 Y/O FDA, CE, CLV, TUV. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | Es correcta su apreciación |
| <p>116.- CRITERIOS DE EVALUACION, DICTAMEN Y ADJUDICACION. INCISO D). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARA A UN SOLO LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | Es correcta su apreciación |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>117.- ANEXO NUMERO I TECNICO INCISO N) REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES ADICIONALES.</p> <p>DEBIDO A QUE EL LISTADO CONTENIDO EN ESTE INCISO SON CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO UNA VEZ ADJUDICADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI BASTARA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIREMOS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ SOLICITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | <p>Es correcto y obligatorio para todos los participantes</p> |
| <p>118.- 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO J). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O SUBDISTRIBUIDOR DE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEL ANEXO I TÉCNICO INCISO O). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | <p>Es correcta su apreciación</p> |

C).- DE CARACTER LEGAL

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
|---|--|
| <p>119.- 2.9 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE.</p> <p>ENTENDEMOS QUE PRESENTAR ESTE CERTIFICADO ES OPCIONAL Y NO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTE LICITACION. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?</p> | <p>Es correcta su apreciación.</p> |
| <p>120.- 3.10 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE (OPCIONAL)</p> <p>ENTENDEMOS QUE AL SER OPCIONAL EL PRESENTAR ESTE CERTIFICADO, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO MOSTRARLO. ¿ES CORRECTO?</p> | <p>Es correcto.</p> |
| <p>121.- 3.11 ACREDITACION DE SOLVENCIA ECONOMICA</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL 2016, YA QUE POR LEY ESTAMOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL 2017 HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2018. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, por ley la declaración anual de personas morales se tiene como fecha límite su presentación hasta marzo 2018.</p> |
| <p>122.- 3.11 ACREDITACION DE SOLVENCIA ECONOMICA</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR MI DECLARACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el numeral 3.11 de las bases</p> |
| <p>123.- 3.12 LICENCIA DE GIRO EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE</p> <p>LA CONVOCANTE EN ESTE PUNTO SOLICITA LICENCIA DE GIRO O AVISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE A 2017.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS ACEPTE PRESENTAR NUESTRO AVISO DE FUNCIONAMIENTO CON FECHA DE JULIO DEL 2015 OTORGADO POR LA COMISION FEDERAL PAR LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) DEBIDO A QUE MI</p> | <p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en el numeral 3.12 de las bases</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures and marks on the right margin]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|---|
| <p>REPRESENTADA NO HA SUFRIDO CAMBIOS DE ASPECTO LEGAL, FISCAL O DOCUMENTAL ES EL QUE SE ENCUENTRA VIGENTE A LA FECHA. ¿SE ACEPTA?</p> | |
| <p>124.- 3.16 ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO 12)</p> <p>MI REPRESENTADA NO PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA EN LA PRESENTE LICITACION, POR LO CUAL PUEDE PRESENTAR ESTE ANEXO CON LA LEYENDA DE "NO APLICA". ¿ES CORRECTO?</p> | <p>Es correcto.</p> |
| <p>125.- 3.19 ISO 9001:2015 DEL LICITANTE</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA EL CERTIFICADO CON EL SIGUIENTE ALCANCE "VENTA, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, OFRECIENDO SERVICIOS INTEGRALES"</p> <p>CONSIDERANDO A QUE LA PRESENTE LICITACIÓN TIENE COMO OBJETO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, SERA SUFICIENTE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN EN LA NOM ISO 9001:2015 CON EL ALCANCE LA COMERCIALIZACION Y PROVISION DE SERVICIOS INTEGRALES DE LABORATORIO CLÍNICO, EL CUAL ENLOBA TODO LO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR Y ES JUSTAMENTE EL SERVICIO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>LOS LICITANTES. DEBERÁN HACER CONSTAR QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD; POR LO CUAL, DEBERÁN DE INTEGRAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA CERTIFICADA DE SU CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y/O ISO 9001:2008; EN CASO DE PRESENTAR ESTA ULTIMA; DEBERÁN PRESENTAR SUS TRAMITES PARA INICIAR CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015; ASI MISMO, PRESENTAR AL MENOS UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN ORIGINAL A FAVOR DEL PARTICIPANTE EXPEDIDA POR UN ORGANISMO PUBLICO, DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, MENCIONANDO QUE EL PARTICIPANTE HA COADYUVADO EN LAS TAREAS DE IMPLEMENTA I DE ALGÚN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, ACOMPAÑANDO ESTA DE COPIA CERTIFICADA LA CERTIFICACIÓN OBTENIDA.</p> |
| <p>126.- 3.20 FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS</p> <p>ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR COPIA DE NUESTRAS PREGUTAS ENVIADAS AL INSTITUTO EN JUNTA DE ACLARACIONES (ANEXO 14 PUNTO 3.20) EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE NUESTRA LICITACION. FAVOR DE ACLARAR</p> | <p>Bastara con colocar solo el anexo 14.</p> |
| <p>127.- 3.21 MODELO DE CONTRATO</p> <p>ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR COPIA SIMPLE Y RUBRICADO DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATO (ANEXO 15 PUNTO 3.21) EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE NUESTRA LICITACION. FAVOR DE ACLARAR</p> | <p>Es correcto.</p> |
| <p>128.- 3.22 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA</p> <p>ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO ES SOLO INFORMATIVO Y HACE REFERENCIA DE COMO PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?</p> | <p>Es correcto.</p> |
| <p>129.- 3.22 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA</p> <p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE DEBEMOS PRESENTAR PARA</p> | <p>Ya se dio contestación.</p> |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|--|--|
| <p>CUMPLIR CON ESTE PUNTO. FAVOR DE ACLARAR.</p> | |
| <p>130.- 4.1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA</p> <p>INCISO K) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE UN CONTRATO CELEBRADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS...</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA FIRMA DEL CONTRATO DEBE TENER DOS AÑOS ATRÁS A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS O QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEBER TENER COMO MINIMO DOS AÑOS. FAVOR DE ACLARAR.</p> | <p>Apegarse a lo solicitado en el numeral 4.1 inciso K) de las bases</p> |
| <p>131.- PROPUESTA ECONOMICA ANEXO NUMERO 2 ECONOMICO</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SERA NECESARIO AGREGAR LA LEYENDA DE "PRECIOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO" EN EL PRESENTE ANEXO. FAVOR DE ACLARAR.</p> | <p>No será necesario agregar "precios fijos" durante la vigencia del contrato</p> |
| <p>132.- ANEXO 5 (PUNTO 3.5) DECLARACION DE INTEGRIDAD</p> <p>SE MENCIONA EN EL PARRAFO A MITAD DEL ANEXO: DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA <u> </u> (PERSONA FÍSICA O MORAL) <u> </u> AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA...</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ESPACIO EN BLANCO DEBE IR EL NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE QUEDANDO COMO SIGUE:</p> <p>DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA INTERMET S.A. DE C.V. AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA...</p> <p>O EN SU DEFECTO ELIMINAR LA PALABRA "ESTA"</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p> | <p>Se deberá de colocar de la siguiente manera:</p> <p>"PERSONA MORAL AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA..."</p> |
| <p>133.- ANEXO 6 (PUNTO 3.6) CARTA DEL ARTICULO 38 DE LA LAASPEC</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ESPACIO EN BLANCO DEBE IR EL NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE QUEDANDO COMO SIGUE:</p> <p>DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA INTERMET S.A. DE C.V. AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO...</p> <p>O EN SU DEFECTO ELIMINAR LA PALABRA "ESTA"</p> | <p>Se deberá de colocar de la siguiente manera" PERSONA MORAL AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO..."</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | |
|------------------|--|
| FAVOR DE ACLARAR | |
|------------------|--|

4.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desestimada.






5.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

6.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas será el día **17 de abril a las 14:00**, en tanto que el fallo el día **23 de abril** del año en curso, a las **14:00 horas**.

7.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.


Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **13:03** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

Funcionarios

| Nombre | Firma |
|---|--|
| Dr. Gustavo Gaytán Sandoval Representante del Secretario de Salud y Bienestar Social |  |
| DCM Carlos Navarro Núñez Representante de los Servicios de Salud |  |
| LAET Leticia Guadalupe Delgado Carrillo Directora Administrativa |  |
| Dr. Gonzalo Iván Álvarez Bueno Representante del REPSS |  |
| C.P. Arnoldo Moreno Medina Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales |  |










SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-021-18
JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES, JURISDICCIONES Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
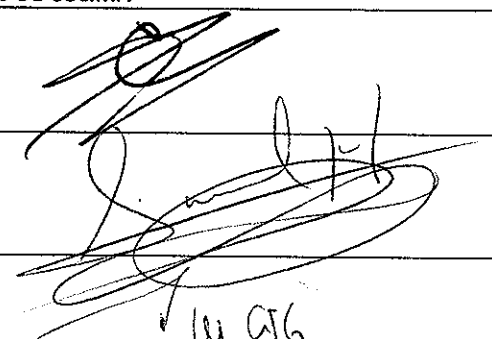
| | |
|---|---|
| L.A. Carlos Arnoldo Campos Ochoa Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado |  Lic. AG |
| C.P. Manuel Santa Ana Velasco Representante de la Secretaría de Administración y Gestión Pública | |
| Lic. Judith Estefanía Torres García Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos | |

Licitantes

| Nombre | Firma |
|---|--|
| Distribuidora Química y Hospitalaria GAP S.A. de C.V. Belén Toscano Orozco | Firma bajo protesta de decir verdad de no haber el tiempo suficiente para analizar el cuerpo de las bases, iniciando la dA |
| Intermet S.A. de C.V. Alfredo Alejandro Ruíz García | Firma bajo protesta de decir verdad de no haber contratado disponibles las bases en tiempo para su análisis |
| Laboratorios Licon S.A. Diana Berenice García Badillo | ESTO DEBE SER A UN PRECIO Y EQUIPO |
| Distribuidora LHAG S.A. de C.V. Victoria Domínguez Balderas | |

a las 12:27pm para la Secretaría Pública de la función Pública